

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

BOND 系统



染色机

用户手册

适用于运行 BOND 6.0 软件
的 BOND 系统

(非美国地区使用)

法律公告

用途声明

BOND 系统是为了对固定在显微镜玻片上的组织学标本进行免疫染色而设计的。

商标

Leica 和 Leica 标志是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标，需获得许可方能使用。BOND、BOND-III、BOND-MAX、BOND-ADVANCE、Covertile、Bond Polymer Refine Detection、Bond Polymer Refine Red Detection、Parallel Automation、Compact Polymer、Oracle 和 RemoteCare 是 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd (ACN 008 582 401) 的商标。其他商标均为其各自所有者之财产。


版权

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 拥有本文档及相关软件的版权。依照法律，未经我司书面授权许可，不得将本文档或软件或其任何部分进行拷贝、重编译、翻译或转换为电子或其他计算机可读取形式。

文档 21.7733.504 修订版 A06

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd，澳大利亚墨尔本，2022 年

生产商



Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Rd
Mount Waverley VIC 3149
Australia

用户须知

本文内容中使用的术语“Leica Biosystems”指 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd。

本着不断完善的政策，Leica Biosystems 保留更改技术规格而无需另行通知的权利。

只有将系统用于规定的用途并且按照本文档的说明进行操作时，保修要求才能予以受理。由不当操作和/或滥用本产品而导致的损害将使担保条款失效。Leica Biosystems 对任何此类损害均不承担责任。

操作 BOND 操作仪的人员在操作仪器之前必须接受足够的培训，并被告知任何潜在的危险或危险步骤。只有经过培训的员工并且只在本手册中有此说明时，才可移除操作仪的防护罩或任何零部件。

维修必须仅由 Leica Biosystems 授权的有资格的维修人员进行。

修订记录

版本	发布时间	修订章节	详细信息
A01	2017 年 9 月	全部	新版本适用于运行 BOND 6.0 软件的 BOND 系统。 基于已有的 BOND 5.1 用户手册 21.7659.504.A06
A02	2017 年 10 月	19 规格	更新
A03	2018 年 6 月	多类别	重新品牌和小的变化
A04	2018 年 8 月	19 规格	更新
A05	2020 年 11 月	封面 法规通告	品牌重塑 更新
A06	2022 年 03 月	法规通告	更新

联系 Leica Biosystems

有关维修或支持事宜，请联系您当地的 Leica Biosystems 代表或登录 www.LeicaBiosystems.com 网站。

BOND-III

医疗器械备案凭证编号：国械备20140016

备案人/生产企业英文名称：Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

备案人/生产企业中文名称：徕卡生物系统（墨尔本）有限公司

住所/生产地址：495 Blackburn Road, Mt Waverley, Victoria 3149, Australia

代理人及售后服务机构：徕卡显微系统（上海）贸易有限公司

代理人住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路127号3楼C部位

联系方式：4008213236

生产日期：见产品英文铭牌

BOND-MAX

医疗器械备案凭证编号：国械备20140277

备案人/生产企业英文名称：Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

备案人/生产企业中文名称：徕卡生物系统（墨尔本）有限公司

住所/生产地址：495 Blackburn Road, Mt Waverley, Victoria 3149, Australia

代理人及售后服务机构：徕卡显微系统（上海）贸易有限公司

代理人住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路127号3楼C部位

联系方式：4008213236

生产日期：见产品英文铭牌

安全性通告

应遵守所有的安全性防范措施以避免人身伤害，患者样本受损、丢失或误辨以及设备损坏。

安全性通告的类型

本手册中的安全性通告包括警告或注意。

警告

警告是针对可能导致人身伤害的危险或者患者样本丢失、损坏或误辨的可能性而发出的通知。

警告采用具有黑色边框和黄色背景的符号，图示如下：



压伤危险。可能压伤手部或其他肢体部位。



烫伤危险。表面高热，若接触可能会导致烫伤。
避免触摸标有此符号的部件。



化学危险。如果不采取适当的预防措施，会有严重的健康威胁。
必须穿戴防护服和手套。
立即按照标准实验室规范清除溢出的液滴。



激光危险。可能会对眼睛造成严重伤害。避免眼睛直视激光束。



注意。若不按照说明操作可能会造成系统损坏或人身伤害。继续操作之前应查阅随附的说明书或相关文件。



电气危险。遵从随附文档中的指示以避免对人体或设备造成伤害。



中毒危险。如果不按照正确的化学步骤操作，可能会有严重的健康威胁。
处理试剂时，必须戴上手套和防护眼罩。



易燃危险。若不遵循正确的预防步骤，易燃试剂可能会引燃。

注意

注意是针对可能导致 BOND 设备损坏或不危及人身安全的其他不良后果而发出的通知。

注意采用具有黑色边框和白色背景的符号，图示如下：



普通警告

普通的 BOND 警告在下文中说明。其他警告在本手册的相关章节中说明。

仪器操作

	为避免试剂和玻片受到污染，应保证仪器在一个尽可能无浮尘、无微粒的干净环境下操作。
	为确保正确的仪器操作，应将每个大容量试剂容器放入试剂槽中的正确位置，与用颜色编码的名称标签所示相一致。否则会影响染色。详细说明请参阅 2.2.7 大容量槽 。
	每天开始工作时先检查大容量液位，视具体情况灌装或清空（必要时应增加此项检查的频率 – 参阅 12.2.1 检查容器液位 ）。否则，可能会导致染色运行中断以取出容器，从而影响染色。
	如果某个大容量在染色处理过程中需要灌装，切记先查看 程序状态 屏幕，确认该容器不在使用中或者不会即将被使用。否则，可能会影响正在处理的玻片。容器灌装后应立即放回 – 参阅 12.2.2 续灌或清空大容量中的试剂容器已空 – BOND-MAX BOND-III 的大容器无需取出即可灌装 – 参阅 12.2.2 续灌或清空大容量中的重新灌装大容量试剂 – BOND-III 若要避免出现这一情况，应每天检查大容量液位（必要时增加检查频率 – 参阅 12.2.1 检查容器液位 ）。
	BOND 软件控制重要硬件和存储敏感数据。将 BOND 控制器连接至您的网络之前，确保您的区域网络有合适的 IT 安全控件。
	BOND 控制器恶意软件感染可导致运行异常，包括无法操作仪器。在将您的 USB 存储设备连接于 BOND 控制器之前，请确保它们未感染病毒。此外，Leica Biosystems 不会预先安装防病毒解决方案，我们建议您安装自己的企业级防病毒产品。获取更多信息，请联系您当地的 Leica Biosystems 代表。

对照



必须建立并维护充分的实验室对照方法，以确保每张玻片获得合适的染色结果。Leica Biosystems 强烈建议将适合的对照组织与患者组织放在相同的玻片上。

化学危险



免疫组织化学和原位杂交中使用的某些试剂具有危害性。继续操作前应确保您已接受过足够的有关此操作的培训：

- 穿戴好乳胶或丁腈手套、防护眼镜及其他合适的防护服，然后再接触试剂或清洗仪器。
- 使用和处理试剂及浓缩物时应遵从所有相关的实验室操作程序和政府法规。



试剂容器在搬运过程中会倾斜，从而导致在容器盖周围留下残余试剂。在打开试剂容器时必须穿戴合格的防护眼镜、手套和防护服。



有潜在危害的试剂可能会积聚在玻片染色装置周围并污染玻片架。在处理玻片架时应确保穿戴合格的防护服和手套。



BOND 操作仪中使用的某些试剂是易燃物质：

- 不要将明火或引火源放置在操作仪附近。
- 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。



操作仪有加热器和受热表面，如果附近放有易燃物，可能有引燃危险：

- 不要将易燃物放在加热器上面或附近。
- 不要将易燃物放在操作仪的任何发热表面上。
- 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。

机械危险



关闭仪器盖时要注意双手，以防受伤。



在操作期间，主自控装置、抽吸探针和大用量液流自控装置（BOND-III）可能会移动而不发出预警，且移动速度可能导致伤害。

- 运行过程中不要试图打开仪器盖。
- 不要试图绕过安全开关，它能在仪器盖被打开时停止仪器操作。
- 操作期间确保注射泵防护罩就位。



避免接触玻片染色装置及其周围区域。这些部位可能非常热，会导致严重烫伤。操作停止后应等待二十分钟时间让玻片染色装置及其周围区域冷却。



如需远距离搬运操作仪，或者送修或处置时，应联系客户支持部门。操作仪很重，且不应由用户来搬运。



确保在正常操作期间注射器门已关闭 (BOND-MAX) 或注射器防护罩已安装 (BOND-III)。如果注射器或注射器部件松动，试剂在压力下可能会从注射器中喷出。



如果主自控装置和/或大用量液流自控装置在操作仪盖被打开超过 5 秒钟后仍继续操作，请立即联系客户支持部门。



在操作仪开关打开期间不要移动主自控装置，否则自控装置可能无法对准，从而导致染色不佳。如果自控装置已经被移动：关闭仪器电源，等待 30 秒后再重新启动。



在执行清洗或维护任务时，必须将操作仪关闭（进行自动清洗任务时除外，如清洗抽吸探针）。



BOND-III 大用量液流自控装置可沿着玻片染色装置移动以允许用户进行清洁。只有已接受过潜在危险警告和充分培训的操作人员才可执行此项操作。



玻片染色装置中包含的移动部件会导致严重伤害。在仪器操作期间，不要将手指放于玻片染色装置开口处。在尝试手动解锁玻片染色装置之前：关闭操作仪的电源开关，关闭主电源，并将主电源插头从墙上断开。



注射器泵组件（BOND-III）非常重，在松开时会向前倒下。只有已接受过潜在危险警告和充分培训的操作人员才可执行此项操作。



不要使用 BOND-III 后部防护罩上的两个黑色把手抬起仪器。

电气危险



不要取下操作仪防护罩或尝试接触内部组件。BOND 操作仪内部存在危险电压，只有 Leica Biosystems 认可的合格的维修技师方可执行此类任务。



不要更改操作仪的工作电压。如果仪器被连接至错误的电源电压，则会产生严重损害。请联系客户支持部门更改设置。



操作仪必须连接至有接地保护的主电源插座上，并且所放置的位置应便于员工断开主电源而无需搬动仪器。



不要绕过保险丝或使其短路。
更换保险丝之前应关闭仪器，断开电源线的连接。仅使用标准零件更换保险丝。若保险丝反复熔断，请联系客户支持部门。

普通注意

普通的 BOND 注意通知在下文中说明。其他注意通知在本手册的相关章节中说明。

安装危险



不要封堵位于仪器后部防护罩上的通气口。此外，不要盖住注射器门上的通气口（BOND-MAX）。

操作危险



将玻片标签的所有部分都置于玻片的四个边缘以内。暴露的粘性表面会导致玻片标签（以及玻片）粘在 Covertile 或其他设备上，从而损坏玻片。



不要取下大容器上的小液位传感器盖（BOND-MAX），因为它可能会损坏。仅使用大的灌装/清空盖来清空和重新灌装大容器。



仅能用手清洁所有的可移除组件。为避免损坏，不要用自动碗碟机清洗任何组件；不要用溶剂、强效或磨蚀性清洁剂或者粗糙或磨砂类织物清洁任何零部件。



不要用棉签或其他头部带有棉球的类似擦拭工具清洁洗涤区的槽孔内部或玻片染色装置的芯柱，因为棉头可能脱落而引起堵塞。



不要用强力将大容器放回，因为这可能会损坏容器和液位传感器。



不要使用损坏的玻片。确保全部玻片都正确地排放在玻片架上，并且所有的 Covertile 放置正确（参阅 2.6.2 BOND-III 和 BOND-MAX 消耗品），然后再将玻片架放入操作仪。



确保注射器组件（BOND-III）已完全关闭，然后再启动运行或初始化操作仪（参阅 12.4.1 手动解锁玻片染色装置），否则会导致注射器在操作期间被损坏。



确保大用量液流自控装置（BOND-III）位于仪器后部的原本位置，而不是位于玻片染色装置上，然后再清洁或移除盖板。

试剂危险



如果允许不配伍溶液相互接触，则会产生不良染色结果并有可能损坏操作仪。请联系 Leica Biosystems 以确定溶液是否配伍。



不要将二甲苯、氯仿、丙酮、强酸（如 20% 盐酸）、强碱（如 20% 氢氧化钠）用于 BOND 操作仪。如果这类化学品溅至 BOND 仪器上或其周围，立即用 70% 酒精清除液滴，以防止损坏操作仪防护罩。



仅可将 BOND Dewax Solution 用于 BOND 仪器。不要使用二甲苯、二甲苯替代品和其他能损害 BOND 系统部件并导致液体泄漏的试剂。

法规通告

体外诊断符号




FCC 合规性

本设备已经过测试，结果符合 FCC 规范第 15 卷关于 A 级数字装置的规定。这些规定的目的在于为设备在商业环境中的操作提供针对有害干扰的合理保护。本设备产生、使用且能辐射射频能量，如果不按照说明手册进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。在居住区操作本设备很可能导致有害干扰，在此情况下，用户需自担费用纠正干扰。

为保持合规性，仅应使用随仪器提供的电缆。

警告：任何未经 Leica Biosystems 明确许可的更改或修改均可能会使用户操作本设备的权限无效。

CE 标志及欧盟公告



合规声明

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd (地址：495 Blackburn Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia) 已制定了符合上述指令及标准的《合规声明》并存档。

专业体外诊断设备说明

体外诊断 (IVD) 设备遵从 IEC 61326 标准第 2-6 部分的放射及抗扰度要求。

使用设备前应对电磁环境进行评估。

不要在紧邻强电磁辐射源处使用该设备 (例如，未屏蔽的有意射频频源)，这些辐射源会干扰设备的正常操作。

警告：本设备按照 CISPR 11 的 A 类标准进行设计和测试。在居住环境中可能会导致无线电干扰，在此情况下，您可能需要采取措施降低干扰。

计算机法规要求：UL 认证 (UL 60950)、IEC 60950 认证。

根据 CISPR 11 (EN 55011) 进行的设备分类

根据 CISPR 11 (EN 55011), 该设备被归类为 1 组, A 类。下文描述了分类和分组的说明。

1 组—适用于未归类为 2 组的所有设备。

2 组—适用于生成和使用/仅使用频率为 9 kHz 至 400 GHz 的射频能量的 ISM RF 设备, 射频能量形式为电磁辐射、电感和/或电容耦合, 用于材料处理或检查/分析目的。

A 类—适用于所有适合于非家用和非直接连接民用建筑供电低压供电网络的设施。

B 类—适用于所有适合于家用设施和直接连接民用建筑供电低压供电网络的设施。



ISM: 工业、科学和医学

RF: 射频

标签上的符号说明



体外诊断医疗器械



序列号（唯一包装标识符）



目录编号



CE 合格标志



易碎品，小心轻放



请参考使用说明



生产商



批号



勿重复使用



注意。请参阅随附文件。



欧共体授权代表



废电子电气设备指令 (WEEE)

BOND-MAX

产品中有毒物质的名称及含量 Names and Contents of the Hazardous Substances

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件 Printed wiring assemblies	X	○	○	○	○	○
电缆 Looms	X	○	○	○	○	○
金属部件 Metal Parts	X	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
其他电子部件 Other electrical parts	X	○	○	○	○	○
其他机械部件 Other mechanical parts	X	○	○	○	○	○
供电装置 Power Supplies	X	○	○	○	○	○
条码摄像头 Barcode Camera	X	○	○	○	○	○
机械臂 Main Robot Assembly	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in according with the provisions of SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572



环保使用期限为 10 年。

The environment-friendly use period is 10 years.

BOND-III

产品中有毒物质的名称及含量 Names and Contents of the Hazardous Substances

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件 Printed wiring assemblies	X	○	○	○	○	○
电缆 Looms	X	○	○	○	○	○
金属部件 Metal Parts	X	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
其他电子部件 Other electrical parts	X	○	○	○	○	○
其他机械部件 Other mechanical parts	X	○	○	○	○	○
供电装置 Power Supplies	X	○	○	○	○	○
条码摄像头 Barcode Camera	X	○	○	○	○	○
机械臂 Main Robot Assembly	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in according with the provisions of SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572



环保使用期限为 10 年。

The environment-friendly use period is 10 years.

BOND 外围设备/配件

产品中有毒物质的名称及含量 Names and Contents of the Hazardous Substances

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电脑 Computer	X	○	○	○	○	○
显示器 Monitor	X	X	○	○	○	○
服务器 Server	X	X	○	○	○	○
键盘 Keyboard	X	○	○	○	○	○
鼠标 Mouse	X	○	○	○	○	○
防火墙 Firewalls	X	X	X	○	○	○
转换开关 Switches	X	X	○	○	○	○
扫描器 Scanner	X	○	○	○	○	○
贴标机 Slide Labeler	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in according with the provisions of SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

目录

法律公告	2
安全性通告	4
法规通告	10
1 介绍	24
1.1 系统概述	24
1.2 获得帮助	25
1.3 初始步骤	26
1.4 运行程序 – 工作流程	27
BOND-III 和 BOND-MAX	27
2 硬件	29
2.1 BOND 系统	30
BOND 辅助产品	30
2.2 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪	31
主要组件	31
操作仪初始化	37
仪器盖	37
主自控装置和 ID 扫图仪	38
玻片染色装置	39
前部防护罩	41
大容器槽	44
抽吸探针	49
洗涤区和混合站	49
大用量液流自控装置 (仅 BOND-III)	50
注射器	52
电源开关	53
后部防护罩	54
2.3 BOND 控制器和终端	56
2.4 手持式条形码扫描仪	56
使用手持式条形码扫描仪	57
2.5 玻片标签仪	57

2.6	辅助设备	58
	玻片	58
	BOND-III 和 BOND-MAX 消耗品	59
	试剂系统和容器	61
2.7	重新安放仪器	62
2.8	仪器停止使用和处理	62
3	软件概述（在 BOND 控制器上）	63
3.1	系统构架	64
	单座配置	64
	BOND-ADVANCE	65
3.2	启动和关闭 BOND 软件	66
3.3	用户角色	68
3.4	临床客户端界面概述	68
	功能栏	69
	操作仪页签	70
	排序表格	70
	日期格式	70
3.5	BOND 看板	71
3.6	通知、警告和警报	72
3.7	报告	73
3.8	帮助	74
3.9	关于 BOND	74
3.10	BOND 数据定义	75
	数据定义更新	75
3.11	软件更新	75
4	快速入门	76
4.1	BOND-III 和 BOND-MAX	76
	操作前检查和启动	76
	程序和试剂检查	77
	设置玻片	78
	装载试剂	82
	运行程序	85
	结束	86

5	状态屏幕（在 BOND 控制器上）	87
5.1	系统状态屏幕	88
	操作仪页签	89
	硬件状态	91
	试剂状态	93
	玻片信息	99
	在机玻片识别	102
	运行进度指示器	104
	启动或停止运行	108
	延迟启动	109
5.2	程序状态屏幕	110
5.3	维护屏幕	111
	维护报告	112
6	玻片设置（在 BOND 控制器上）	114
6.1	玻片设置屏幕	115
6.2	使用对照	115
	对照组织	116
	对照试剂	116
6.3	使用病例	117
	病例对照和活动病例信息	117
	病例标识	118
	添加病例	119
	病例重复、激活和完成	120
	编辑病例	121
	复制病例	121
	日常病例选项	122
	病例报告	122
6.4	管理医生	122
6.5	使用玻片	123
	玻片字段及控件说明	124
	创建玻片	125
	复制玻片	127
	编辑玻片	127
	删除玻片	127
	手动识别玻片	127
	添加玻片模板	128
	分配容量和组织在玻片上的位置	128
6.6	玻片标签	130
	打印标签和在玻片上粘贴	130
	玻片 ID 和标签 ID	131

6.7	玻片设置概要报告	132
6.8	即时玻片和病例创建	133
	扫图后创建新病例和 / 或玻片	133
	在机玻片识别选项	135
6.9	玻片兼容性	136
	程序兼容性	136
7	程序（在 BOND 控制器上）.....	138
7.1	程序类型	138
	染色方法	139
	程序序列	140
7.2	程序设置屏幕	142
	程序详细信息	143
7.3	创建新程序	145
7.4	编辑用户程序	145
	编辑程序步骤	146
	添加和删除程序步骤	147
	程序规则	148
	多种仪器类型和程序版本	150
	删除程序	150
7.5	程序报告	151
7.6	预定义程序	152
	染色程序	152
	预染程序	153
8	试剂管理（在 BOND 控制器上）.....	154
8.1	试剂管理概述	155
	基本信息	156
	诊疗系统	158
8.2	试剂设置屏幕	158
	添加或编辑试剂	160
	删除试剂	161
8.3	试剂清单屏幕	162
	测定试剂量	164
	试剂或试剂系统详细信息	165
	登记试剂和试剂系统	167
	清单详细信息报告	170
	试剂使用报告	171
8.4	试剂模板屏幕	172
	创建模板	172
	查看或编辑模板详细信息	173
	移除模板	173

9	玻片历史（在 BOND 控制器上）	174
9.1	玻片历史屏幕	175
9.2	玻片选择	176
9.3	玻片属性和玻片重新运行	177
	重新运行玻片	177
9.4	运行事件报告	178
9.5	运行详细信息报告	179
9.6	病例报告	180
9.7	程序报告	181
9.8	玻片概要	181
9.9	导出数据	182
9.10	玻片历史摘要	183
10	管理客户端（在 BOND 控制器上）	184
10.1	使用者	184
10.2	实验室信息系统（LIS）	186
10.3	标签	187
	创建、编辑和激活标签模板	190
	信息类型	192
10.4	BDD	194
	BDD 更新	195
	修订记录	195
10.5	设置	196
	实验室设置	196
	病例与玻片设置	197
	数据库备份	198
10.6	硬件	199
	操作仪	199
	仪器组	202
	玻片标签仪	204
11	实验室信息系统（LIS）集成组件（在 BOND 控制器上）	216
11.1	实验室信息系统（LIS）术语	217
11.2	软件的附加性能	217
	实验室信息系统（LIS）状态图标	218
	实验室信息系统（LIS）病例	218
	实验室信息系统（LIS）玻片	219
	通用标记名称	219
	优先玻片	220
	实验室信息系统（LIS）玻片数据字段	220
11.3	实验室信息系统（LIS）连接与初始化	221

11.4	实验室信息系统 (LIS) 通知.....	222
11.5	病例及玻片数据要求.....	223
	病例数据.....	223
	玻片数据.....	224
11.6	将玻片数据发送回实验室信息系统 (LIS)	225
11.7	玻片标签.....	225
11.8	工作流程.....	226
12	清洗和维护 (BOND-III 和 BOND-MAX)	227
12.1	清洁和维护时间表	229
	清洁与维护核查表	230
12.2	大容器	232
	检查容器液位.....	232
	续灌或清空大容器	233
	清洁大容器	236
	外部废液容器 (仅 BOND-MAX)	237
12.3	Covertile	239
12.4	玻片染色装置.....	240
	手动解锁玻片染色装置	243
12.5	重启操作仪	246
12.6	抽吸探针	246
	清洁抽吸探针.....	247
	更换抽吸探针.....	247
12.7	洗涤区和混合站.....	250
12.8	防护罩、门和盖.....	251
12.9	ID 扫图仪	251
	重新初始化 ID 扫图仪.....	251
12.10	承滴盘	253
	BOND-III 大容器承滴盘	254
	BOND-III 仪器承滴盘	255
	BOND-MAX 大容器承滴盘	256
12.11	玻片架	256
12.12	大用量液流自控装置探针 (仅 BOND-III)	257
	清洁大用量液流自控装置探针	257
	更换大用量液流自控装置探针	258
12.13	注射器	259
	更换 BOND-III 注射器	259
	更换 BOND-MAX 9 孔注射器	261
12.14	电源保险丝	262

13	清洗和维护（其他）	264
13.1	手持式条形码扫描仪	264
	Symbol 条形码扫描仪	264
	霍尼韦尔条形码扫描仪	266
13.2	玻片标签仪	269
14	使用 BOND 试剂	270
14.1	程序原理	270
	BOND 检测系统	271
	诊疗系统	273
14.2	标本制备	274
	所需材料	274
	组织制备	276
	脱蜡和烤片	276
	抗原修复	276
14.3	质量控制	277
	检测验证	277
	对照组织	278
	免疫组化（IHC）阴性对照试剂	278
	原位杂交（ISH）对照试剂	279
	质量控制的益处	280
14.4	染色的解释	281
	阳性对照组织	281
	阴性对照组织	281
	患者组织	281
14.5	一般局限性	282
14.6	标签上的符号说明	283
14.7	参考文献	284
15	系统管理（在 BOND 控制器上）	285
15.1	BOND 系统管理器	285
	概述	285
	BOND 系统管理器窗口	286
	停止服务	287
	启动服务	287
15.2	硬盘冗余	288

16	BOND-ADVANCE 操作	289
16.1	重启 BOND-ADVANCE 系统	289
16.2	切换至辅助控制器	291
17	更换玻片标签打印机	295
17.1	在单座系统中更换 Cognitive Cxi 打印机	295
17.2	在 BOND-ADVANCE 系统中更换 Cognitive Cxi 打印机	296
17.3	在单座系统中用 Cognitive Cxi 打印机更换 Zebra 打印机	301
18	RemoteCare	302
18.1	概述	302
18.2	RemoteCare 操作程序	302
18.3	RemoteCare 状态和版本	303
	更改代理服务器设置	303
19	规格	304
	索引	308

1

介绍

1.1 系统概述

祝贺您拥有了 BOND 全自动免疫组织化学 (IHC) 和原位杂交 (ISH) 染色系统。我们相信，它将为您提供您的实验室所需的染色质量、处理能力以及使用上的便捷。BOND 系统的预期用户是接受过充分培训的实验室员工。

BOND 系统可包括多台操作仪，通过 BOND 控制器协调操作。操作仪 (PM) 有两种类型 – BOND-III 和 BOND-MAX，每种类型都具有 30 张玻片处理能力，可同时处理三组运行，每组达十张玻片；根据需要采用不同的染色程序；每组运行可单独启动，以提供连续的处理操作。可以将一组或多组运行设置为双染，同时另一组可使用专为 BOND 设计的 Leica 诊疗系统处理玻片。

BOND 软件使玻片的设置和染色都十分简便。您可以使用随系统提供的经过严格测试的染色程序，也可以创建自己的染色程序。您可以选择品种齐全的 BOND 即用型试剂，也可以使用任何其他抗体或探针，将它们与一系列高质量的 BOND 检测系统相组合。当您在软件中创建了虚拟玻片或者从实验室信息系统 (LIS) 中导入玻片后，即可打印标签 (或使用实验室信息系统 (LIS) 打印的标签)，将其粘贴在玻片上，然后将玻片装载到操作仪中，BOND 就会执行其余的操作，规范、可靠地完成高质量的染色。

 Leica Biosystems 提供的染色程序和试剂在软件中将显示为由 Leica Microsystems 提供。

BOND 系统具有如下性能：

- 高处理能力
- 灵活性
- 安全性
- 自动化 IHC 染色和复染
- 自动化 ISH 染色和复染
- 自动化脱蜡、烤片和修复
- 自动化双染
- 集成了 Leica 诊疗系统

我们相信，您会发现 BOND 系统是您实验室中添置的一套十分宝贵的设备。

参阅以下章节：

- [1.2 获得帮助](#)
- [1.3 初始步骤](#)
- [1.4 运行程序 – 工作流程](#)

1.2 获得帮助

BOND 用户手册（本手册）的 PDF 文件安装在所有控制器（单座）和终端机（BOND-ADVANCE）上，还包含在随系统提供的 CD 盘中。

您可点击 BOND 软件客户端程序中导航栏上的**帮助**图标  查阅本手册。

有关 BOND 系统的问题，请联系您当地的 Leica Biosystems 代表，或浏览 www.LeicaBiosystems.com 网站。

BOND 现提供一个名为远程维护（RemoteCare）的可选服务。该服务软件可让 Leica Biosystems 的服务人员通过互联网与 BOND 连接，为用户提供协助，进行讲解和排除故障。

1.3 初始步骤

对于首次使用 BOND 系统的用户，这一章节将详细说明如何查阅用户手册中的信息以获得完整的产品操作知识。

步骤	描述	手册章节
1	安装与试运行 组装硬件、安装软件、检查系统。 由 Leica Biosystems 代表或经授权的经销商执行。	—
2	阅读“安全”章节的内容 熟悉 BOND 系统的安全要求。	安全性通告
3	了解硬件 熟悉 BOND 硬件的名称和使用。	2 硬件
4	了解软件 获得对软件及其使用方法的基本了解。	3 软件概述（在 BOND 控制器上）
5	检查程序和试剂 试剂和程序可在安装期间设置完毕： <ul style="list-style-type: none"> • 检查是否已设置了计划运行的程序。 • 检查是否已设置了您所需的试剂。 	7 程序（在 BOND 控制器上） 8 试剂管理（在 BOND 控制器上）
6	运行程序 查阅简短的概述。 查阅更详细的概述。	1.4 运行程序 – 工作流程 4 快速入门
7	高级 按照要求，对软件进行更为深入的了解。	5 状态屏幕（在 BOND 控制器上）至 9 玻片历史（在 BOND 控制器上）
8	使用实验室信息系统（LIS） 可选组件包，用于连接至实验室信息系统。	11 实验室信息系统（LIS）集成 组件（在 BOND 控制器上）
9	维护 BOND 系统	12 清洗和维护（BOND-III 和 BOND-MAX）

1.4 运行程序 – 工作流程

1.4.1 BOND-III 和 BOND-MAX



为避免试剂和玻片受到污染，应保证仪器在一个尽可能无浮尘、无微粒的干净环境下操作。

以下内容概述了对玻片架中的玻片进行染色的标准步骤。通过不同的选项设置，可以使用其他工作流程。

初始检查和启动

1. 确定操作仪处于清洁状态，并且近期已执行过全部维护任务（[12.1 清洁和维护时间表](#)）。每天的运行前任务包括：
 - (i) 检查确认大容量废液容器未超过半满
 - (ii) 检查确认大容量试剂容器至少为半满，且装有正确的试剂。
2. 检查洗涤区和混合站 – 必要时进行清洁或更换。
3. 检查确认玻片标签仪中放有标签和打印纸带，并且仪器已开启。
4. 开启操作仪、控制器（包括 BOND-ADVANCE 的终端），并打开 BOND 临床客户端程序。

设置试剂

5. 需要时，在系统中创建试剂（[8.2.1 添加或编辑试剂](#)）。
6. 登记试剂容器（[8.3.3 登记试剂和试剂系统](#)）。

设置程序

7. 需要时，创建新程序（[7.3 创建新程序](#)）。

设置玻片

8. 在软件中创建病例（[6.3.3 添加病例](#)）。
9. 在软件中创建玻片（[6.5.2 创建玻片](#)）。
10. 打印玻片标签，并粘贴到玻片上（[6.6.1 打印标签和在玻片上粘贴](#)）。
11. 将玻片和 Covertile 放到玻片架上（[装载玻片](#)）。

装载操作仪并启动运行

12. 将玻片架插入操作仪（[装载玻片](#)）。
13. 将检测系统和试剂架载入操作仪（[4.1.4 装载试剂](#)）。
14. 按下操作仪上的“装载/卸载”按钮锁定玻片架。
15. 在**系统状态**屏幕上检查确认所有玻片是否已被识别 – 人工识别未能自动识别的玻片（[5.1.5 在机玻片识别中的在机手动玻片识别](#)）。
16. 查看**系统状态**屏幕上的任何警示信息并进行纠正。
17. 点击  按钮启动运行。

监控运行

18. 在**系统状态**屏幕（[5.1 系统状态屏幕](#)）或 BOND 看板（[3.5 BOND 看板](#)）上监控运行进度。查看通知并进行纠正。

卸载玻片和试剂

19. 运行结束后，取出检测系统和试剂架，将试剂存放好（[4.1.6 结束](#)）。



若不打算使用某台操作仪，取出其中的 ER1 和 ER2 大容器，贮存在 +2 °C 至 +8 °C (+36 °F 至 +46 °F) 条件下。另参阅 [2.2.7 大容器槽](#)。

20. 按下操作仪上的“装载/卸载”按钮解锁玻片架，然后取出玻片架。
21. 取下 Covertile 并清洗（[12.3 Covertile](#)）。
22. 取出玻片。
23. 清除玻片染色装置（[12.4 玻片染色装置](#)）、操作仪其他部件、玻片架或试剂架上的所有液滴或污渍。

2

硬件

本节旨在向您提供：

- BOND 系统中各个设备的名称
- 这些装置的功能以及它们如何与整个系统关联
- 在何处查找更详细的信息，如：与设备有关的操作过程和维护过程。

硬件说明中不包括安装和连接各组件的方法，因为系统已安装并测试完毕。如果您需要替换或重新连接组件，详细信息可参阅 [12 清洗和维护 \(BOND-III 和 BOND-MAX\)](#)。

在适当情况下，有关 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪的信息被分在不同的章节中进行描述，以便更快地查找相关内容。

参阅以下章节：

- [2.1 BOND 系统](#)
- [2.2 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪](#)
- [2.3 BOND 控制器和终端](#)
- [2.4 手持式条形码扫描仪](#)
- [2.5 玻片标签仪](#)
- [2.6 辅助设备](#)
- [2.7 重新安放仪器](#)
- [2.8 仪器停止使用和处理](#)

2.1 BOND 系统

BOND 系统由以下主要部件组成：

- 一台或多台操作仪（参阅 [2.2 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪](#)）
- 一台 BOND 控制器或一台 BOND-ADVANCE 控制器（参阅 [2.3 BOND 控制器和终端](#)）
BOND-ADVANCE 安装包括多台终端机和控制器，还可包括一台辅助（后备）控制器
- 一部或多部手持式条形码扫描仪（参阅 [2.4 手持式条形码扫描仪](#)）
- 一台或多台玻片标签打印机（参阅 [2.5 玻片标签仪](#)）

每台新 BOND-III 或 BOND-MAX 操作仪配备有以下部件：

- 4 个玻片架（参阅 [玻片架](#)）
- 4 个试剂架（参阅 [试剂架](#)）
- 1 个混合站（参阅 [2.2.9 洗涤区和混合站](#)）
- 1 个（BOND-MAX）或 2 个（BOND-III）内六角扳手，用于更换注射器泵
- 1 根以太网线

您还需要以下组件：

- 多个 Covertile（参阅 [BOND Universal Covertiles](#)）
- BOND 检测系统、BOND 即用型试剂或浓缩试剂、以及/或开放试剂容器（参阅 [2.6.3 试剂系统和容器](#)）

访问 www.LeicaBiosystems.com，获取耗材与零部件的最新完整列表。

另请参阅 [3.1 系统构架](#)。

2.1.1 BOND 辅助产品

BOND 辅助产品是为 BOND 系统设计的，使用它们有助于确保最佳染色结果。使用 BOND 辅助产品还可以帮助仪器保持最佳状态和防止损坏。

 以下产品应**确保**用于 BOND 系统，并且**决不可**用其他产品替代：

辅助试剂

- BOND Wash Solution（洗涤溶液）
- BOND Epitope Retrieval Solution (1 & 2)（抗原修复溶液 1 和 2）
- BOND Dewax Solution（脱蜡溶液）

耗材

- BOND Plus 玻片（或符合 [2.6.1 玻片](#)中所列规格的玻璃玻片）
- BOND Universal Covertiles
- BOND 开放容器（7 mL 和 30 mL）
- BOND 滴定容器和插管（6 mL）
- BOND 混合瓶
- BOND 玻片标签及打印纸带套装

2.2 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪

操作仪（PM）是 BOND 系统的染色平台。一套单独的 BOND 系统可以配备任意台操作仪，并可由 BOND-III 和 BOND-MAX 型任意组合而成。



操作仪必须连接至有接地保护的主电源插座上，并且所放置的位置应便于员工断开主电源而无需搬动仪器。

- 2.2.1 主要组件
- 2.2.2 操作仪初始化
- 2.2.3 仪器盖
- 2.2.4 主自控装置和 ID 扫图仪
- 2.2.5 玻片染色装置
- 2.2.6 前部防护罩
- 2.2.7 大容器槽
- 2.2.8 抽吸探针
- 2.2.9 洗涤区和混合站
- 2.2.10 大用量液流自控装置（仅 BOND-III）
- 2.2.11 注射器
- 2.2.12 电源开关
- 2.2.13 后部防护罩

2.2.1 主要组件

参阅 BOND-III 和 BOND-MAX 的主要组件：

- BOND-III
- BOND-MAX

BOND-III

下页图片显示了 BOND-III 操作仪的主要组件。

关于后部防护罩的说明可参阅 [2.2.13 后部防护罩](#)。

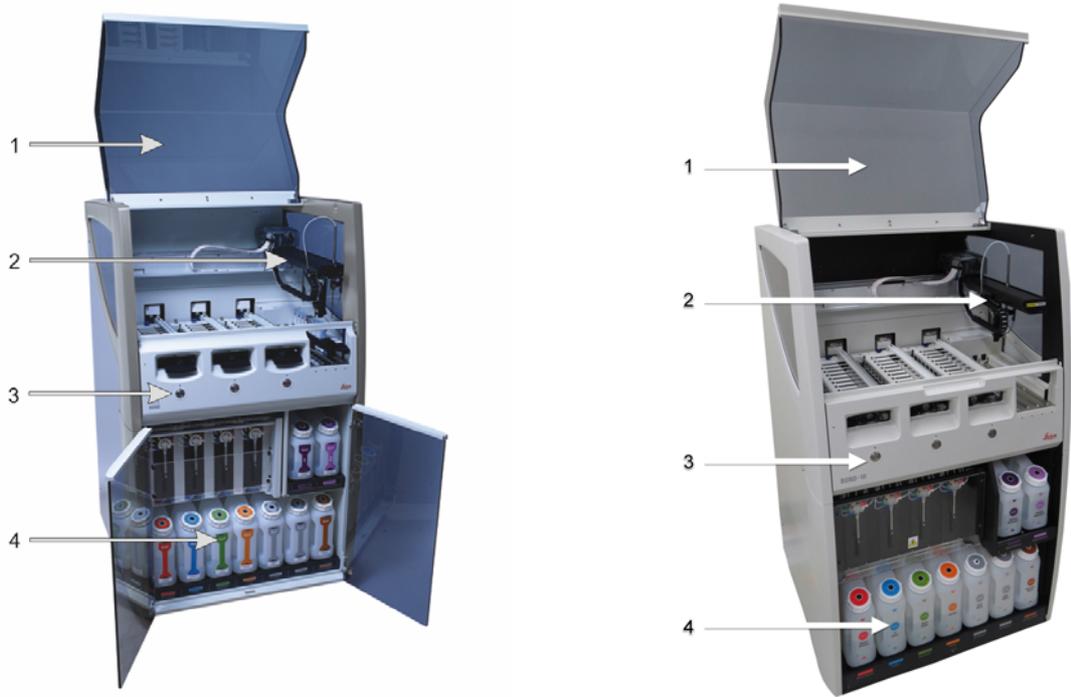


图 1：之前（左侧）和当前（右侧）BOND-III 操作仪的正面视图

编号	名称（图 1）	节
1	仪器盖	2.2.3
2	主自控臂	2.2.4
3	前部防护罩	2.2.6
4	大容器槽	2.2.7

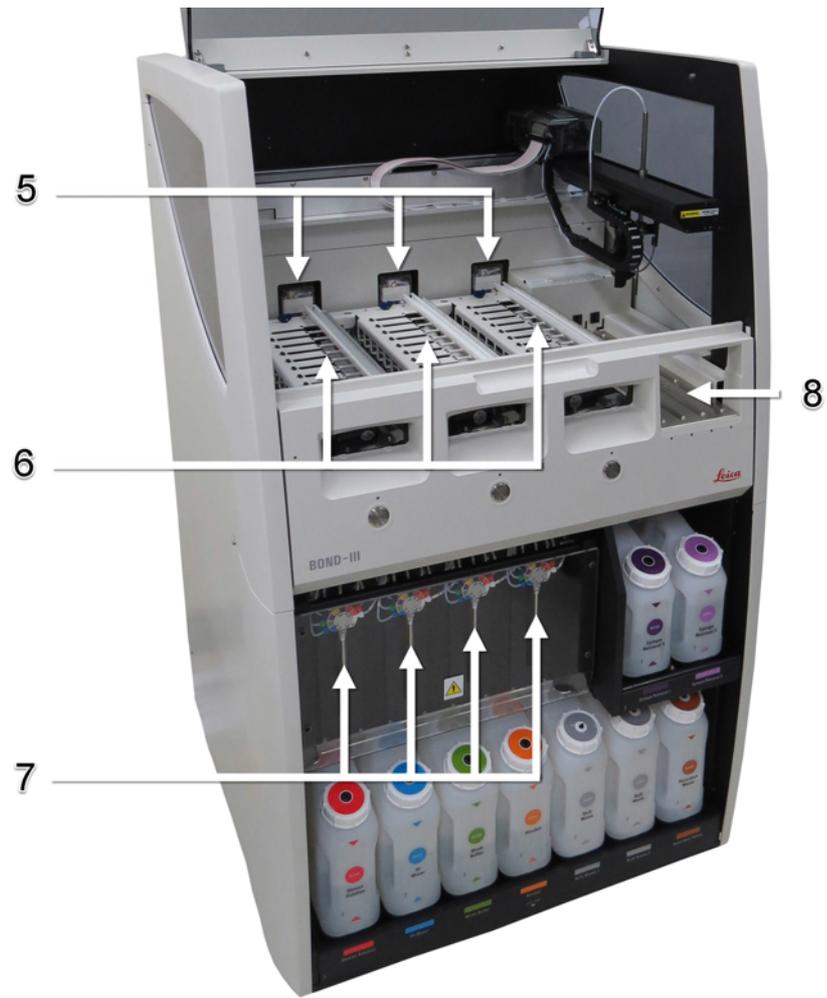


图 2: BOND-III 操作仪的正面

编号	名称 (图 2)	节
5	大用量液流自控装置	2.2.10
6	玻片染色装置	2.2.5
7	注射器	2.2.11
8	试剂平台	2.2.6

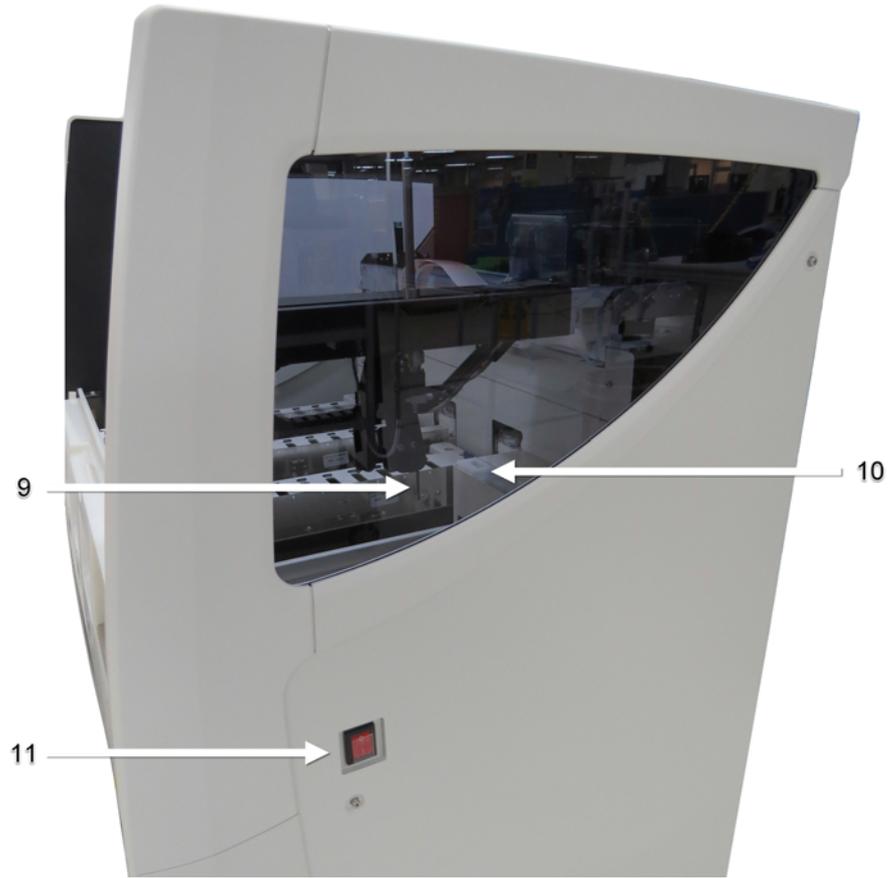


图 3: BOND-III 操作仪的右侧视图

编号	名称 (图 3)	节
9	抽吸探针	2.2.8
10	洗涤区和混合站	2.2.9
11	电源开关	2.2.12

BOND-MAX

下图显示了 BOND-MAX 操作仪的主要组件。图示为当前型号 – 较早的型号外观与此不同，但主要组件是相同的。

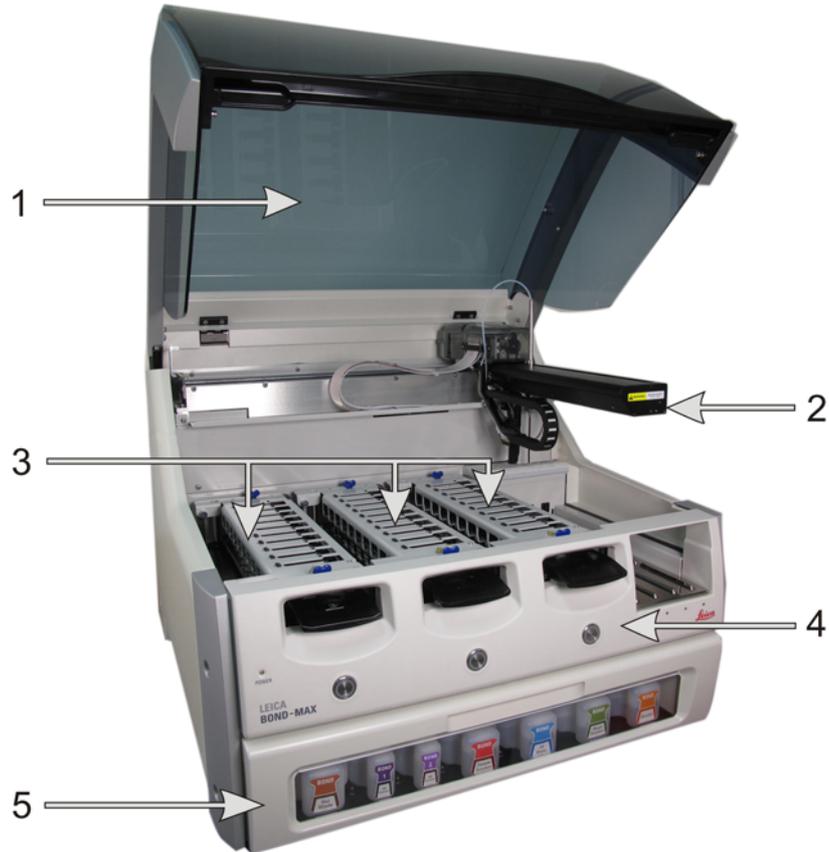


图 4: BOND-MAX 操作仪的正面视图

编号	名称 (图 4)	节
1	仪器盖	2.2.3
2	自控臂	2.2.4
3	玻片染色装置	2.2.5
4	前部防护罩	2.2.6
5	大容器槽	2.2.7

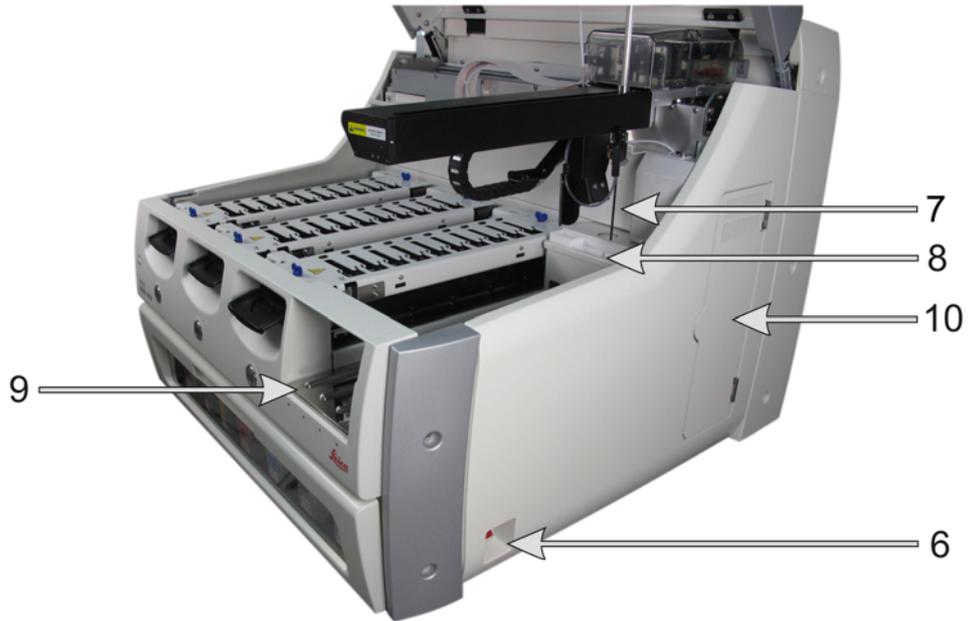


图 5: BOND-MAX 操作仪的右侧视图

编号	名称 (图 5)	节
6	电源开关	2.2.12
7	抽吸探针	2.2.8
8	洗涤区和混合站	2.2.9
9	试剂平台	2.2.6
10	注射器 (见下图)	2.2.11

关于后部防护罩的说明可参阅 [2.2.13 后部防护罩](#)。



图 6: 铰链门后面的注射器

2.2.2 操作仪初始化

当开启操作仪时，BOND 系统将执行内部检查，灌注液流系统，并将自控装置移至原本位置。主自控装置移至仪器的左后角，三个大用量液流自控装置（仅 BOND-III）移至仪器后部。

玻片染色装置初始化并恢复至解锁状态。如果发现错误或者装置处于不适合操作的状态，则初始化过程停止。

在尝试初始化操作仪之前，请检查以下项目：

- 盖子已盖严
- 大容量废液容器未超过半满
- 大容量试剂容器超过半满
- 混合站已就位
- 混合站的小瓶已清空并且清洁
- 玻片染色装置（简称为 SSA）的盖板处于关闭位置。

操作仪正面的电源指示灯变为绿色，BOND 软件显示仪器已连接。当初始化完成后，一个由三个玻片架组成的图标即显示在操作仪页签上（参阅 5.1.1 操作仪页签）。在操作仪未完全初始化之前不要尝试使用操作仪。

2.2.3 仪器盖

仪器盖在操作期间是关闭的，并有安全开关加以保护。

	关闭仪器盖时要注意双手，以防止受伤。
	<p>在操作期间，主自控装置、抽吸探针和大用量液流自控装置（仅 BOND-III）会在没有预警的情况下移动，且移动速度可能造成伤害。</p> <p>运行过程中不要试图打开仪器盖。</p> <p>不要试图绕过安全开关，它能在仪器盖被打开时停止仪器操作。</p>
	如果主自控装置和/或大用量液流自控装置在操作仪盖被打开超过大约 5 秒钟后仍继续操作，请立即联系客户支持部门。

2.2.4 主自控装置和 ID 扫图仪

主自控装置控制抽吸探针的位置以便抽吸和分配试剂。自控臂夹持 ID 扫图仪，后者用以识别装入操作仪的玻片和试剂。



图 7: 主自控装置图片, 箭头所指为 ID 扫图仪



在操作仪开关打开期间不要移动主自控装置，否则自控装置可能无法对准，从而导致染色不佳。

如果自控装置已经被移动：关闭仪器电源，等待 30 秒后再重新启动。

对于玻片，BOND 系统会扫描每张玻片标签，对其进行识别（参阅 5.1.5 在机玻片识别中的**自动玻片识别**）。

- ID 扫图仪的扫描窗口应定期清洁。
参阅 **12.9 ID 扫图仪**的操作说明。
- 如果抽吸探针断裂或弯曲，按照 **12.6.2 更换抽吸探针**中的步骤进行更换。

2.2.5 玻片染色装置



避免接触玻片染色装置及其周围区域。这些部位可能非常热，会导致严重烫伤。操作停止后应等待二十分钟时间让玻片染色装置及其周围区域冷却。



有潜在危害的试剂可能会积聚在玻片染色装置周围并污染玻片架。在处理玻片架时应确保穿戴合格的防护服和手套。

玻片是在玻片染色装置中进行处理的。每台操作仪包括三个玻片染色装置。

若要启动一次运行，操作人员应将玻片架通过前部防护罩（在 [2.2.6 前部防护罩](#) 中说明）插入，然后按下装载按钮，BOND 即会获取玻片的图像信息。如果玻片是兼容的（参阅 [6.9 玻片兼容性](#)）并且所有试剂都在位，操作者即可启动运行。关于输入玻片详细信息和装载玻片的更多说明，请参阅 [6 玻片设置](#)（在 BOND 控制器上）。

在染色处理期间，BOND 将玻片锁定在玻片染色装置中。当 BOND 正在处理玻片时，不要试图取出玻片架 – 应先放弃运行，方法是点击**系统状态**屏幕上该玻片架下方的 （参阅 [5.1.7 启动或停止运行](#)），然后解锁玻片染色装置。

关于玻片染色装置的清洁与日常维护，请参阅 [12.4 玻片染色装置](#)。

玻片染色装置加热器

	<p>操作仪中的加热器和受热表面可能有引燃的危险：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不要将易燃物放在加热器上面或附近。 - 不要将易燃物放在操作仪的任何发热表面上。 - 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。
	<p>BOND 操作仪中使用的某些试剂是易燃物质：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不要将明火或引火源放在操作仪附近 - 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。

BOND-III 和 BOND-MAX 仪器中的每个玻片位置上都有一个加热元件，每个加热元件都是独立监控的，在出现温度错误时会被标记为出错（参阅图 8）。如果显示有加热器故障，请联系客户支持部门。



图 8：单个加热器错误

不要尝试在标记为出错的位置上运行需要加热的玻片。如果某个加热器在运行期间出现故障，处于该位置的玻片就无法被正确地进行染色处理。

如果加热器故障具有安全隐患，操作仪将关闭所有加热器，包括当前正在处理的需进行温度控制的玻片的加热器。

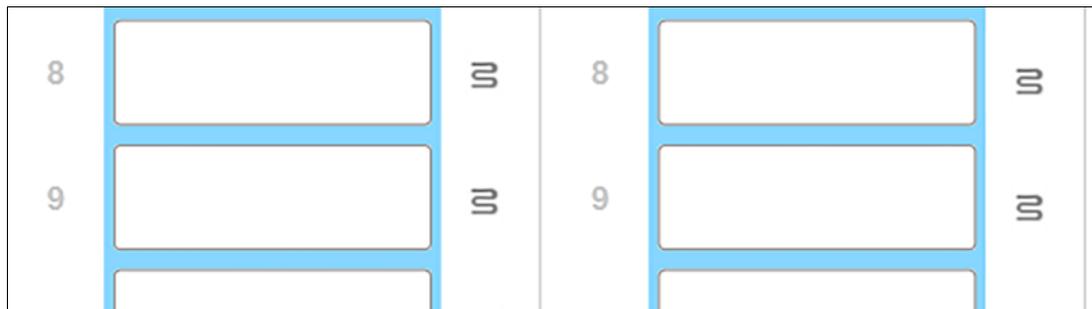


图 9：每个位置的灰色加热器符号表示加热被完全关闭。

一旦玻片加热器被关闭，您必须关闭然后重启操作仪以便解除加热器的锁定。只要被处理的玻片不需要加热，您就可以继续使用出错加热器所在的玻片位置。

2.2.6 前部防护罩

下面几张图显示了 BOND-III 和 BOND-MAX 的前部防护罩，编号的项目在图 11 下面列出。



图 10: BOND-III 前部防护罩



图 11: BOND-MAX 前部防护罩

编号	项目	编号	项目
1	电源指示灯	4	试剂平台
2	玻片架舱	5	试剂架指示灯
3	玻片架指示灯	6	装载/卸载按钮

这些项目在下面的章节中进行说明。

电源指示灯

操作说明如下：

- **关闭** – 电源关闭
- **蓝色**（当前型号）或**橙色**（原有型号）– 电源开启，但操作仪软件尚未启动
- **绿色** – 电源开启，系统正在运行。

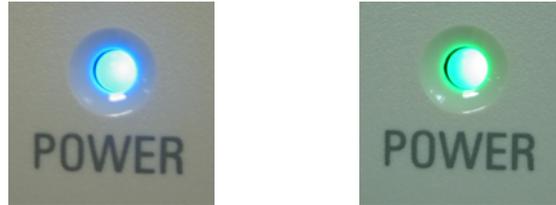


图 12：当前型号的 BOND-MAX 仪器上的电源指示灯颜色（蓝色、绿色）

玻片架舱

有三个入口（分别用于每个玻片染色装置）供玻片架插入。插入玻片架后，按“装载/卸载”按钮将其锁定在玻片染色装置中。当玻片架被锁定后，自控臂就将 ID 扫描仪移动到玻片架中的玻片上方以便自动识别玻片。

玻片架指示灯

前部防护罩上每个玻片染色装置下方的多色指示灯可指示玻片架的状态。BOND-MAX 仪器上的玻片架指示灯被并到了“装载/卸载”按钮上，当您按下这些仪器上的“装载/卸载”按钮时，指示灯变为蓝色并保持数秒钟。

玻片染色装置的指示灯颜色说明如下：

- **关闭** – 无玻片架或者玻片架未锁定。
- **持续橙色** – 玻片架已装载并锁定，但处理还未启动。
可以用“装载/卸载”按钮安全地解锁和移除玻片架。
- **持续红色** – 玻片架正在被处理。
玻片架已锁定，不能用“装载/卸载”按钮解锁。若要解除锁定，需要先在软件中放弃此次运行。
- **闪烁绿色** – 染色处理已完成且没有通知信息。用“装载/卸载”按钮解除锁定。
- **闪烁红色** – 运行已被拒绝，或者染色处理已完成但有通知信息。用“装载/卸载”按钮解除锁定。



图 13：当前型号的 BOND-MAX 仪器上的玻片架指示灯颜色（橙色、红色、绿色）

装载/卸载按钮

按下“装载/卸载”按钮，仪器将进行以下操作：

- 如果没有装入玻片架，不进行任何操作。
- 如果装入了玻片架但没有锁定，BOND 会锁定玻片架，待自控臂就位后，ID 扫图仪就会识别玻片 ID。
- 如果玻片架被锁定，但运行还未启动，BOND 将解锁玻片架。
- 如果玻片架被锁定，且运行已结束，BOND 将解锁玻片架。
- 如果玻片架被锁定，且运行正在进行中，“装载/卸载”按钮则不起作用。在使用该玻片架的运行结束或被放弃之前，您无法解锁玻片架。

如果玻片染色装置很热，您无法锁定或解锁玻片架 – 应等待染色装置冷却。

试剂平台

试剂平台是放置试剂架的地方，其中包含检测系统、7 毫升和 30 毫升的试剂容器和/或 6 毫升的滴定容器。每个试剂架最多可容纳九种试剂，试剂平台则可容纳四个试剂架。

装载试剂架时，将试剂架在平台上滑动进入锁定装置（参阅 4.1.4 装载试剂）。当自控臂就绪后，BOND 就会识别各个试剂位置的试剂。

试剂架指示灯

在每个试剂架位置下方有一个双色指示灯，其功能如下：

- **关闭** – 试剂架未被检测。
如果插入试剂架但指示灯关闭，请检查试剂架是否正确插入。
- **持续红色** – 试剂架上的某个试剂将在两分钟内被使用。
试剂架被锁定且不能被移除。
- **持续绿色** – 该试剂架中的试剂在两分钟内不会被使用。
试剂架已解除锁定并可被暂时移除。



图 14：当前型号的 BOND-MAX 仪器的试剂架指示灯颜色（红色、绿色）

2.2.7 大容器槽

BOND-III 和 BOND-MAX 的大容量试剂容器和大量废液容器都位于前部防护罩下方。BOND-MAX 还有一个用于盛装标准废液的外部容器。

参阅 [12.2 大容器](#) 中关于大容器灌装、清空和维护的说明。



为确保正确的仪器操作，应按照以颜色编码的名称标签所示，将每个大容量试剂容器放到容器槽中的正确位置。
对于 BOND-III，参阅 [图 15](#)；对于 BOND-MAX，参阅 [图 17](#)。
如果不按此操作会影响染色。



BOND 操作仪中使用的某些试剂是易燃物质：
– 不要将明火或引火源放在操作仪附近
– 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。

- BOND-III
- BOND-MAX

BOND-III

之前的 BOND-III 有两个透明舱门，用户可轻易取放所有的大容器。打开舱门时，请握住每个门顶部的拉手。

来自玻片染色装置的所有废液都会被输送到有害废液容器内。来自洗涤区的废液则根据废液中试剂的状态被输送到标准废液容器或有害废液容器内（您必须酌情将创建的试剂设置为有害试剂 - 参阅 [8.2.1 添加或编辑试剂](#)）。

每个大容量试剂容器和废液容器的重量传感器会在试剂量过低或废液量过高时向使用者发出警告。每个大容器状态的状态由 [大容器照明系统 \(BOND-III\)](#) 显示，用户可轻松地看到状态的标示。请注意此系统并未装配在之前的 BOND-III 上。

BOND-III 可在 [图 15](#) 所示的台架上容纳下列容器，从左至右为：

站台	容器	位置	容积 (L)	颜色	试剂
8	ER1	上层台架	2	紫色	BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9	ER2		2	淡紫色	BOND Epitope Retrieval Solution 2*

站台	容器	位置	容积 (L)	颜色	试剂
1	Dewax solution	下层台架	5	红色	BOND Dewax Solution*
2	去离子水		5	蓝色	去离子水
3	洗涤缓冲液		5	绿色	BOND Wash Solution*
4	乙醇		5	橙色	酒精 (试剂级)
5	大容量废液		5	灰色	标准废液
6	大容量废液		5	灰色	标准废液
7	有害废液		5	棕色	有害废液

*仅可使用 BOND 试剂。不要用其他产品代替。

如果您所在的实验室不使用抗原修复和/或脱蜡试剂容器，可以在管理客户端将其禁用 – 参阅 10.6.1 操作仪中的**禁用大容量试剂容器**。



确保每个大容器的标签颜色和印刷的文字说明与容器槽上容器正下方的标签相符。

图 15: BOND-III 大容量试剂容器已就位

大容器照明系统（BOND-III）

BOND-III 操作仪配备有大容器照明系统，如下图 16 所示。



图 16：大容器照明系统

大容器照明系统可帮助您查看每个容器的液位，正常操作时为静止的白色灯光。

灯光还可指示每个大容器的当前状态：

- 当大容器几乎为空或废液容器几乎为满时，闪烁白色灯光。
- 当大容器为空或废液容器为满时，会影响当前运行，闪烁红色灯光。
- 当大容器被移除时，其背光开关关闭且仪器槽上的标签灯闪烁白色灯光。

i 大容器照明系统仅兼容 BOND 6.0 或更新版本的软件。

请参阅 [大容器状态](#)，可进一步了解系统状态屏幕如何显示大容器的详细信息。

BOND-MAX

BOND-MAX 有一个向下打开的槽门，用于取放大容器。槽门上有一个透明面板，以便您查看大容器（也是透明的）中的试剂液位。

槽门依靠磁力门锁固定。若要打开较早型号仪器的槽门（没有把手），从槽门两侧顶端拉开即可。

i 大容器槽门在染色运行期间必须保持关闭。如果门被打开，系统状态屏幕上会显示一条警示信息（参阅 5.1.2 硬件状态），同时任何当前运行可能会暂停。

仪器产生的废液将根据废液中试剂的状态被输送到标准废液容器或有害废液容器内（您必须酌情将创建的试剂设置为有害试剂 – 参阅 8.2.1 添加或编辑试剂）。

BOND-MAX 大容量试剂容器带有液位传感器，可在试剂液位过低时发出警告；废液容器也有液位传感器，可在废液液位过高时发出警告。参阅 12.2 大容器中关于重新灌装和清空容器的说明。

BOND-MAX 可容纳以下容器，按从左到右的顺序为：

站台	容器	容积 (L)	颜色	试剂
1	有害废液	2	棕色	有害废液
2	ER1	1	紫色	BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3	ER2	1	淡紫色	BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4	脱蜡溶液	2	红色	BOND Dewax Solution*
5	去离子水	2	蓝色	去离子水
6	洗涤缓冲液	2	绿色	BOND Wash Solution*
7	乙醇	2	橙色	酒精（试剂级）

*仅可使用 BOND 试剂。不要用其他产品代替。

抗原修复和/或脱蜡试剂容器若不使用，可从仪器中取出 – 参阅 10.6.1 操作仪中的禁用大容量试剂容器。



确保每个大容器的标签颜色和印刷的文字说明与容器槽上容器正下方的标签相符。

图 17：放置到位的 BOND-MAX 大容量试剂

外部废液容器

BOND-MAX 包括一个九升的外部标准废液容器。

提供的容器有两个容器盖 – 一个用于连接器，另一个用于清空废液。切勿卸下此容器上的连接器盖。



图 18: BOND-MAX 外部废液容器

液流管连接至操作仪后部防护罩右下角的一个推合式接口上。液位传感器连接至防护罩左上角的一个三脚接头上 (参阅图 26)。

参阅 [12.2.4 外部废液容器 \(仅 BOND-MAX\)](#) 关于外部容器的清空和维护说明。

	<p>免疫组织化学和原位杂交中使用的某些试剂具有危害性。继续操作前应确保您已接受过足够的有关此操作的培训：</p> <p>a) 穿戴好乳胶或丁腈手套、防护眼镜及其他合适的防护服，然后再接触试剂或清洗仪器。</p> <p>b) 使用和处理试剂及浓缩物时应遵从所有相关的实验室操作程序和政府法规。</p>
	<p>BOND 操作仪中使用的某些试剂是易燃物质：</p> <ul style="list-style-type: none"> 不要将明火或引火源放置在操作仪附近。 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。
	<p>清空外部废液容器之前，切记断开传感器和液流接头（按此处所述顺序断开连接）。不可在仍有线缆和管路连接的情况下尝试从容器中倾倒液体。</p>

2.2.8 抽吸探针

抽吸探针从容器中抽取试剂，将试剂输送至玻片染色装置中的玻片上，并在混合站中混合显色剂。它装有一个液位传感器以检测试剂液位（参阅 [8.3.1 测定试剂量](#)）。

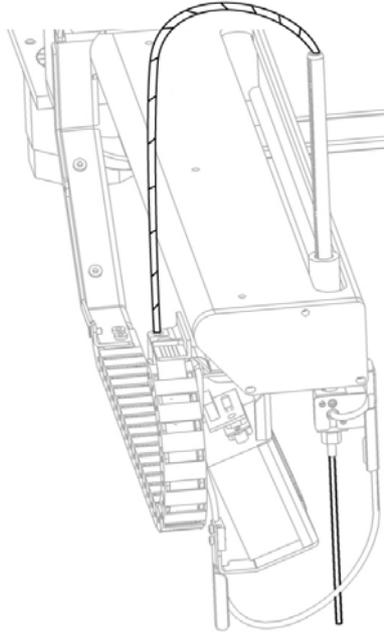


图 19: 自控臂中的抽吸探针

每个容器都有一个探针无法触及的残留容量，这一容量称为“无效容量”。各种类型容器的无效容量是不同的（无效容量数值请参阅 [19 规格](#) 章节中 [工作规格](#)）。

参阅 [12.6 抽吸探针](#) 关于抽吸探针维护的说明。

2.2.9 洗涤区和混合站

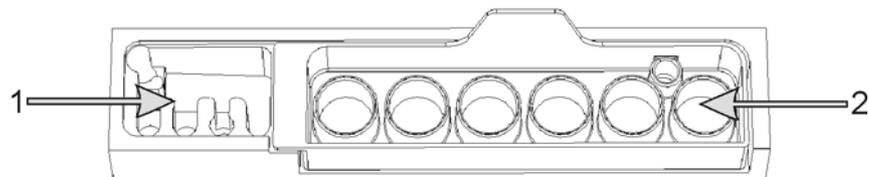


图 20: 插入了混合站的洗涤区
洗涤区域在左侧（1），混合站在右侧（2）

左侧的洗涤区中有多个小孔，用于清洗抽吸探针。

洗涤区的右侧是混合站。混合站由六个凹槽组成，这些就是混合瓶，用于配制因保存期短而必须在使用前现用现配的试剂。试剂的混合由软件根据试剂类型来决定。

- i** BOND 会跟踪监测混合站的状态，如果监测到混合站不处于清洁和空闲状态（参阅 5.1.2 硬件状态），则仪器就不会进行初始化。如果在初始化期间收到通知信息表明混合站不清洁或其中有液体，应先确认混合站已清洁并空闲，然后再点击通知对话框中的**确定**。如果您继续使用已脏污和/或未空闲的混合站，则试剂可能会被污染，或混合瓶可能会溢出。
- i** 必须确保有一个混合站 – 如果没有，操作仪将不会进行初始化。在初始化期间，BOND 将扫描混合站上的标签以检查其是否存在。如果软件无法检测到此 ID，将显示一条信息，提示您确认混合站已存在。

参阅 12.7 洗涤区和混合站关于混合站维护的说明。

2.2.10 大用量液流自控装置（仅 BOND-III）

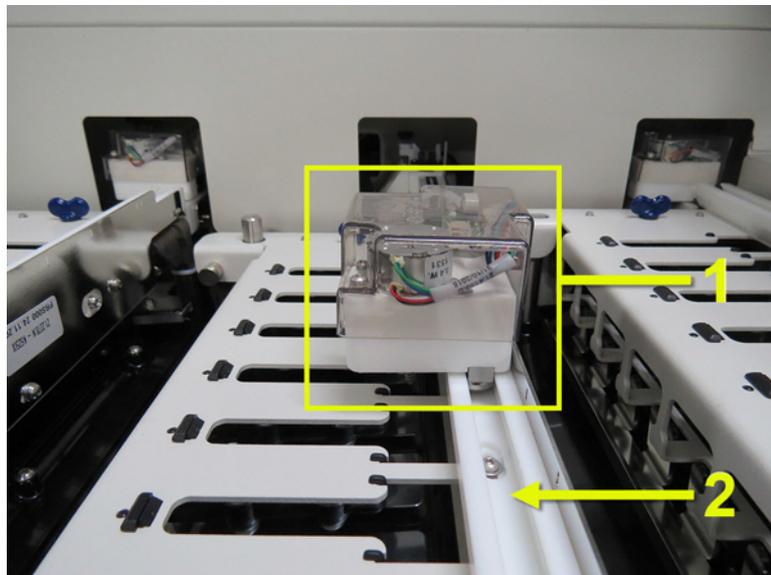


图 21: BOND-III 的大用量液流自控装置 (1) 沿着玻片染色装置上的导轨 (2) 移动



如果主自控装置和 / 或大用量液流自控装置在操作仪盖被打开超过 5 秒钟后仍继续操作，请联系客户支持部门。

BOND-III 仪器有三个大用量液流自控装置，它们沿着每台玻片染色装置上的导轨移动，将试剂分配给装载的所有玻片。自控装置仅输送大容量试剂，而抽吸探针则输送试剂平台中容器内的试剂和某些大容量试剂。每个大用量液流自控装置都有一个洗涤区供冲洗和清洁分配探针。

手动将大用量液流自控装置返回原本位置

如果某个大用量液流自控装置停止工作并且位于玻片染色装置导轨内，可以按“装载/卸载”按钮使其返回原本位置。如果大用量液流自控装置仍停在玻片染色装置上，可执行以下步骤，以手动方式将其返回原本位置，并取出玻片染色装置中的玻片。

1. 确保操作仪已空闲，其中没有计划运行或正在处理的玻片，然后关闭仪器。
2. 轻轻抬起大用量液流自控装置上的分配装置（参阅图 22）直至探针抬离盖板。
3. 将自控装置沿着导轨推到玻片染色装置后侧，动作应缓慢、平稳，不可推得太快。



推到自控装置刚好离开盖板边栏为止 – 切勿将其推到尽头。

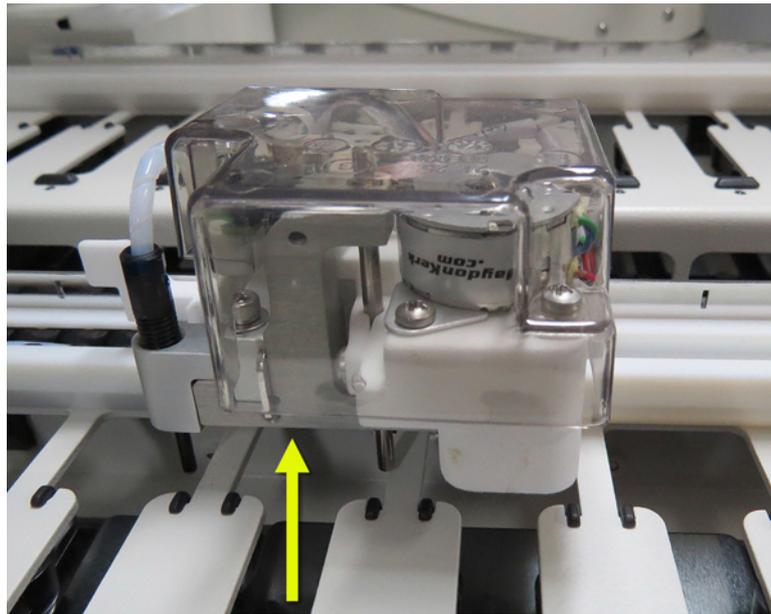


图 22：抬起如图所标的分配部件并将大用量液流自控装置沿着玻片染色装置的导轨推动

4. 自控装置离开盖板后，关闭仪器盖并重新开启操作仪。玻片染色装置应解除锁定，作为初始化程序的一部分。
若玻片染色装置未解除锁定，可参阅 [12.4.1 手动解锁玻片染色装置](#) 关于如何取出玻片架的说明。
5. 取出玻片架和玻片。

2.2.11 注射器

注射器抽吸并分配 BOND 系统所需的精确容量的试剂溶液。参阅 [12.13 注射器](#) 关于注射器维护的说明。



确保在正常操作期间注射器门已关闭 (BOND-MAX) 或注射器护板已安装 (BOND-III)。如果注射器或注射器部件松动，试剂在压力下可能会从注射器中喷出。

BOND-III

BOND-III 有四个注射器泵，位于前部防护罩下方。从左至右的前三个注射器泵分别由上方的玻片染色装置 SSA1、SSA2 和 SSA3 的大用量液流自控装置所使用，第四个注射器泵为主注射器泵，由抽吸探针使用。

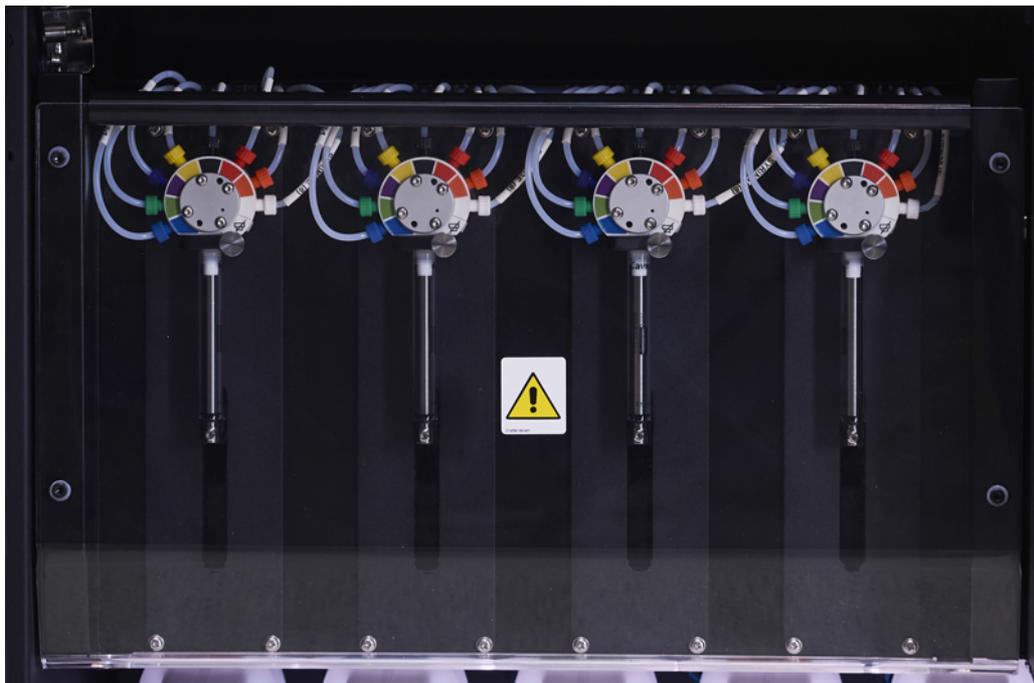


图 23: BOND-III 注射器



确保注射器组件已完全关闭，然后再启动运行或初始化操作仪（参阅 [12.4.1 手动解锁玻片染色装置](#)）。否则，会导致注射器在操作期间被损坏。

BOND-MAX

BOND-MAX 仅有单个注射器泵，位于仪器右侧的一个隔槽中。这是一个 9 孔注射器阀（其中一个孔不使用），带有旋入式注射器筒和小型夹具。



图 24: BOND-MAX 9 孔注射器

要检查注射器部件的状态，按一下注射器门前部中间的圆片，打开注射器门。



必须穿戴防护服和手套。

在初始化期间定时检查，必要时或看到提示时应更换 – 参阅 [12.13 注射器](#)。

2.2.12 电源开关

电源开关是位于操作仪右侧防护罩上的一个摇臂开关，用于开启和关闭操作仪。

- 关于 BOND-III 的电源开关位置，参阅[图 3](#)。
- 关于 BOND-MAX 的电源开关位置，参阅[图 5](#)。

2.2.13 后部防护罩



不要取下操作仪防护罩或尝试接触内部组件。BOND 操作仪内部存在危险电压，只有 Leica Biosystems 认可的合格的维修技师方可执行此类任务。

BOND-III

图 25 显示了 BOND-III 操作仪的后部防护罩。

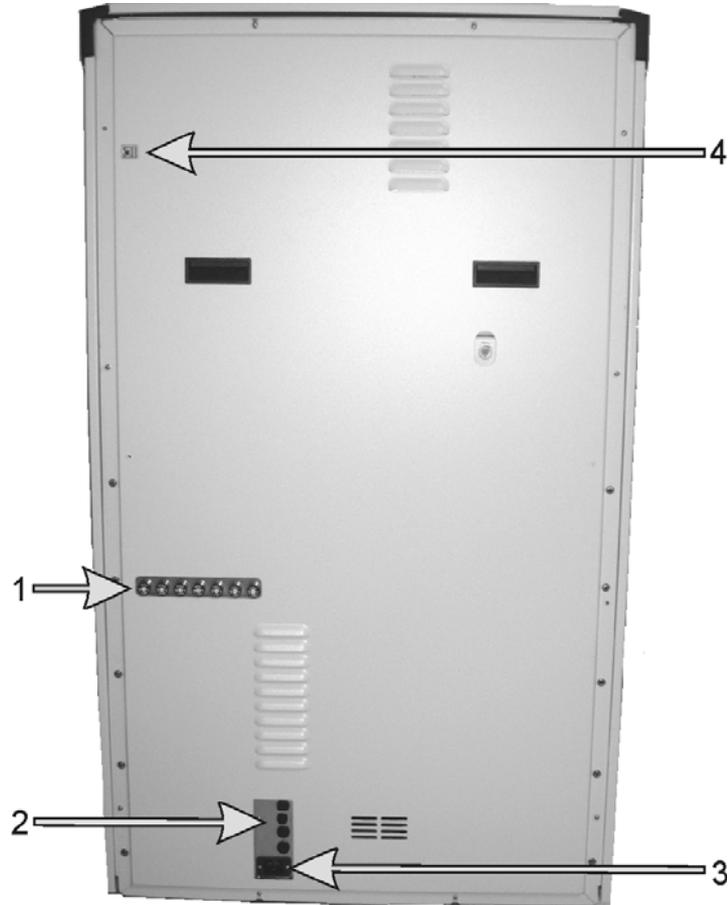


图 25: BOND-III 后部防护罩

编号	项目	编号	项目
1	断路器	3	主电源连接
2	保险丝	4	以太网连接

参阅 [12.14 电源保险丝](#) 关于更换保险丝的说明。



不要使用 BOND-III 后部防护罩上的两个黑色把手抬起仪器。

BOND-MAX

图 26 显示的是 BOND-MAX 操作仪的后部防护罩。（注意：较早型号的仪器只有一个电源风扇。）



图 26: BOND-MAX 后部防护罩

编号	项目	编号	项目
1	断路器	5	外部废液连接 – 用于管线（参阅 12.2.4 外部废液容器（仅 BOND-MAX））
2	电源风扇	6	外部废液连接 – 用于液位传感器（参阅 12.2.4 外部废液容器（仅 BOND-MAX））
3	保险丝	7	以太网连接
4	主电源连接		

参阅 12.14 电源保险丝关于更换保险丝の説明。

断开操作仪连接

要断开 BOND 操作仪的主电源连接，请按如下步骤操作：

1. 使用操作仪右侧的开关关闭电源。
2. 沿着操作仪的主电源连接（图 25 中的 3 和图 26 中的 4）电缆找到墙壁电源，关闭墙壁插座的主电源供应。
3. 从操作仪的背面断开插头。

2.3 BOND 控制器和终端

所有 BOND 系统都包括一台 BOND 控制器，软件处理全都在这台控制器中进行。单座安装（参阅 3.1.1 单座配置）使用一台配备了键盘、鼠标和显示器的控制器来运行客户端软件。单座安装足以运行五台或五台以内的操作仪。

使用 BOND-ADVANCE 安装（参阅 3.1.2 BOND-ADVANCE）且配备超过五台操作仪的实验室还需另外配备 BOND 终端机。在这些安装中，用户与 BOND 软件的大多数互动都在终端机上进行，每个终端都可控制任意一台或所有操作仪。也可以多台终端机上控制同一台（或多台）操作仪。

BOND 控制器仍继续执行所有的软件处理。BOND-ADVANCE 安装中的控制器的规格要高于单座安装中的控制器，并包括多级冗余以确保极高的可靠性。

有些 BOND-ADVANCE 安装包括一台辅助（后备）控制器。这台控制器能记录主控制器上的全部处理数据，并且在主控制器功能异常时可以被切换使用。理想情况下，辅助控制器不应安放在主控制器附近，以降低因局部地区事件导致两台控制器同时被损坏的风险。

玻片标签打印机和手持式条形码扫描仪在单座安装中连接至控制器，而在 BOND-ADVANCE 安装中则连接至各台终端机。



BOND 控制器中的操作系统和软件用于对 BOND 系统进行最佳控制。为了避免出现系统控制被延迟或受到干扰的可能性，不要在 BOND 控制器或终端上安装任何其他软件。

2.4 手持式条形码扫描仪

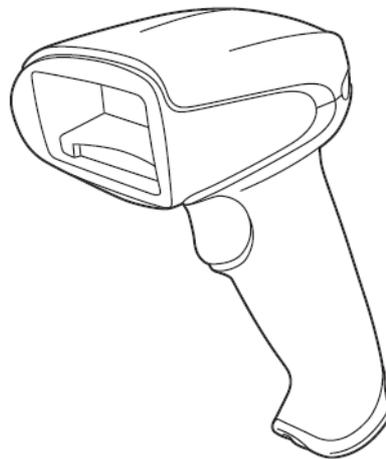


图 27：手持式条形码扫描仪

USB 接口手持式条形码扫描仪连接至控制器（单座安装）或终端机（BOND-ADVANCE 安装），用于登记试剂，当使用 1D 或 2D 条形码 ID 时还可用于识别玻片（参阅 [6.5.6 手动识别玻片](#)）。

- i** 如果您的 BOND 系统已从早前版本升级，您可以继续使用已有的条形码扫描仪。但是较早型号不支持 2D 条形码。

在安装 BOND 系统时，手持式条形码扫描仪即应同时安装而且可以正常操作。参阅 [13.1 手持式条形码扫描仪](#) 中关于维护和设置的说明。

2.4.1 使用手持式条形码扫描仪

- i** 早期型号的 Symbol 条形码扫描仪发射激光，而新型号的霍尼韦尔 (Honeywell) 条形码扫描仪发射 LED 光。注意以下激光危险警告：

	<p>激光危险。可能会对眼睛造成严重伤害。避免眼睛直视激光束。</p>
---	-------------------------------------

识读条形码时，将扫描仪对准条形码，然后按下触发按钮。对准扫描时应使红色光线覆盖条形码的整个长度。当条形码被识别后，扫描仪发出蜂鸣音，同时指示灯变为绿色。如果条形码未能被识别，扫描仪将持续发出蜂鸣音，而指示灯则变为红色。

- i** 不要让条形码过于靠近扫描仪。如果扫描仪不能识别条形码，可尝试将条形码移远一些。当扫描仪放置在其支架上时是免提使用的，不需要在读取条形码时按下触发器。

2.5 玻片标签仪

单座 BOND 系统包括一台玻片标签打印机（称为“玻片标签仪”），连接在控制器上。BOND-ADVANCE 安装中则有一台单独的玻片标签仪连接至每台终端机。

玻片标签仪打印不干胶标签，用于粘贴在玻片上以便识别。所有的标签都包含一个用条形码或字母数字字符表示的唯一玻片 ID（参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#)）。当玻片被载入操作仪中时，BOND 利用这些 ID 来自动识别玻片。您可以设置需显示在标签上的其他信息以及 ID – 参阅 [10.3 标签](#)。

有些实验室使用的玻片标签是从自己的实验室信息系统（LIS）系统中打印的，但 BOND 玻片标签仪仍可包含在这些系统中用于由 BOND 临床客户端创建的玻片。

玻片标签仪是作为 BOND 标准安装的一部分而配备的。如果要增加或更换一台玻片标签仪，应在管理客户端的**硬件**屏幕中进行设置（参阅 [10.6.3 玻片标签仪](#)）。使用随标签仪提供的说明书查阅关于标签和纸带更换以及清洁的信息。

	<p>仅可使用 BOND 玻片标签和打印纸带。这些标签在 BOND 中处理时可保持牢固粘贴且内容清晰。</p>
---	---

2.6 辅助设备

本节描述与 BOND 系统配合使用的辅助设备。

- [2.6.1 玻片](#)
- [2.6.2 BOND-III 和 BOND-MAX 消耗品](#)
- [2.6.3 试剂系统和容器](#)

2.6.1 玻片

仅可将尺寸正确的玻璃玻片用于 BOND 操作仪。错误尺寸的玻片可能无法被恰当地置于玻片架上，而 Covertile 也不能合适地盖在玻片上。这些皆可能影响染色质量。

Leica Biosystems 建议使用专门用于 BOND 系统的 Leica BOND Plus 玻片。除了尺寸最适合 BOND 玻片架和 Covertile 以外，这些带正电荷的玻片上都带有标记，可显示 100 μ L 和 150 μ L 分配量时标本组织应当放置的部位（参阅 [6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置](#)）。

如果您使用自己的玻片，则必须符合以下规格：

尺寸	宽度：24.64 – 26.0 毫米（0.97 – 1.02 英寸） 长度：74.9 – 76.0 毫米（2.95 – 2.99 英寸） 厚度：0.8 – 1.3 毫米（0.03 – 0.05 英寸）
标签区域	宽度：24.64 – 26.0 毫米（0.97 – 1.02 英寸） 长度：16.9 – 21.0 毫米（0.67 – 0.83 英寸）
材料	玻璃，ISO 8037/1 标准



不要使用损坏的玻片。确保所有玻片都已在玻片架上正确对位后，再装入操作仪。



不要使用圆角或切角的玻片。这类玻片会从玻片架上掉落，可能会改变 Covertile 下面的液体流量，从而影响染色质量。

2.6.2 BOND-III 和 BOND-MAX 消耗品

BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertile 是透明的塑料盖片，在染色期间覆盖在玻片上。利用毛细管作用将分配给玻片的试剂吸收到 Covertile 和玻片之间，确保试剂轻柔、均匀地覆盖组织。Covertile 可使所需的试剂量减至最低，同时防止玻片在试剂分配间隔期间干燥。Covertile 是 BOND 染色系统的必备部件，必须使用。

玻片放到玻片架上后，盖上 Covertile（参阅 [装载玻片](#)）。确保 Covertile 放置得当，每个 Covertile 颈部的卡栓（右图中画圈处）应固定在玻片架上的卡槽中。

有两种 Covertile 设计，二者可互换使用。新设计包含了几个特征（**Leica** 字样、顶端左侧的一个小圆圈标记和一个凸出角），能更明显地指示 Covertile 是否已正确地放置在玻片上。

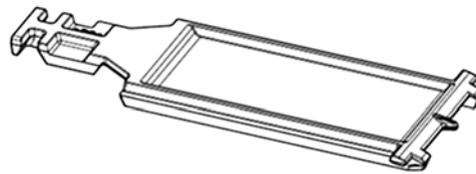
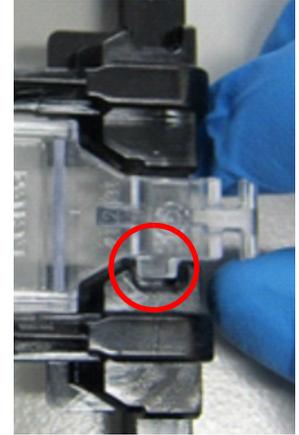


图 28: BOND Universal Covertile（原设计）

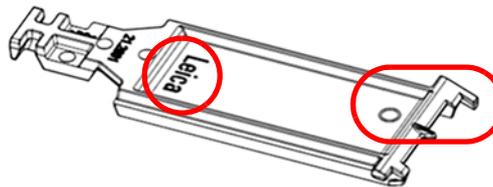


图 29: BOND Universal Covertile（新设计）

只要没有严重变色或受损，并且清洗方式正确，Covertile 可以重复使用达 25 次（参阅 [12.3 Covertile](#)）。丢弃损坏的 Covertile。

- ⓘ 有些检测系统（如 Bond™ Oracle™ HER2 ICH 系统和 Leica HER2 FISH）需要使用新的（未使用过的）Covertile。使用前应先查阅相关的使用说明。

玻片架

在将玻片装入 BOND 操作仪时，要用玻片架固定玻片并盖好 Covertile。每个玻片架可放置 10 张玻片。有两种玻片架设计，二者可互换使用。

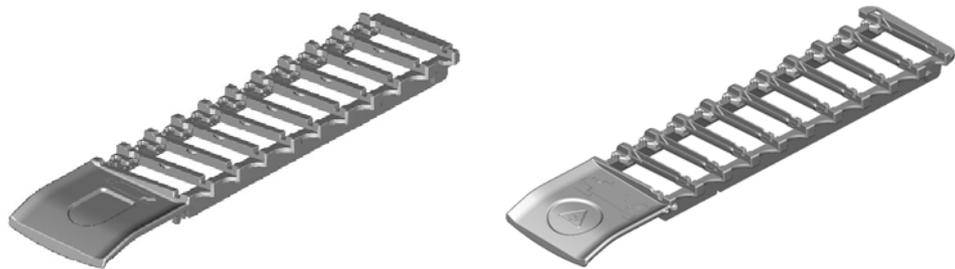


图 30：玻片架（左图为原设计，右图为新设计）

关于将玻片和 Covertile 装入操作仪的说明，请参阅 [装载玻片](#)。

试剂架

试剂架可容纳 7 mL 和 30 mL 的 BOND 试剂容器，以及 6 mL 的 BOND 滴定容器。试剂架放在操作仪的试剂平台中（参阅 2.2.6 前部防护罩中的 [试剂平台](#)）。

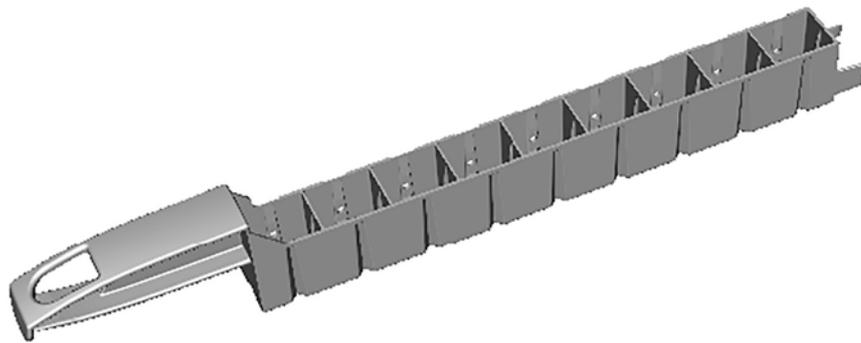


图 31：试剂架

按照距离把手最远（位置 1）到距离把手最近（位置 9）的顺序，对试剂架上的容器位置进行编号。关于将试剂装入操作仪的说明，请参阅 [4.1.4 装载试剂](#)。

2.6.3 试剂系统和容器

试剂架可容纳一系列类型的试剂容器。

试剂系统

试剂系统是试剂架中预定义的试剂组。BOND 使用三种类型的试剂系统：

- BOND 检测系统
- Leica 诊疗系统
- BOND 清洗系统

参阅 [8.1 试剂管理概述](#) 了解关于各种系统的详细说明。

试剂系统的登记方法是扫描试剂架侧面的条形码，而不是扫描其中各个容器上的条形码标签。组成试剂系统的试剂容器不用单个登记，它们被锁定在试剂架中，不应取出或重新安排。当试剂系统用完或过期时，丢弃整个试剂架和其中的容器。

BOND 即用型试剂

BOND 即用型试剂使用的容器被固定在试剂架上，这些试剂的浓度是专为 BOND 系统而优化的，因此只需进行登记，并在使用前打开即可。

容器装有不同容量的试剂，从 3.75 mL 至 30 mL 不等，具体取决于试剂的种类。

开放容器

开放容器是指空的、清洁的、用于盛装用户自备试剂（例如一抗）的容器，容量有 7 mL 和 30 mL 两种。开放容器只能用于盛装一种试剂，可以重新灌装，因此每个容器最多可输送 40 mL 的试剂（参阅 [8.3.2 试剂或试剂系统详细信息](#) 中的 [重新灌装开放试剂容器](#)）。

BOND 系统仅应使用 BOND 开放容器 – 不要尝试使用其他容器（滴定容器除外）盛放用户自备的试剂。

滴定容器

另外还有专用的滴定容器（参阅 14.2 标本制备中的 [Titration Kit（滴定试剂盒）](#)）。这类容器包括一个可拆除的 6 mL 插管，以便更换容器中的试剂（例如在进行浓度优化时）。与开放容器一样，每个滴定容器可以重新灌装，用于输送多达 40 mL 的试剂，且使用的插管数量不受限制。Leica Biosystems 提供的 BOND 滴定套盒中每个容器配有十支插管。

2.7 重新安放仪器

	<p>如需远距离搬运操作仪，或者送修或处置时，应联系客户支持部门。操作仪很重，且不应由用户来搬运。</p>
	<p>不要封堵位于仪器后部防护罩上的通气口。此外，不要盖住注射器门上的通气口 (BOND-MAX)。</p>

若要短距离搬动 BOND 仪器进行重新安放，搬运前请考虑以下几点：

- 确认地面能够承受仪器的重量，查阅 **19 规格** 章节中**物理规格**描述的仪器尺寸，并在搬运前咨询当地的有关规定。
- 在操作仪运转之前评估电磁干扰情况。
- 不要在紧邻强电磁辐射源处使用 BOND 仪器。例如，未屏蔽的有意射频源会干扰仪器的正常操作。
- 不要用叉车抬起 BOND 仪器。
- 仅可使用随仪器提供的电源线，并确保操作者可以够到电源连接处的电线插头。
- 搬运仪器前确保电源线和以太网线已断开连接。
- 确保足够的通风。
- 搬动仪器前清空废液容器。
- 确保在搬运之前解锁 BOND-III 仪器（或 BOND-MAX 的推车）上的全部四个滚轮，并在安放到新位置后再将它们重新锁定。

2.8 仪器停止使用和处理

必须根据现有的相应当地法规处理仪器或仪器的部件。

3

软件概述 (在 BOND 控制器上)

本章旨在帮助您熟悉 BOND 软件的一般性能。有关使用该软件运行操作仪以及管理玻片、病例和试剂的说明，请参阅相关章节。有关管理客户端程序的说明，请参阅 [10 管理客户端 \(在 BOND 控制器上\)](#)。

- [3.1 系统构架](#)
- [3.2 启动和关闭 BOND 软件](#)
- [3.3 用户角色](#)
- [3.4 临床客户端界面概述](#)
- [3.5 BOND 看板](#)
- [3.6 通知、警告和警报](#)
- [3.7 报告](#)
- [3.8 帮助](#)
- [3.9 关于 BOND](#)
- [3.10 BOND 数据定义](#)
- [3.11 软件更新](#)

3.1 系统构架

BOND 版本 6.0 软件与之前的 BOND 版本日常使用相似，但对界面的外观进行了变更。

用户通过两个“客户端”（实际上是两个单独的程序）与 BOND 软件进行互动。这两个客户端是临床客户端（或简称“客户端”）和管理客户端。临床客户端用于日常操作 – 设置准备进行染色处理的试剂、程序、病例和玻片，然后监测和控制操作仪中的染色运行。管理客户端用于进行高级设置，这些设置在初次设定后即极少更改。这些设置包括玻片标签设置、硬件连接和用户帐号（参阅 [10 管理客户端 \(在 BOND 控制器上\)](#)）。

- [3.1.1 单座配置](#)
- [3.1.2 BOND-ADVANCE](#)

3.1.1 单座配置

单座安装仅有一台“BOND 控制器”，该控制器是用户与 BOND 软件互动的单一站点（并通过该站点控制操作仪）。BOND 控制器执行所有的系统软件操作，并维护用于存储病例和玻片信息的系统数据库。控制器包括键盘、鼠标和显示器，以及连接的玻片标签打印机和扫描仪。

单座安装最多限有五台操作仪。如果您需要更多操作仪，需升级到 BOND-ADVANCE。

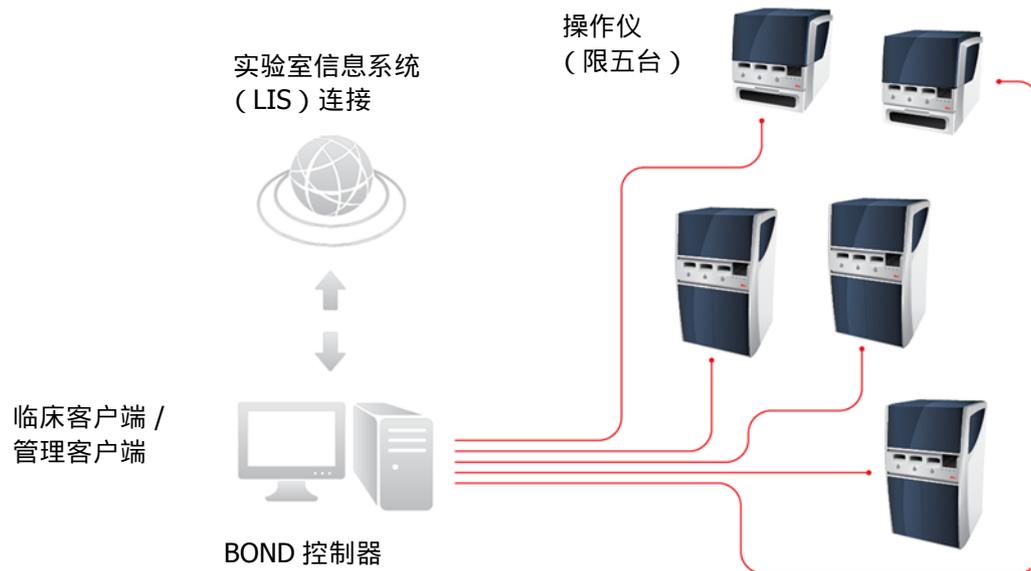


图 32：单座安装示意图

3.1.2 BOND-ADVANCE

BOND 安装若超过五台操作仪，则被配置为多座 BOND-ADVANCE 安装。BOND 控制器仍负责执行整个系统的所有软件操作，但大多数输入来自 BOND-ADVANCE 终端，这些终端位于其控制的操作仪工作单元（在 BOND 软件中称为“仪器组”）附近。仪器组是在管理客户端定义的。

与控制器相连的显示器显示“BOND 看板”，看板可显示系统中每台操作仪的实时状态概要（参阅 [3.5 BOND 看板](#)）。看板也可以根据使用要求连接到专用终端上。管理客户端程序可以在任何一台终端机上运行。

有些实验室可以安装一台辅助控制器，用于实时备份全部 BOND 数据，还可以在主控制器发生故障时进行切换控制。详细的操作说明可参阅 [16.2 切换至辅助控制器](#)。

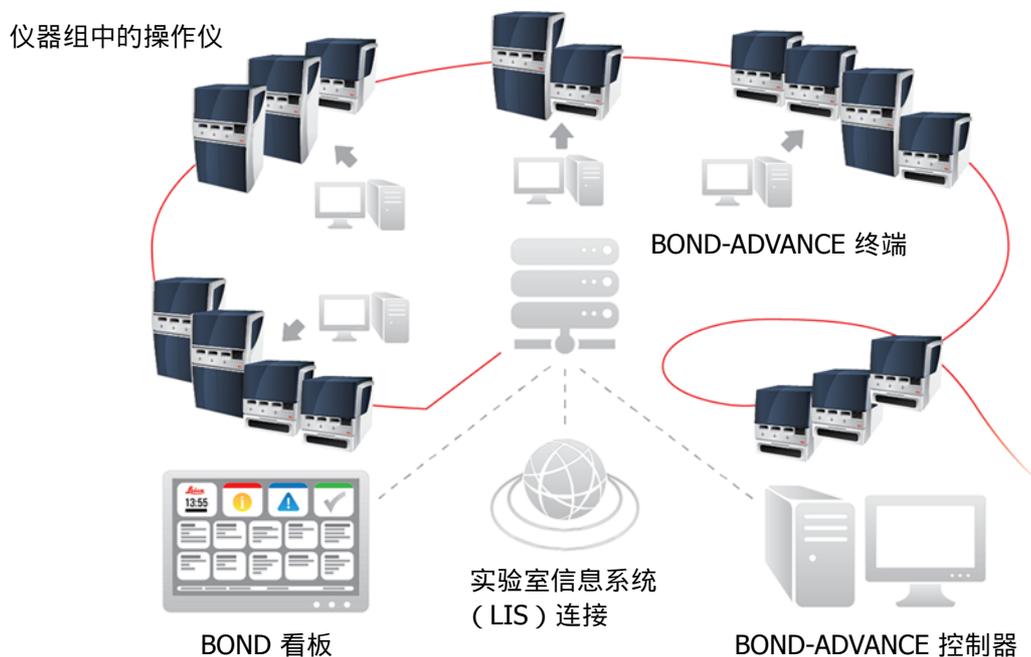


图 33：一种 BOND-ADVANCE 安装示意图 – BOND-ADVANCE 终端机通过 BOND-ADVANCE 控制器控制仪器组中的操作仪。

3.2 启动和关闭 BOND 软件

正在启动

您可以在启动任何联机操作仪之前或之后启动 BOND 软件。启动软件的方法如下：

1. **单座：**若有必要，启动 BOND 控制器，以“BONDUser”用户身份登录至 Windows® 系统。向实验室管理人员索取密码。

BOND-ADVANCE：若有必要，启动 BOND-ADVANCE 控制器。看板应自动打开（若没有，双击 Windows 桌面上的 **BONDDashboard**（BOND 看板）快捷图标。按下 <F11> 将 Internet Explorer 设置为全屏模式）。

启动您想使用的终端机，以“BONDUser”用户身份登录至 Windows。找实验室管理人员索取密码。注意，当系统为新建时未设置初始密码。



BONDUser 的密码将定期失效，当您登录后看到提示时，必须更改密码。

2. 双击相应的桌面图标启动临床客户端或管理客户端程序（或二者皆启动 – 它们可以同时运行）。
3. 输入您的 BOND 用户名和密码。

如果是打开 BOND-ADVANCE 系统中的临床客户端，您可以选择想要连接的仪器组。



BOND-ADVANCE 临床客户端能记忆上一次选择的仪器组。

您可以随时在登录对话框中更改密码。应遵守实验室的密码更换频率和密码强度要求。BOND 的要求是密码长度为 4–14 位字符并包含至少一位数字。

4. 点击**登录**。

系统将显示选中的临床客户端屏幕或管理客户端屏幕。标题栏显示当前登录用户的用户名。如果您是接替另一名用户，您应当让该用户登出，然后用自己的用户名再次登录。对于 BOND-ADVANCE，标题栏还会显示当前选定的仪器组。



因为 BOND 软件将控制重要硬件和存储敏感数据，不要在 BOND 控制器上运行其他应用程序 – 这将使仪器保修条款失效。不要将 BOND 控制器用于通用计算。

桌面背景

采用不同的 Windows 桌面背景的目的是区分当前登录的 Windows 用户类型，以及当前连接的控制器或终端的角色。

单座

正常情况下，您会看到“控制器 BONDUser”背景，但如果维修工程师在场，您可能会看到“控制器 BONDService”背景。参阅图 34。

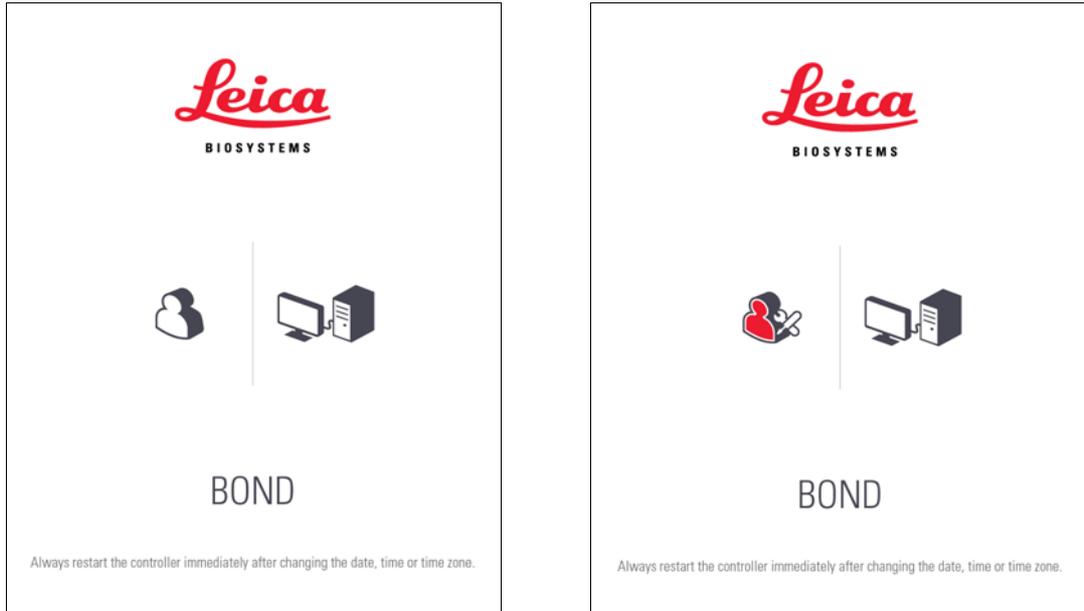


图 34：单座桌面背景：“控制器 BONDUser”和“控制器 BONDService”

BOND-ADVANCE

在 BOND-ADVANCE 桌面背景中，已连接的控制器或终端的图标会根据其角色而变化。参阅图 35 中的示例。



图 35：终端机、单机控制器、主控制器和辅助控制器的图标

您还会看到代表不同类型用户的图标。参阅图 36。



图 36：BONDUser、BONDService、BONDControl 和 BONDDashboard 的图标

关闭

若要关闭临床客户端或管理客户端程序，点击功能栏中右侧的**登出**图标。如果要完全关闭 BOND 系统，可以在关闭操作仪之前或之后关闭软件。



如果需要更改用户，您可以在玻片运行仍在进行时关闭临床客户端，但是，不要让操作仪在不打开客户端时的运行持续任何时间长度，因为您将无法看到警告或警报信息。运行期间切不可关闭 BOND 控制器。

3.3 用户角色

BOND 中有三种用户角色：

- 操作员：可更新试剂清单，创建病例和玻片，启动和控制染色运行，创建和编辑医生，以及生成报告。
- 主管：创建并编辑程序、试剂和模板。
- 管理员：可访问管理客户端程序，从中管理 BOND 用户，设定整个系统的设置。

用户可以有多个角色。主管将自动获得操作员角色。只有拥有管理员角色的用户才能运行管理客户端程序，而只有拥有操作员或主管角色的用户才能运行临床客户端程序。

用户的创建及其角色的设置需在管理客户端的**用户**屏幕上进行（参阅 [10.1 使用者](#)）。

i 当前登录用户的用户名会显示在客户端窗口的标题栏中。

3.4 临床客户端界面概述

在临床客户端屏幕的顶部和左侧有一些在该软件的所有页面中都常见的功能。本节将对这些功能以及该软件的一般功能予以说明。

- [3.4.1 功能栏](#)
- [3.4.2 操作仪页签](#)
- [3.4.3 排序表格](#)
- [3.4.4 日期格式](#)

3.4.1 功能栏

功能栏位于 BOND 软件屏幕的顶部，用于快速访问 BOND 软件的主要部分。



点击功能栏上的一个图标可转至一个屏幕或执行一项具体功能，如下表所述。

图标	显示的屏幕 (或执行的功能)	用途
	玻片设置	在 BOND 软件中创建病例和设置玻片。 更多信息请参阅 6 玻片设置 (在 BOND 控制器上) 。
	程序设置	编辑和管理程序。 更多信息请参阅 7 程序 (在 BOND 控制器上) 。
	试剂设置、试剂清单和试剂模板 (3 个页签)	设置新试剂；管理试剂清单；以及创建试剂模板 (用于加快玻片创建速度的标记设置)。 更多信息请参阅 8 试剂管理 (在 BOND 控制器上) 。
	玻片历史	显示已在 BOND 系统中运行的玻片的详细信息； 查看单个玻片、运行和病例的详细信息。 更多信息请参阅 9 玻片历史 (在 BOND 控制器上) 。
	搜索	通过扫描条形码或手动输入玻片 ID 或试剂 ID 查找玻片、试剂容器和试剂系统。会有一个统一的搜索对话框，其中的搜索内容 (玻片或试剂) 由系统自动查找。参阅 6.5.6 手动识别玻片 或 8.1.1 基本信息中的试剂识别 中的进一步说明。
	帮助	打开本用户手册。
	登出	登出客户端。
	备份失败	数据库备份未能成功完成。 更多信息请参阅 10.5.3 数据库备份 。

图标	显示的屏幕 (或执行的功能)	用途
	实验室信息系统 (LIS) 未连接	实验室信息系统 (LIS) 模块已安装, 但当前未连接到实验室信息系统 (LIS)。更多信息请参阅 11.3 实验室信息系统 (LIS) 连接与初始化 。
	实验室信息系统 (LIS) 已连接	实验室信息系统 (LIS) 模块已安装, 且当前已连接到实验室信息系统 (LIS)。更多信息请参阅 11.3 实验室信息系统 (LIS) 连接与初始化 。
	实验室信息系统 (LIS) 通知	未解决的实验室信息系统 (LIS) 通知数量。 更多信息请参阅 11.4 实验室信息系统 (LIS) 通知 。

屏幕的左上角是 Leica Biosystems 标志。点击该标志可显示关于 **BOND** 对话框。参阅 [3.9 关于 BOND](#)。

屏幕的右上角可显示警告和状态图标。参阅 [11 实验室信息系统 \(LIS\) 集成 组件 \(在 BOND 控制器上\)](#) 和 [10.4.2 修订记录](#)。

3.4.2 操作仪页签



屏幕左侧的页签可打开客户端所连接的仪器组中各台操作仪的**系统状态**、**程序状态**和**维护**屏幕。页签本身可显示关于各操作仪当前状况的一些信息 (参阅 [5.1.1 操作仪页签](#))。

系统状态屏幕显示各台操作仪的状态, 而**程序状态**屏幕则显示正在运行的程序的进度。**维护**屏幕中的命令用于一系列维护操作。

3.4.3 排序表格

BOND 软件中的许多屏幕以表格方式显示数据。点击列标题可按照该列中的值排序。标题旁出现一个尖角向上的三角形表示表格将按升序排列 (0-9, A-Z); 再次点击则按降序排列, 三角形的尖角向下。

若要对两个列进行排序, 点击第一个需依照其排序的列, 然后按住 <Shift> 键, 同时点击第二个列。第一个列中的值的顺序不变, 但当多个行中存在与第一个列相同的值时, 第二个列中的这些行就将依据这些值进行排序。

您还可以重新调整列宽, 也可以将列拖放到表格中的另一位置。

您对表格排序以及列的宽度和位置所做的任何更改都将被保存直至登出。

3.4.4 日期格式

对于单座安装, 软件和报告中的日期与时间采用在 BOND 控制器操作系统中设置的格式。对于 BOND-ADVANCE 安装, 则采用在终端上设置的格式。短日期格式和长日期格式使用的最大字符长度应分别为 12 和 28 个字符。

3.5 BOND 看板

BOND-ADVANCE 安装中的看板显示在与控制器或终端机连接的显示器上。它提供系统中所有操作仪的实时状态概要。

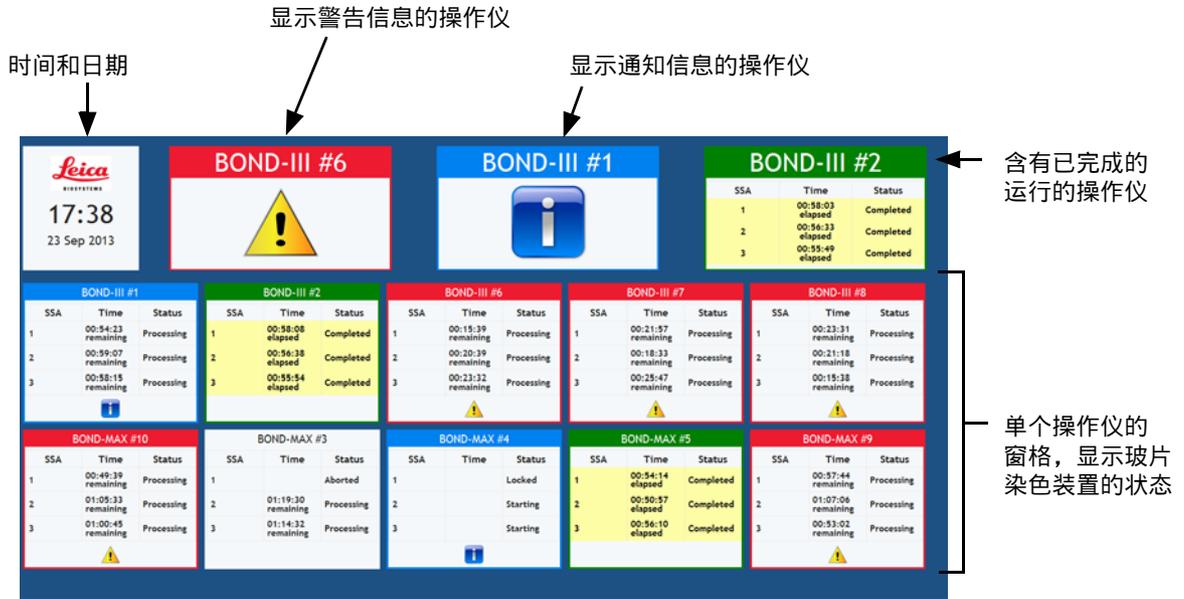


图 37: BOND 看板

在屏幕顶端、时间和日期窗格的右边有三个窗格，分别显示含有警告（左）、通知（中）和已完成的运行（右）的操作仪。如果某一分类中的操作仪不止一台，窗格将按顺序循环显示这些操作仪。

第一行下方的窗格显示系统中的各台操作仪，并按操作仪名称的字母顺序排列（在管理客户端中设置）。这些窗格显示操作仪中三个玻片染色装置的状态，以及用于整个操作仪的总体状态指示符：

- 带有警告信息的操作仪显示有警告图标 ，颜色为红色。
- 带有通知信息的操作仪显示有通知图标 ，颜色为蓝色。
- 含有已完成的运行的操作仪显示为绿色，其相应的玻片染色装置将显示“已完成”状态。
- 断开连接的操作仪将显示连接断开图标 。

含有警告、通知或已完成的运行的操作仪将显示在屏幕顶部的相应位置上，同时也显示在下方以字母顺序排列的单个窗格中。

玻片染色装置状态

每个玻片染色装置的状态都显示在操作仪窗格中。有三种状态类别：

- **已锁定** – 在玻片架被锁定后显示。不显示时间。
- **处理中** – 玻片架上的染色处理已开始。**时间**列将显示剩余运行时间，单位为小时、分和秒。
- **已完成** – 染色处理已完成。**时间**列将显示运行已结束了多长时间，单位为小时、分和秒。

如果没有已锁定的玻片架，此行则为空白。

在看板上不能进行互动操作。如果看板显示一条信息称某台操作仪需要引起注意，则用户需要通过 BOND 终端进行操作。

3.6 通知、警告和警报

BOND 系统有三个警示级别：通知、警告和警报。每个警示都用一个图标表示，该图标显示在**系统状态**屏幕上，位于警示信息所涉项目的上方或旁边。无论当前是哪个可见屏幕，对应的警示图标还可能显示在操作仪页签上以提供标示（参阅 [5.1.1 操作仪页签](#)）。在 BOND-ADVANCE 中，警示也显示在看板中（参阅 [3.5 BOND 看板](#)）。

右键单击警示图标并选择**注意信息**即可打开一个对话框，其中详细列明了警示状况。

三个警示级别及其相关图标说明如下。



通知

不闪烁

提供关于某种状况的信息，这种状况需要立即或以后采取措施以便启动运行或避免以后染色处理被延误。



警告

不闪烁

需要立即采取措施，可能是为了避免染色处理被延迟。延迟处理会影响染色质量。



警报

闪烁

需要采取紧急措施。如果仪器正在处理玻片，此时已暂停且无法恢复操作，除非您纠正警报状态。延迟处理会影响染色质量。



切记在看到此图标时（特别是染色运行正在进行时）立即阅读警告和警报信息。快速反应可以避免玻片染色受到不利影响。

建议您对运行期间出现的通知也要尽快予以解决。

3.7 报告

BOND 软件能生成多种报告，这些报告可在新窗口中用“BOND 报告查看器”打开。报告中的一般信息（如时间、地点、仪器等）显示在报告标题中，报告的页脚则显示报告生成的时间、日期以及页数。

-  有些报告，特别是含有病例、玻片或试剂信息的报告，可能需花费数分钟时间生成，尤其是在有多台操作仪和/或高处理量的实验室。

BOND 报告查看器有一组导航、查看和输出选项。除了打开一个标准的打印对话框以选择和设置打印机或选择需打印的页面外，您还可以用多种格式导出报告，包括 PDF、XLS、CSV 和文本文件格式。

可以使用多个键盘快捷键进行导航，如 **Page Up**、**Page Down**、**Home**（首页）和 **End**（尾页）。其他功能也可通过键盘快捷键实现，例如 **Ctrl-F** 显示搜索对话框，**Ctrl-S** 打开保存对话框，**Ctrl-P** 打开打印对话框。

BOND 报告在以下章节中述及：

- [5.3.1 维护报告](#)
- [6.7 玻片设置概要报告](#)
- [7.5 程序报告](#)
- [8.3.4 清单详细信息报告](#)
- [8.3.5 试剂使用报告](#)
- [9.4 运行事件报告](#)
- [9.5 运行详细信息报告](#)
- [9.6 病例报告](#)
- [9.8 玻片概要](#)
- [9.10 玻片历史摘要](#)

还可以用 CSV（逗号分隔值）文件格式导出玻片信息。参阅 [9.9 导出数据](#)。

遗留数据报告

如果您的 BOND 系统是从 4.0 版软件升级的，则升级前的病例和玻片数据将不会被转移到当前数据库中，但旧有的数据（术语为“遗留”数据）仍可使用。若要访问这些数据，点击**开始 > 所有程序 > Leica > BOND Legacy Report Viewer**，即可打开 4.0 BOND 版本的软件。在**玻片历史**屏幕中查看已处理玻片，并按照您以前使用 4.0 版本时同样的方法创建报告。如同使用 4.0 版本一样，您可以在报告窗口中打印报告，或者用 PDF 格式保存报告。其步骤为：选择**文件 > 打印**并选择 **Leica PDF Printer** 作为打印机。

-  不要在 BOND Legacy Report Viewer 中创建病例或玻片。仅可用它查看遗留数据和创建报告。

3.8 帮助

临床客户端和管理客户端的功能栏中的**帮助**图标可打开本用户手册。



3.9 关于 BOND

点击屏幕左上角的 Leica Biosystems 标志可查看**关于 BOND**对话框，其中罗列了系统信息。

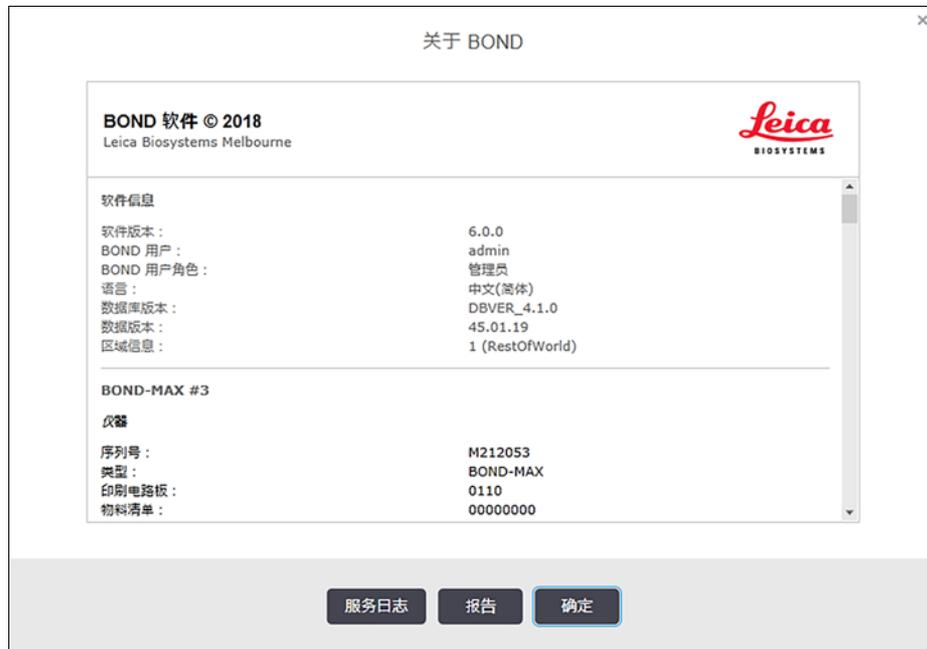


图 38: 关于 BOND 对话框

关于 BOND对话框中的多数信息主要是维修人员所需要的，但实验室人员也可能发现有用的原始信息组，特别是在同客户支持部门探讨问题时。

原始信息组中含有的信息如下：

- 软件版本：软件发布版本号。
- BOND 用户：当前用户的用户名。
- BOND 用户角色：当前用户的用户角色。
- 语言：当前使用的语言
- 数据库版本：数据库的版本（参阅数据库结构）。
- 数据版本：加载到数据库中的数据版本。
- 区域信息：为系统设置的世界区域（在安装期间设置）。

您可以将对话框中的信息保存为文本文件 – 点击**报告**，然后选择文件的保存位置。

服务日志

您可以在管理客户端的**关于 BOND** 对话框中生成服务日志报告。通常是应服务代表的要求而生成该报告。创建服务日志的步骤如下：

1. 点击**关于 BOND** 对话框中的**服务日志**。
2. 选择具体的操作仪，选择 ***System*** 报告 BOND 系统中的软件或控制器事件，或选择 ***LIS*** 报告与实验室信息系统 (LIS) 系统有关的事件。
3. 选择报告的时间跨度，或点击**过去七天**。
4. 点击**生成生成报告**。
5. 报告将显示在报告查看器中 – 参阅 [3.7 报告](#)。

3.10 BOND 数据定义

控制器包含一个数据库，其中存贮了整个 BOND 系统中所有试剂和程序的详细信息，还包括 Leica Biosystems 试剂和试剂系统的默认程序和详细信息。

3.10.1 数据定义更新

Leica Biosystems 定期在网站上发布数据定义更新，例如：添加新上市的试剂。参阅 [10.4 BDD](#) 中对更新数据定义的说明。

 更新数据定义时，您必须仅使用带有 **.bdd** 文件扩展名的更新文件。

在**关于 BOND** 对话框中查看您的当前数据版本。若要查看此对话框，点击 BOND 软件屏幕右上角的 Leica Biosystems 标志。另请参阅 [3.9 关于 BOND](#)。

3.11 软件更新

随着 BOND 系统的持续开发，Leica Biosystems 可能发布软件更新，更新可能涉及软件主体，或者涉及包括默认程序、试剂和试剂系统的数据库。

当前软件版本的版本号可在**关于 BOND** 对话框中找到（参阅 [3.9 关于 BOND](#) 中的**关于 BOND**）。数据版本也显示在**关于 BOND** 对话框中。

4

快速入门

本章旨在为您首次自行操作 BOND 系统提供示范性指导说明。我们将在其中创建一个示范病例，然后设置并处理四张玻片，用 BOND 即用型一抗 *CD5、*CD3、*CD10 和 *Bcl-6 进行检测。我们将对这些抗体使用默认的程序和检测系统：*IHC Protocol F 和 BOND Polymer Refine。这里所描述的操作步骤也适用于 ISH 探针和程序（只需将抗体更换为探针，并用原位杂交（ISH）程序取代 IHC 程序）。

4.1 BOND-III 和 BOND-MAX

在开始前，您应该熟悉本手册中的相关章节 [2 硬件](#) 和 [3 软件概述](#)（在 BOND 控制器上）。

- [4.1.1 操作前检查和启动](#)
- [4.1.2 程序和试剂检查](#)
- [4.1.3 设置玻片](#)
- [4.1.4 装载试剂](#)
- [4.1.5 运行程序](#)
- [4.1.6 结束](#)

4.1.1 操作前检查和启动

开始运行前先执行以下步骤：

1. 确定操作仪清洁无垢，并且所有的维护任务都已更新（参阅 [12.1 清洁和维护时间表](#)）。

每日运行前任务包括：

- (i) 检查确认大容量废液容器未超过半满；对于当前型号的 BOND-MAX，可利用容器标签上的白色横线作为半满液位的指示线 – 参阅 [图 125](#)。
 - (ii) 检查确认大容量试剂容器装量至少为半满，且装有正确的试剂。
2. 检查洗涤区和混合站 – 必要时进行清洁或更换。
 3. 检查玻片标签仪，确保其中有足够的标签。
 4. 如果操作仪和控制器（以及 BOND-ADVANCE 终端）未开启，则将其开启。

5. 当控制器或终端运行后，启动临床客户端程序。
6. 软件启动后，检查**状态**屏幕，确认没有操作仪通知。如有，在尝试运行玻片之前进行纠正。
7. 接通玻片标签仪电源。

4.1.2 程序和试剂检查

检查确认将在运行中使用的程序和试剂是否已在软件中设置完毕。

检查程序：

1. 选择功能栏中的**程序设置**图标（显示在右方）。
2. 检查确认“*IHC Protocol F”已列在表中。



i 如果该程序未列在表中，在屏幕底部的**首选状态**筛选器中选中**全部**（参阅 [7.2 程序设置屏幕](#)）。

3. 在表中选择该程序，点击**打开**，在**编辑程序属性**对话框中标记首选检测系统，即 **BOND Polymer Refine Detection**。

确保在对话框的顶部附近选择该程序为**首选**（如果不是，您需要以主管用户角色登录，将该程序设置为首选）。

检查试剂：

进行试剂检查的前提是您贮存有所需的抗体和检测系统，并已将它们登记到 BOND 试剂清单中。参阅 [8.3.3 登记试剂和试剂系统](#)中的详细内容。

1. 选择功能栏中的**试剂设置**图标（显示在右方）。
2. 在**设置**页签上，选择**一抗**作为**试剂类型**；选择 **Leica Microsystems** 作为**供应商**；屏幕底部筛选器中的**首选状态**选**全部**。
3. 找出需要的各个抗体（*CD5、*CD3、*CD10 和 *Bcl-6），双击打开**编辑试剂属性**对话框：
 - (i) 点击**恢复出厂默认程序**（您需要以主管用户角色登录才能恢复出厂默认设置）。这可以确保默认染色程序、*IHC Protocol F 和默认预处理程序的设置。
 - (ii) 确保试剂被勾选为**首选**（如果不是，您需要以主管用户角色登录，将该试剂设置为首选）。
 - (iii) 点击**保存**。
4. 现在转到**清单**页签，选择**试剂容器**作为**试剂包类型**；选择**一抗**作为**试剂类型**；选择**库存**作为**清单状态**；选择 **Leica Microsystems** 作为**供应商**；屏幕底部筛选器中的**首选状态**选择**首选**。



所需的所有抗体及其可用容量都应显示出来。

确保各抗体的容量足够使用。

5. 在同一页签上，选择 **BOND 检测系统**作为**试剂包类型**，选择**库存**作为**清单状态**。检查确认首选检测系统 **BOND Polymer Refine Detection** 已列在表中，并且试剂量足够使用（参阅 [8.3.1 测定试剂量中的报告检测系统容量](#)）。

4.1.3 设置玻片

本节将详述如何告知 BOND 其所需的玻片染色详细信息以及将玻片放置到操作仪中的方法。

本节中的软件操作在**玻片设置**屏幕上进行。要显示此屏幕，点击功能栏中的**玻片设置**图标。

参阅以下小节：

- 输入病例详细信息
- 输入玻片详细信息
- 对照
- 粘贴玻片标签
- 装载玻片



输入病例详细信息

首先，我们必须在软件中为示例患者创建一个“病例”。示范病例中的患者姓名为 A Edward，病例 ID 为 3688，送检医生为 Smith 医生。

1. 点击**玻片设置**屏幕中的**添加病例**，软件即显示**添加病例**对话框。

添加病例对话框包含以下字段：

- 病例 ID：3688
- 患者姓名：Edward, A
- 病例注释：
- 医生：Smith (下拉菜单)
- 管理医生 (链接)
- 病例号：
- 分配容量：100 μ L (未选中) / 150 μ L (已选中)
- 制备程序：*Dewax (下拉菜单)

底部有确定和取消按钮。

图 39: 添加病例对话框

2. 光标置入**病例 ID** 栏，键入“3688”。
3. 光标置入**患者姓名**栏，键入“Edward, A”。
4. 点击**管理医生**打开**管理医生**对话框，在其中点击**添加**打开**添加医生**对话框，在**姓名**字段内键入“Smith”。确保**首选**选项框已勾选，然后点击**保存**。
5. 在**管理医生**对话框中选择“Smith”，然后点击**确定**。
6. 选择 150 μ L 作为病例的默认分配容量。如果需要，这一设置可在玻片设置过程中进行重写。

7. 在**制备程序**字段中选择“*Dewax”或“*Bake and Dewax”，作为该病例中玻片的默认制备。如果需要，此设置可在玻片设置过程中进行重写。
8. 点击**确定**关闭**添加病例**对话框 – **玻片设置**屏幕左侧的表格便会显示新建病例。

关于设置病例的更多详细内容，请参阅 [6.3 使用病例](#)。

输入玻片详细信息

下一步我们要为四张实物玻片创建其在软件中的“玻片”。

1. 在屏幕左侧的病例列表中选择新建的病例 ID 3688。
2. 点击**添加玻片**打开**添加玻片**对话框。

图 40: 添加玻片对话框

3. 可以选择添加关于此玻片的特别注释。
4. 确保已选中**检测组织**为组织类型。
5. 选择适用于操作仪和/或组织大小的分配容量（参阅 [6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置](#)）。我们假定要在台 BOND-III 中处理玻片，因此将分配容量设定为 150 μL。
6. 在**染色方法**中选择**单染**和**常规**。
7. 点击 **IHC** 指定免疫组化（IHC）处理。

8. 在**标记**列表中选择 “*CD5 (4C7)”。

在**程序**页签中，软件将自动输入为该病例设置的制备程序，以及默认 *CD5 染色和修复程序。

9. 点击**添加玻片**。

玻片被添加到玻片被添加到**玻片设置**屏幕左侧的玻片列表中。**添加玻片**对话框保持打开。

10. 重复步骤 8–9 三次，并在步骤 8 中选择 *CD3 (LN10)、*CD10 (56C6) 和 *Bcl-6 (LN22) 作为标记。

11. 所有玻片都添加完毕后，点击**关闭**以关闭**添加玻片**对话框。

12. 核实玻片列表中的详细内容。

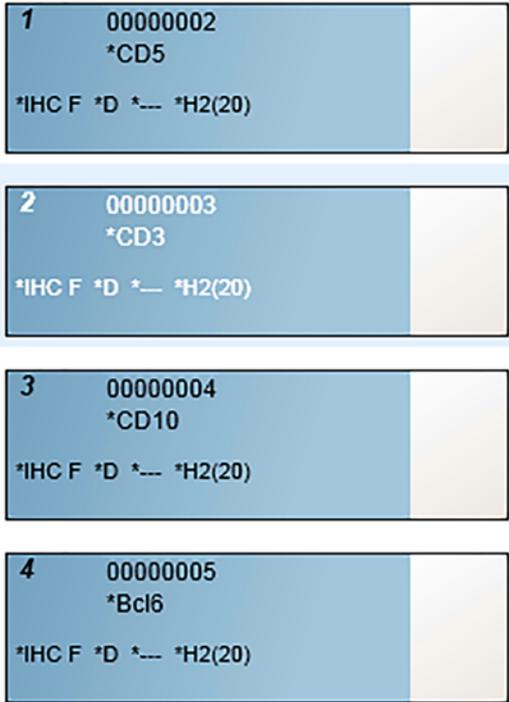


图 41：在**玻片设置**屏幕中设置的四张玻片

如果您需要更改某张玻片的详细信息，双击该玻片打开**玻片属性**对话框，视需要更改详细信息，然后点击**确定**。

有关设置玻片的更多内容可参阅 [6.5 使用玻片](#)。

i 您可以用**模板**快速添加多个常用玻片。有关模板的说明和创建及使用方法，请参阅 [8.4 试剂模板屏幕](#)。

对照

i 必须在 BOND 系统中使用对照。我们强烈建议将合适的对照组织放置在与患者组织相同的玻片上。此外，可以专为对照玻片创建一个单独的病例。参阅 [6.2 使用对照](#)中的详细内容。

粘贴玻片标签

现在您可以打印玻片标签并将它们粘贴到玻片上：

1. 在玻片设置屏幕上点击打印标签。
2. 点击**所有未打印玻片标签**，然后点击打印。
标签即被打印。
3. 确保玻片的磨砂区域（标签将粘贴在此处）干燥，然后贴上标签，并使玻片 ID 或条形码与玻片末端平行对齐。当手持玻片使标签处于玻片顶端时，标签应呈正置。



图 42：正确粘贴的标签

更多信息请参阅 [6.6 玻片标签](#)。

装载玻片

按如下步骤装载玻片：

1. 拿住玻片贴有标签的一端，使标本位于最上端。
2. 将玻片对准玻片架上某个空位，玻片有标签的一端置于玻片架侧面的凹缘上方（参阅图 43），放下玻片，使之嵌入玻片架中的凹槽内。

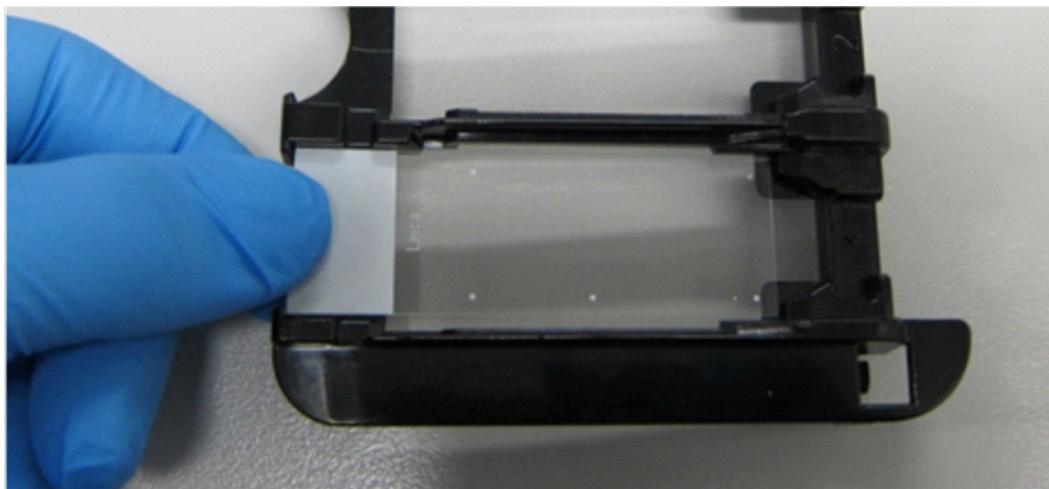


图 43：将玻片放置在玻片架中

- 握住 Covertile 的顶部将其放在玻片上，使 Covertile 颈部的卡栓固定在玻片架上的凹槽中（图 44 中画圈处）。对于新设计的 Covertile，其上所印的“Leica”字样应能被正确识读，表明 Covertile 放置正确。

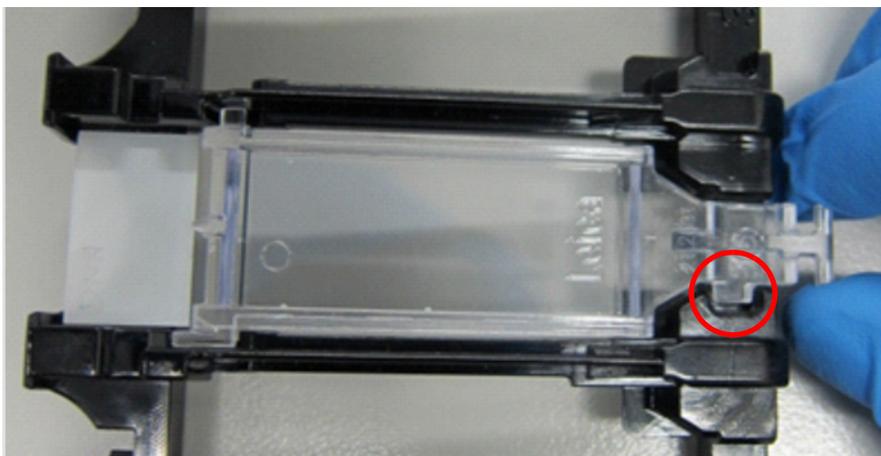


图 44：将 Covertile 放在玻片上

- 待所有的玻片和 Covertile 都放入玻片架后，拿起玻片架，将其末端放在一个空置的玻片染色装置的入口处，然后将玻片架完全滑入染色装置中。玻片架应能很轻易地滑入，并在其就位后能听到卡哒声。

4.1.4 装载试剂

现在，必须将检测系统（BOND Polymer Refine）和标记容器（用于*CD5、*CD3、*CD10 和 *Bcl-6）放入操作仪。



试剂容器在搬运过程中会倾斜从而导致在容器盖周围留下残余试剂。在打开试剂容器时必须穿戴合格的防护眼镜、手套和防护服。

向 BOND 操作仪中装载试剂的步骤如下：

- 把一抗容器放入试剂架，使其上的沟槽对准试剂架隔间的导槽，向下按压直至一抗容器咔的一声固定在位。

如需要，也可将一抗容器放入检测系统试剂架的空余隔间中。

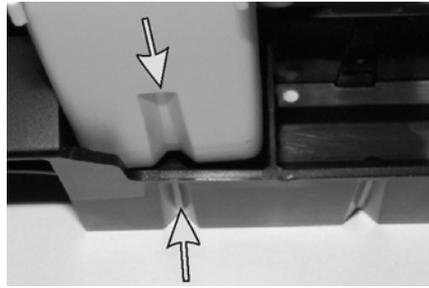


图 45: 试剂架中的试剂容器
(箭头所指为试剂容器和试剂架上的凹槽)

2. 打开所有的一抗容器和检测系统容器。拉开容器盖向后翻，直至其嵌入容器背部的扣环中。
3. 确保条形码标签已完全粘贴在容器上 – 压平翘起的标签。
4. 将试剂架放在操作仪的试剂平台上，利用试剂平台上的导轨将试剂架正确地放入试剂平台。
试剂架到达试剂平台末端时应啮合在联锁装置上。试剂架指示灯变为绿色，表示试剂架已到位。

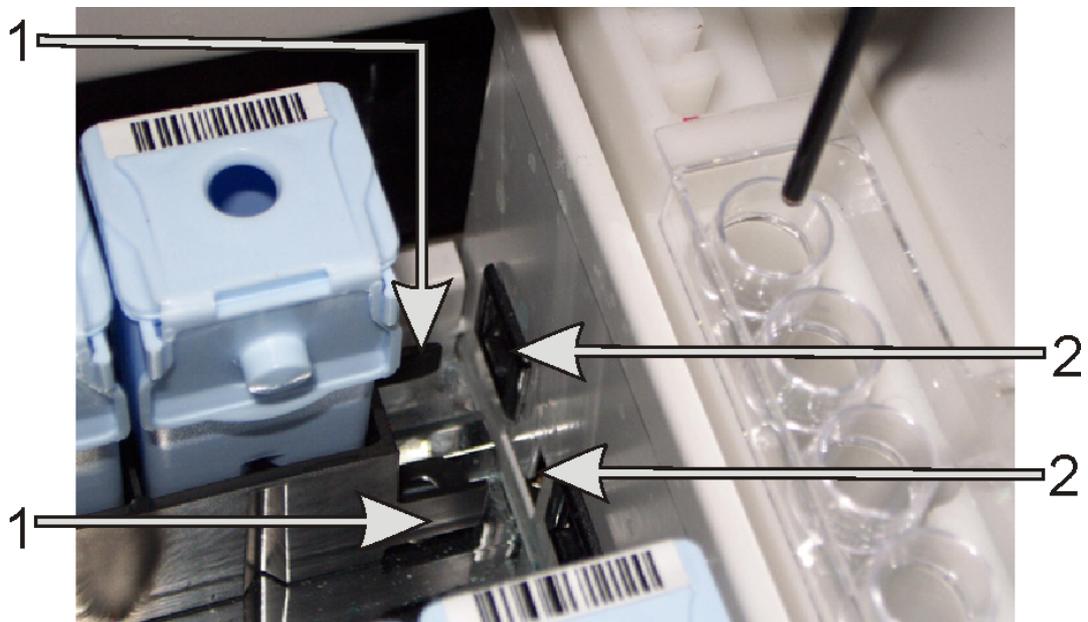


图 46: 插入试剂架
(试剂架的锁定机制 (1) 与操作仪的锁定端口 (2) 啮合)

5. 在软件中点击“操作仪”页签，显示**系统状态**屏幕。

试剂列以较浅的颜色和深色边框显示，表示试剂架即将被扫图。当主自控装置准备就绪时，BOND 系统就立即开始扫描试剂上的 ID 图像，然后更新试剂图标。

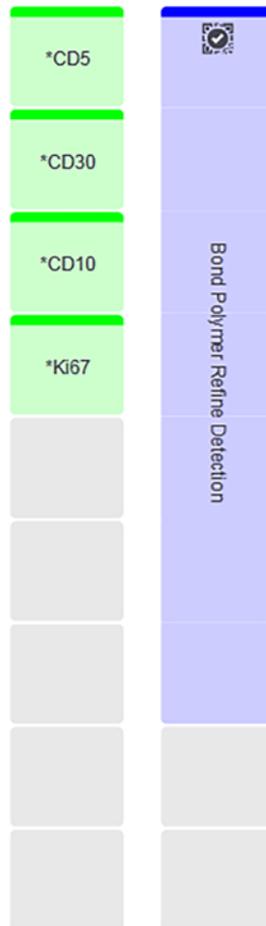


图 47：系统状态屏幕上显示的试剂架状态

如果试剂有问题，软件就会在该屏幕上显示一个注意图标。右键单击该图标可以查看详细信息（参阅 5.1.3 试剂状态中的**解决试剂问题**）。

- i** 注意：当试剂架指示灯为绿色时，可以随时取出试剂架。而当试剂架中的某个试剂在 2 分钟之内即将被使用时，指示灯变为红色，表示试剂架已锁定（参阅 2.2.6 前部防护罩中的**试剂平台**）。

4.1.5 运行程序

当玻片和试剂都设置完毕并已放入操作仪后，您就可以开始进行染色处理了。

1. 确保操作仪盖已关闭。
2. 按下前部防护罩上已装载玻片架下方的“装载/卸载”按钮。

BOND 锁定玻片架，此时玻片架指示灯应亮起橙色。

 注意听玻片架锁定时的声音，如果有较大的喀嚓声或卡嗒声，很可能出现了 Covertile 位置偏离情况。此时应解锁并取出玻片架，检查玻片和 Covertile。

3. 当主自控装置就绪后，BOND 系统即对玻片进行扫图。

如果所需的某种试剂不可用，软件就在玻片列表下方显示一个注意图标。右键单击该图标查看详细信息。

4. 只要没有未识别的或不兼容的玻片，这些玻片此时就可以开始进行染色处理了。进度条将处于启动阶段（参阅 5.1.6 运行进度指示器中的 **运行进度**），运行状态为 **玻片就绪**（参阅 5.1.6 运行进度指示器中的 **运行状态**）。

点击  开始运行程序（或者将仪器设置为稍后启动；参阅 5.1.8 延迟启动）。

系统将安排运行进程，随后进度条转至处理阶段，而运行状态为 **处理中（正常）**。

 每次应仅启动一个运行，稍等 1-2 分钟后再启动下一个运行。每启动一个运行后等待片刻以确认启动成功。如果不成功，运行状态将显示为 **已拒绝/玻片就绪**。参阅 **运行状态**。

当一批运行正在进行染色处理时，其玻片染色装置的“装载/卸载”按钮不会释放玻片架。

在 **系统状态** 屏幕上点击该玻片架下方的  即可放弃运行（参阅 5.1.7 启动或停止运行）。

4.1.6 结束

当染色运行结束时，操作仪页签图标将闪烁（参阅 [5.1.1 操作仪页签](#)）。如果在运行期间有意外事件发生，显示文本将为红色，而玻片架下方和受影响的玻片上将出现通知标志。此时应检查**系统状态**屏幕上是否有注意图标，右键单击这些图标可显示关于注意状态的信息。另外还应检查运行事件报告（参阅 [9.4 运行事件报告](#)）以查看其他有关运行期间出现的问题的信息。

运行结束时：

1. 取出试剂架。

将试剂容器盖盖严以防止试剂挥发，并立即按照试剂标签或数据表中的说明贮存试剂。

2. 按下“装载/卸载”按钮，将玻片架从操作仪中取出。



同样，卸载玻片架时要注意听是否有喀嚓声或咔嚓声。如果听到这种声音，请检查玻片染色装置内部及周围是否有在意外事件中放置不恰当的玻片被压碎而产生的碎玻片，若有，请联系客户支持部门。

3. 将玻片架放在一个平坦、稳定的平面上。取下 Covertile，方法是按住玻片标签，然后小心地向下按压 Covertile 的颈部，使 Covertile 的末端从玻片上抬起。



不要在玻片表面上滑动 Covertile，因为这可能会损坏组织，使读片困难。

4. 将 Covertile 从玻片上拿起，按 [12.3 Covertile](#) 中的说明进行清洁。
5. 取出玻片，按照您的实验室处理步骤继续进行下一步操作。

您可以选择对任何玻片进行重新处理（参阅 [9.3 玻片属性和玻片重新运行](#)）。

至此，您在 BOND 系统上的首次运行便完成了。

5

状态屏幕（在 BOND 控制器上）

在临床客户端程序中，每台操作仪都有两个状态屏幕和一个维护屏幕。在左侧的页签中选择操作仪后，即可在窗口右上方的页签中选择状态屏幕。**系统状态屏幕**通过显示操作仪中的玻片和试剂位置的视图而提供系统控制；**程序状态屏幕**则显示单个玻片的程序进度信息。**维护屏幕**则包含用于一系列维护操作的命令。

- [5.1 系统状态屏幕](#)
- [5.2 程序状态屏幕](#)
- [5.3 维护屏幕](#)

5.1 系统状态屏幕

该屏幕使您能够控制操作，它可以显示装入的玻片架和试剂的详细资料，以及系统中试剂、废液和安全开关的状态。

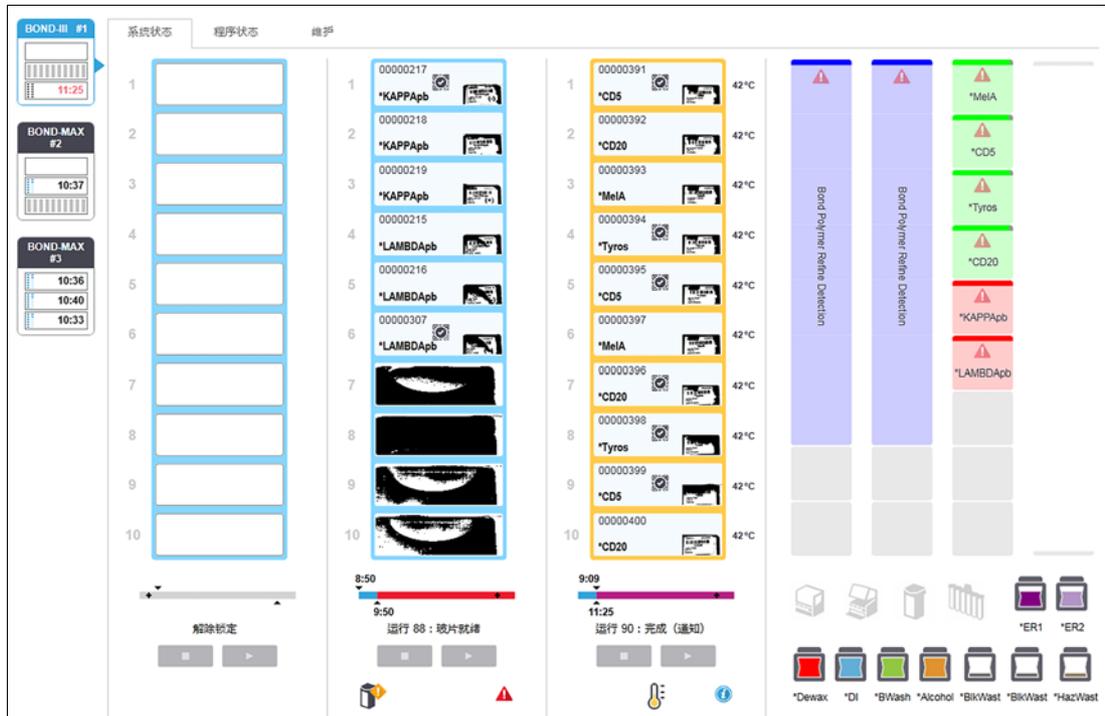


图 48: BOND-III 仪器的系统状态屏幕

状态屏幕左侧的操作仪页签显示了相关操作仪状态的直观概况。单击页签可查看该操作仪状态的详情。

更多信息请参阅：

- [5.1.1 操作仪页签](#)
- [5.1.2 硬件状态](#)
- [5.1.3 试剂状态](#)
- [5.1.4 玻片信息](#)
- [5.1.5 在机玻片识别](#)
- [5.1.6 运行进度指示器](#)
- [5.1.7 启动或停止运行](#)
- [5.1.8 延迟启动](#)

5.1.1 操作仪页签



软件在屏幕左侧针对系统中的每台操作仪（单座安装）或与客户端连接的仪器组中的每台操作仪（BOND-ADVANCE）显示一个页签。如果屏幕的垂直空间不足以显示所有操作仪，可使用显示的箭头按钮上下滚动进行查看（右图显示的是向上箭头）。



页签显示操作仪名称，而矩形图标显示操作仪的玻片染色装置的状态（见下文）。若要显示某台操作仪的**系统状态**屏幕，点击页签即可。当操作仪被选中时，其页签周围会出现蓝色边框和右向箭头（见上文）。


玻片染色装置状态

下面是操作仪页签可以显示的玻片染色装置状态的示例。

开始运行之前：



空白矩形：玻片架未放入或未锁定。




动态的 ID 号和实心条：玻片架正在被扫图。




有玻片的玻片架图标：玻片标签已被扫图，玻片架已做好运行准备。

运行期间：




以黑字显示的时间，左侧有移动的圆点：玻片架正在运行，未报告意外事件。显示的时间是估计的玻片架运行完成时间。



以红字显示的时间，左侧有移动的圆点：玻片架正在运行，有意外事件报告。显示的时间是估计的玻片架运行完成时间。

运行之后:



以黑色闪烁显示的时间，左侧有静止的圆点：运行在报告的时间点结束，没有意外事件。



以红色闪烁显示的时间，左侧有静止的圆点：运行在报告的时间点结束 – 有意外事件发生。



运行已放弃。

操作仪状态

软件连续监控系统状态，并可能在操作仪页签上显示以下图标：

图标	含义	图标	含义
	操作仪未连接。		警告： BOND 检测到意外情况。
	(闪烁) 操作仪正在初始化。		警报 (闪烁)： 操作仪需要用户干预才能继续操作。
	操作仪当前正在维修。		操作仪正在进行维护操作。

5.1.2 硬件状态

如果 BOND 系统的某个部件有问题，屏幕右下角的图标会出现一个警告符号  或警报符号 ；而如果有一般性的系统通知（例如维护任务提示信息），则显示信息符号 。



系统的一般故障，或维护任务提醒。



仪器盖打开时，或者在染色运行中（仅 BOND-MAX）大容器槽门打开时出现。这些门必须关闭，操作仪才能工作。

如果染色运行未在进程中，则将出现信息符号 。



试剂缺失或量不足。



操作仪已开始进行初始化，尚未尝试扫描混合站。



初始化期间未检测到混合站。混合站可能不存在，或可能存在但条形码未被识别。必要时将清洁的混合站放入仪器，右键单击图标并按照提示通知系统混合站已在位。



初始化时混合站不清洁（例如上次关闭操作仪时混合站不清洁）。确保清洁的混合站已在位，然后右键单击图标并确认。



混合站清洗失败。

您仍有可能能够使用剩余的清洁混合瓶继续操作，否则您需要重启操作仪以便清除通知。如果通知仍存在，可能表示液流系统有问题，请联系客户支持部门。



没有可用的清洁混合瓶。

等待操作仪清洗几个混合瓶，然后照常继续。

若混合瓶未被清洗，您可能需重启操作仪。如果通知仍存在，可能表示液流系统有问题，请联系客户支持部门。

 必要时可以手动清洁混合站。参阅 [12.7 洗涤区和混合站](#)。

加热器错误

BOND-III 和 BOND-MAX 的每个玻片加热器都是单独监控的，并且在出现温度错误时会被标记为出错 (参阅图 49)。如果加热器被标为出错，请联系客户支持部门。



图 49: 单个加热器错误

不要尝试在被标为出错的位置上运行需要加热的玻片。如果运行期间某个加热器功能不正常，该位置上的玻片会受影响。若加热器故障危及安全，操作仪中所有的玻片加热器都会被关闭 (参阅图 50)。

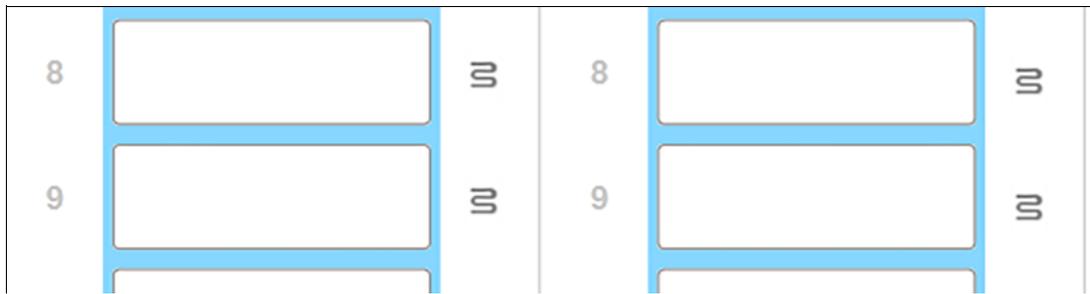


图 50: 每个位置的灰色加热器符号表示加热被完全关闭。

一旦玻片加热器被关闭，您必须关闭然后重启操作仪以便解除加热器的锁定。只要被处理的玻片不需要加热，您就可以继续使用出错加热器所在的玻片位置。

温度指示

当玻片染色装置高于室温时，**系统状态**屏幕底部会显示温度指示器。

屏幕底部的温度指示器会显示玻片染色装置为温热或高热。



图 51：温度指示器 — 温热（左）和高热（右）

系统状态屏幕上的玻片架的边框也将改变颜色以指示温度：室温时玻片架为蓝色，温热时为橙色，而高热时为红色。

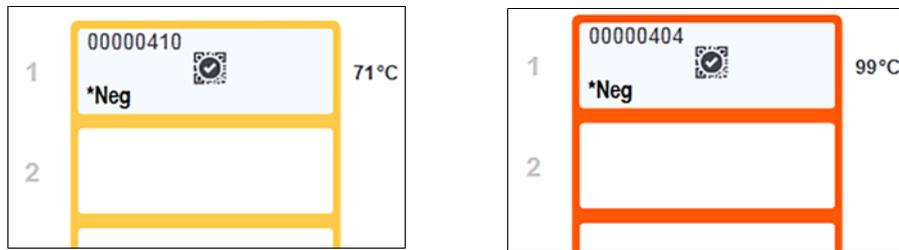


图 52：玻片架的温度指示边框：温热（左）和高热（右）

警告




避免接触玻片染色装置及其周围区域。这些部位可能非常热，会导致严重烫伤。操作停止后应等待二十分钟时间让玻片染色装置及其周围区域冷却。

5.1.3 试剂状态

系统状态屏幕右侧显示所检测的试剂状态。以下章节将介绍使用的图标以及如何解决屏幕上显示的一些试剂问题。


- 试剂系统
- 试剂容器
- 试剂液位
- 解决试剂问题
- 修复未检测到的试剂
- 大容器状态

试剂系统

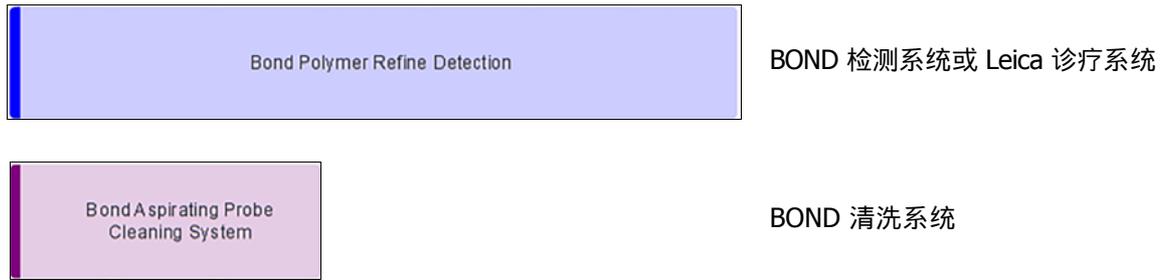

试剂容器

i 试剂容器图标在支持 BOND 的试剂名称前带有星号 (*).




BOND 即用型一抗。

这类试剂的详细信息在您对它们进行登记时由 BOND 软件自动输入。试剂的缩略名将被显示。



BOND 即用型 ISH 探针。

这类试剂的详细信息在您对它们进行登记时由 BOND 软件自动输入。试剂的缩略名将被显示。



装在 BOND 开放容器或滴定容器中的用户自备一抗。

这类试剂的详细信息必须在登记之前在**试剂设置**屏幕中手动输入，登记时要求输入批号和有效期。试剂的缩略名将被显示。




装在 BOND 开放容器或滴定容器中的用户自备 ISH 探针。

这类试剂的详细信息必须在登记之前在**试剂设置**屏幕中手动输入，登记时要求输入批号和有效期。试剂的缩略名将被显示。




BOND 即用型辅助试剂。

这类试剂的详细信息在您对它们进行登记时由 BOND 软件自动输入。试剂的缩略名将被显示。



装入 BOND 开放容器或滴定容器中的 BOND 酶试剂。

BOND 酶试剂必须由用户制备并装入开放容器内，但试剂设置详细信息是在 BOND 中预定义的，登记时只需输入批号和有效期。



装入 BOND 开放容器或滴定容器中的用户自备辅助试剂。

这类试剂的详细信息必须在登记之前在**试剂设置**屏幕中手动输入，登记时要求输入批号和有效期。试剂的缩略名将被显示。



软件在该位置未检测到试剂。
如果有试剂，参阅下面的**修复未检测到的试剂**中关于如何解决问题的详细说明。
如果扫图仪多次未能正确地对 ID 进行扫图，请清洁 ID 扫图仪窗口（参阅 **12.9 ID 扫图仪**）。



BOND 检测到该试剂有问题。右键单击通知标志查看更多信息。
原因可能是 BOND 没有识别出该试剂。在这种情况下，可用手持式扫描仪扫描试剂并将其添加到清单中。如果 ID 已损坏，可手动输入 ID。参阅 **8.3.3 登记试剂和试剂系统**中的更多信息。



BOND 检测到该试剂或试剂系统有问题。右键单击信息符号查看更多信息。

试剂液位

系统状态屏幕上的试剂系统图标仅指示三种液位：



满至约 20% 满



低（剩余约 20% 至接近空）



空的

即用型试剂和开放容器图标能更精确地显示试剂液位。




图 53：系统状态屏幕中显示的即用型试剂液位示例

若要查看更详细的试剂或试剂系统清单信息，右键单击图标，在弹出菜单中选择**清单 ...**，**试剂清单详细信息**屏幕即显示。参阅 **8.3.2 试剂或试剂系统详细信息**。

解决试剂问题

如果 BOND 软件在运行启动以前检测到染色所需的某个试剂有问题，软件就会在**系统状态**屏幕中玻片架下方的试剂容器图形上显示一个注意图标。如果在运行期间出现问题，注意图标将显示在试剂状态图标上，如本节前文所述。若想查看问题的更多信息，右键单击注意图标。

如果需要更换或添加试剂，那么取出含有问题试剂的试剂架，换上或添入所需试剂，然后重新装入架。

- i** 注意：如果染色处理已在进行中，而某个特定试剂架中的试剂在 2 分钟以内就需使用，您将无法取出该试剂架，除非放弃运行。这一状态由该试剂架的指示灯发出红光来指示。

修复未检测到的试剂

如果某个试剂没有检测到，进行下面的操作：

1. 检查：
 - 试剂容器处于试剂架的正确位置
 - 试剂容器盖已打开，并翻扣在容器后部
 - 横贯容器前上方的试剂条形码 ID 完好无损。
2. 检查确认试剂已登记到清单中。
 - 如果试剂没有登记，那么按照 [8.3.3 登记试剂和试剂系统](#) 所述进行登记。
3. 此时可进行下述操作：
 - (i) 取出试剂架（然后记下相关试剂的唯一包装标识符，即 UPI），再重新插入试剂架，让系统再次自动识别试剂架；或者
 - (ii) 如果重新插入试剂架不能有效解决问题，您可以手动识别试剂 – 在**系统状态**屏幕中右键单击该容器图标，在子菜单中点击**选择 ...**。输入您记下的试剂 UPI，然后点击**确定**。

一个符号  将出现在图像上，用以标识已经过手动识别的试剂。参看下面的图 54。如果试剂架被取出，该符号（以及手动识别的试剂）将被移除。



图 54：手动输入的试剂

大容器状态

系统状态屏幕的右下方显示大废液容器和大试剂容器的图标。每个容器都有标签，而且颜色与装载的容器相符。系统状态屏幕中大容器的位置对应着操作仪大容器槽中相应的实际位置。

参阅 [2.2.7 大容器槽](#) 中每种类型操作仪的实际容器设置。



图 55：大容器（BOND-III 设置）



图 56：大容器（BOND-MAX 设置）。
最右端的图标表示外部废液容器。

下表列明了上述各个大容器中的内容物。

大容器标签	大容器内容物
*Dewax	BOND Dewax Solution（脱蜡溶液）
*DI	去离子水
*BWash	BOND Wash Solution（洗涤溶液）
*Alcohol	酒精（试剂级）
*BlkWast	大容量废液
*HazWast	有害废液
*ER1	BOND Epitope Retrieval Solution 1（抗原修复溶液 1）
*ER2	BOND Epitope Retrieval Solution 2（抗原修复溶液 2）

BOND-III

软件可显示 BOND-III 大容量试剂和废液容器的液位。如果试剂量低，或者废液液位高，将根据问题的严重程度显示一个通知、警报（闪烁）或警告图标。右键点击该图标查看注意信息，并采取必要措施解决问题 – 参阅 [12.2.2 续灌或清空大容量器](#)。

注意：若出现警告符号，染色处理会暂停，直至问题得到解决。

BOND-III 使用以下图标组合来指示大容量状态：

大容量	说明
	容器已满。
	容器超过 1/2 满。
	容器不足 1/2 满。
	容器接近空或已空。
	在下述情况发生时显示： <ul style="list-style-type: none"> • 废液几乎装满，需立即清空 • 试剂量低，需立即灌装 • 容器缺失 • 容量不足以启动运行 参阅 12.2.2 续灌或清空大容量器 。
 或 	在运行因发生下述情况之一而被暂停时显示： <ul style="list-style-type: none"> • 废液已满，急需清空（警告） • 试剂量低，急需灌装（警告） • 容器缺失且操作需要此试剂（警报） 参阅 12.2.2 续灌或清空大容量器 。

 系统状态屏幕上的大容量状态与照明系统同步，如 [大容量照明系统（BOND-III）](#) 所述。

BOND-MAX

当软件检测到问题（如：试剂容器液位低，或者废液容器液位高）时，会在大容量上显示注意图标（见上表）。右键单击通知图标查看详情。

5.1.4 玻片信息

以下章节将介绍系统状态屏幕中用于表示玻片信息的图标，以及玻片弹出菜单中的选项。

- 玻片图标
- 玻片架弹出菜单
- 玻片事件通知
- 调整不兼容玻片的设置


玻片图标

系统状态屏幕用图形显示了三个玻片架，其中每张玻片都有一个图标。玻片图标显示每张玻片的状态。


您的系统可以设置为使用光学字符识别 (OCR) 方法识别字母数字玻片标签或条形码。无论是哪种，都可选择将玻片图标设置为包含采集的玻片标签图像。如果您希望更改现有设置，联系客户支持部门。

玻片图标示例说明如下。

用于 OCR 标签的玻片图标

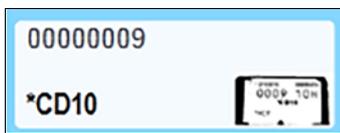


玻片已被扫图并自动识别 (参阅下面的[自动玻片识别](#))

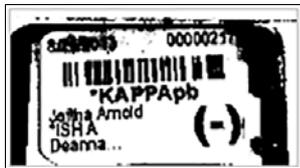

玻片已被扫图，但系统无法识别 (图标显示标签区域的图像)



玻片已被扫图并自动识别 - 注意玻片上的图标 (红圈中) (参阅下面的[在手机手动玻片识别](#))

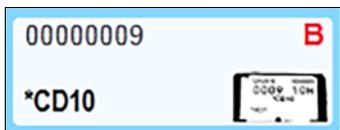

玻片和玻片架上的一个或多个其他玻片不兼容 (参阅下面的[调整不兼容玻片的设置](#))



此位置没有玻片



带事件通知的玻片处理 (参阅下面的[玻片事件通知](#))

用于条形码标签的玻片图标




此位置没有玻片，或玻片已被扫图但系统未能识别



玻片已被扫图并自动识别 (参阅下面的[自动玻片识别](#))



玻片已被扫图并自动识别 – 注意玻片上的图标 (红圈中)
(参阅下面的[在机手动玻片识别](#))

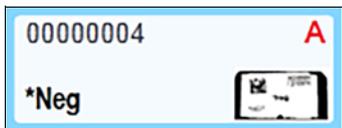

玻片和玻片架上的一个或多个其他玻片不兼容 (参阅下面的[调整不兼容玻片的设置](#))



带事件通知的玻片处理
(参阅下面的[玻片事件通知](#))

双击已被 BOND 识别的玻片，打开其对应的**玻片属性**对话框。如果运行尚未启动，您可以在对话框中编辑玻片详细信息，但随后您需要为该玻片打印新标签，卸载玻片架并粘贴新标签，再重新装载玻片架。

玻片架弹出菜单

右键单击**系统状态**屏幕上的玻片架图形中的玻片，可得到有关玻片或玻片架的一些选项。

命令	描述
手动选择...	在玻片未被自动识别时启用。 选定它可打开 玻片识别 对话框，然后您可以采用在系统中设置的玻片来识别该玻片 (参阅下面的 在机手动玻片识别)。 双击未被标识的玻片也可选中此选项。
注意信息...	若玻片显示有事件通知，应查看注意信息 (参阅下面的 玻片事件通知)。
运行事件	生成该次运行的运行事件报告 (参阅 9.4 运行事件报告)。
延迟启动	为运行设置延迟启动 (参阅 5.1.8 延迟启动)。

玻片事件通知

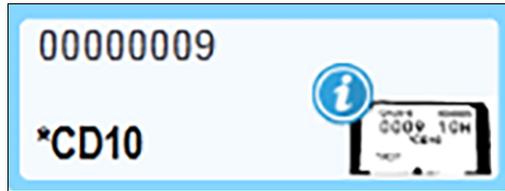


图 57: 带事件通知的玻片

当处理过程中发生意外事件时，玻片图标上会出现一个警示标志。该通知不一定表示染色不成功。在出现通知符号时，系统操作员或者实验室管理员必须采取以下额外措施来确认该玻片是否适用于诊断。

1. 右键单击玻片并选择**运行事件**以生成运行事件报告（参阅 [9.4 运行事件报告](#)）。任何引发通知的事件都用**粗体文字**显示。系统操作员或实验室管理员必须仔细考虑列出的通知事件，因为它们提供了有关玻片通知事件性质的重要而详细的资料。
2. 仔细检查已染色组织。
3. 仔细检查每个对照玻片。

如果实验室无法确认染色质量，则应将该通知告知病理医师，或者重新运行检测。

一份运行事件报告中可能有多个通知信息。如果运行完成并且其状态是**完成（通知）**，应确保检查整个报告内容。如果状态是**完成（正常）**，则无需检查报告。

调整不兼容玻片的设置

如果 BOND 系统检测到一个不兼容玻片，它将在玻片架中所有玻片的右上角标上红色粗体字母；有相同字母的玻片是兼容的。



图 58: 不兼容玻片

取出玻片架，移除不兼容玻片，或更改玻片属性（如果其中有错误）以使玻片兼容。如果您更改了玻片属性，必须为更改的玻片重新打印标签，并将新标签贴好再重新载入玻片架。

参阅 [6.9 玻片兼容性](#) 关于玻片兼容性的详细信息。

5.1.5 在机玻片识别

在最常见的工作流程中，贴有 BOND 标签或实验室信息系统 (LIS) 标签的玻片被装载到操作仪中后被自动识别。识别通过读取标签上的条形码进行，或在采用字母数字 ID 时使用光学字符识别 (OCR) 技术进行。如果某个标签因模糊或某种其他原因而无法识读，可以手动将其识别到 BOND 软件中。有的工作流程采用手动识别作为常规方法 (参阅 6.8 即时玻片和病例创建)。

自动玻片识别

BOND 系统能够自动识别用 BOND 标签仪创建的标准 BOND 条形码或者字母数字玻片标签 (如 6.6 玻片标签中所述)，以及由实验室信息系统 (LIS) 采用可识别条形码格式打印的玻片标签 (见 11.3 实验室信息系统 (LIS) 连接与初始化)。当玻片架被锁定后，系统即尝试识别每个玻片标签，并将其与已打印标签的玻片相匹配。如果标签能够与已打印标签的玻片相匹配，玻片就被自动识别而无需进一步操作。

如果系统使用 OCR (或已由 Leica Biosystems 服务代表对其默认条形码设置做出更改)，系统将在玻片识别过程中采集每个标签的图像。这些图像会出现在下列报告中，为玻片匹配提供永久性记录：

- 9.4 运行事件报告
- 9.5 运行详细信息报告
- 9.6 病例报告

如果系统无法识别标签，则玻片必须通过手动玻片识别步骤进行手动识别 (参阅下一章节)。

在机手动玻片识别

在被设置为获取每张玻片标签图像的系统 (OCR 和某些条形码系统) 中，如果自动识别不成功，可以在玻片仍装载在操作仪中时进行手动玻片识别。使用以下步骤手动识别已装载的玻片。

1. 当系统无法自动识别玻片时，软件会显示标签的图像。

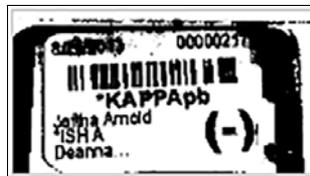


图 59：未自动识别的玻片

2. 要启动辅助 ID 对话框，可采取以下操作中的一种：
 - (i) 双击玻片图像；或
 - (ii) 右键单击图像，从弹出菜单中选择**手动选择**。

3. 玻片识别对话框即会出现。

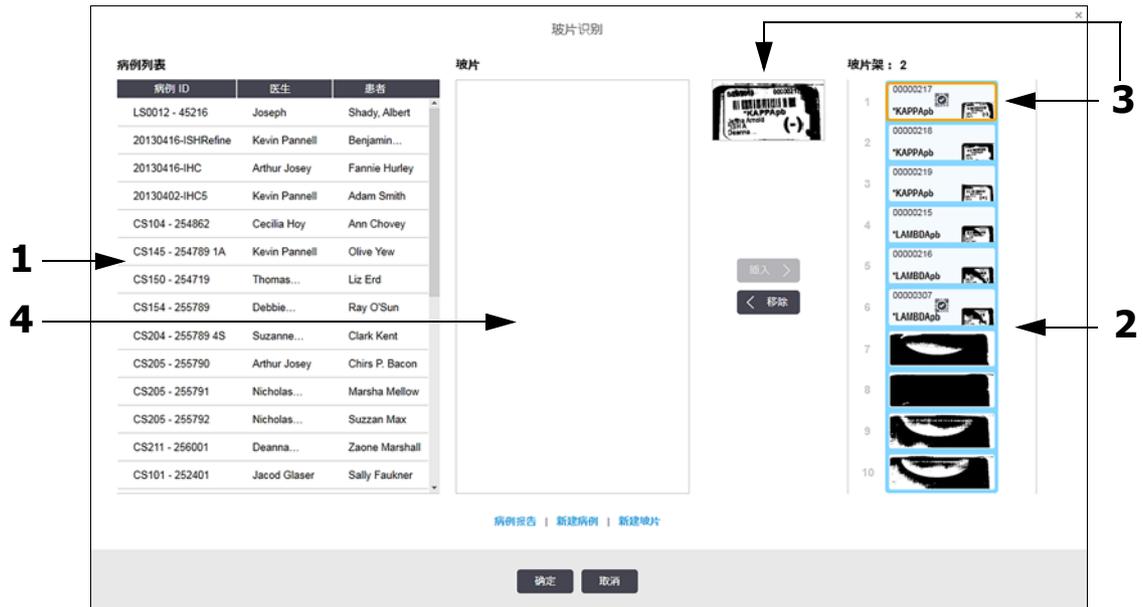


图 60: 玻片识别对话框

左边的窗格 (第 1 项) 列出了所有含未处理玻片的病例。在默认设置下, 仅显示玻片标签已打印的病例 (您可以将其更改为包括玻片标签未打印的病例 – 参阅 6.8.2 在机玻片识别选项中的**外来玻片标签**)。

当前玻片染色装置中的玻片标签显示在右侧窗格中 (第 2 项)。

对话框打开后, 选中的玻片突出显示 (第 3 项) 在右侧窗格中, 并放大显示。把光标停留在右侧窗格中的玻片上, 可以看到放大比例更高的图像。

中间的窗格 (第 4 项) 显示为左边窗格中选定的病例设置的玻片, 其中的玻片尚未和在操作仪中被扫描的玻片相匹配。同样, 默认设置仅显示已打印标签的玻片, 但它可以被更改为显示为该病例设置的所有玻片 (参阅**外来玻片标签**)。

此时如果有必要, 可以通过“**新病例**”和“**新玻片**”创建新的病例和玻片 (参阅 6.8 **即时玻片和病例创建**中的说明)。以下说明假定所有需要的玻片都已经在 BOND 中设置完毕。

4. 利用右侧选择的标签图像中的可视信息确定该玻片所属的病例。在病例窗格 (第 1 项) 中选择该病例。

玻片列表 (第 4 项) 列出为该病例设置的未匹配玻片。

5. 现在, 将未识别玻片和玻片列表 (第 4 项) 中的某个玻片相匹配。

选择该玻片, 点击**插入**。

该玻片从玻片列表中移除, 右侧窗格中的图像更新显示该玻片已被识别。一个  符号将该玻片标为已手动选择。

下一个未识别玻片标签 (如果有的话) 此时被突出显示供识别。

6. 重复上述步骤，匹配所有未识别玻片。
7. 当玻片架中的所有玻片都被识别后，点击**确定**关闭对话框。若点击**取消**，则已完成的玻片识别将丢失。
8. 此时，**系统状态**屏幕将显示玻片架中的所有玻片及其详细信息。手动识别的玻片含有标签的图像以及  符号，表示该玻片是手动选择的。



图 61：操作前手动识别的玻片

9. 手动选择的玻片可如常操作。

玻片图像会出现在下述报告中，以提供玻片匹配的永久记录：

- [9.4 运行事件报告](#)
- [9.5 运行详细信息报告](#)
- [9.6 病例报告](#)

未被设置为获取玻片标签图像的系统

这些玻片仍可以进行手动识别，但可能需取出玻片架。

将未被自动识别的玻片的玻片 ID 和玻片位置编号（刻印在玻片架上 Covertile 颈部下方的位置）记录下来。

重新放入玻片架，双击相应的玻片位置（在**系统状态**屏幕中从玻片染色装置的顶部位置向下数）。

5.1.6 运行进度指示器

进度指示器位于每个玻片架图形的下方，它们能够快速直观地显示运行的状态和进度。

- [运行状态](#)
- [运行进度](#)
- [停止运行](#)
- [设置延迟启动时间](#)

运行状态

当前运行的编号和状态显示在每个进度指示器的下方。可能的运行状态包括：

运行状态	描述
解除锁定	玻片架未锁定。
已锁定	玻片架已锁定，但还不能启动。该状态通常出现在玻片扫图完成之前。
玻片就绪	玻片染色装置中的所有玻片已被扫图。
正在启动	启动按钮已被按下，系统正在进行启动前检查和进程安排。
已拒绝/玻片就绪	BOND 尝试启动运行但没有成功。最有可能的拒绝原因是缺少试剂、大容量试剂液位低或废液容器已满。可生成一份运行事件报告，解决其中指出的问题，然后重启运行。
已安排	运行已安排但尚未开始处理。运行进度指示器显示出计划的启动时间。
处理（正常）	运行正在进行中，没有意外事件发生。
处理（通知）	运行正在进行中，发生了意外事件。查看运行事件报告中的详细信息。
放弃	正在放弃运行。当操作人员按下停止按钮时会出现这种情况。
完成（确定）	处理已完成，没有发生意外事件。
完成（通知）	处理已完成，发生了意外事件。查看运行事件报告中的详细信息。

运行进度

每个玻片架图形下方的进度条可直观地显示运行的进度。进度条显示临界时间，表明相对于临界时间的当前进度，并用以下几种颜色来表示运行进度的四个阶段：

- 蓝色 – 玻片架已锁定，处理尚未启动
- 红色 – 处理尚未启动，且启动时限已超过
- 绿色 – 正在处理
- 紫色 – 运行已完成，正在进行水化。

可以将鼠标指针暂停在运行进度部分以显示运行状态，如“锁定后已历时”、“至完成需时”和“完成后已历时”，见图 62 所示。



图 62：运行状态显示

玻片就绪 – 正在启动

玻片已被扫图、运行准备启动后与按下启动按钮或延迟启动开始后的这一小段时间内，进度条将显示以下项目 (参阅图 63 中的项目编号)。

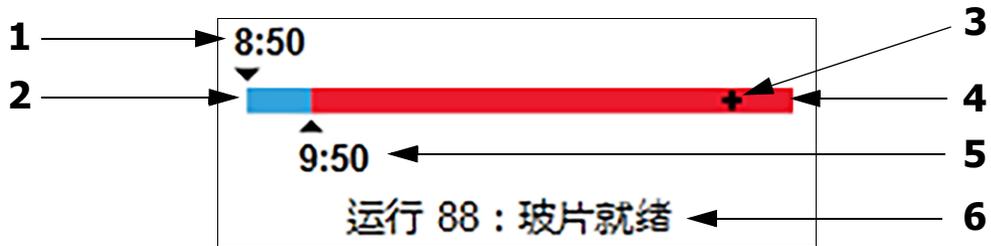


图 63: 运行进度 (正在启动)

编号	描述
1	玻片架被锁定的时间
2	可接受的启动时段 (蓝色条) (参阅下面的可接受的启动时段及警报)
3	当前进度
4	超出启动时间的时段 (红色条)
5	可接受的启动时限
6	运行状态 (参阅上面的运行状态)

可接受的启动时段及警报

应切记在玻片架被锁定后尽快启动染色操作。“启动时段”(锁定玻片架和启动操作之间的时间)的玻片未被水化,因此,若这段时间过长,组织会被损坏。BOND 将帮助您对此进行监控,从玻片架被锁定开始记录时间,并显示已装载玻片类型(浸蜡或脱蜡)可接受的最长启动时段。可接受启动时段在“玻片就绪”进度条中显示为白色条(见上图)。对于脱蜡玻片,如果在可接受启动时段之后的一段时间内染色处理仍未开始,将显示警报。

启动时段和脱蜡玻片的警报时段显示在下表中。所有时间都从玻片架被锁定时开始计时:

可接受启动时段或警报	自玻片架被锁定后的时间 (分)
脱蜡玻片的可接受启动时段	15
脱蜡玻片的至报警时间	25
浸蜡玻片的可接受启动时段	60

如果染色操作没有在启动时段内开始,可以取出玻片架,对玻片进行人工水化。当重新插入玻片架后,BOND 将启动一次新运行,分配新的运行 ID 号,并重新开始计时。

可接受的启动时限仅适用于即时启动的运行,不适用于延迟启动的运行。

已安排

当用启动按钮或延迟启动开始一次运行后，运行即在系统中被安排了进程。在安排进程和处理开始这段期间内（在延迟启动的情况下，这一期间可能很长），进度条将显示以下项目（参阅图 64 中的项目编号）。

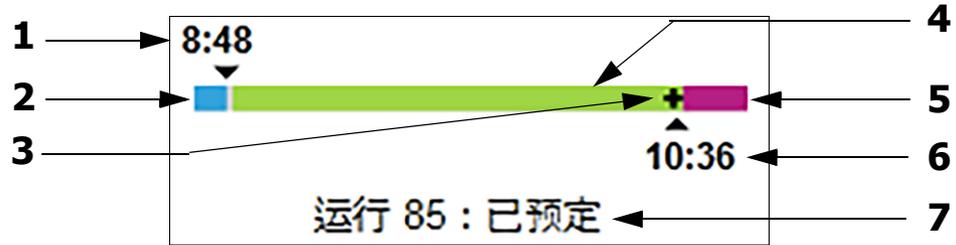


图 64: 运行进度 (正在启动, 已设置延迟启动)

编号	描述
1	预定开始运行的时间
2	启动前的延迟时间 (蓝色条)
3	当前进度
4	处理时段 (绿色条)
5	处理后水化时段 (紫色条)
6	运行结束的大概时间
7	运行状态 (参阅上面的运行状态)

处理期间

在处理期间，进度条显示下列项目（参阅图 65 中的项目编号）。

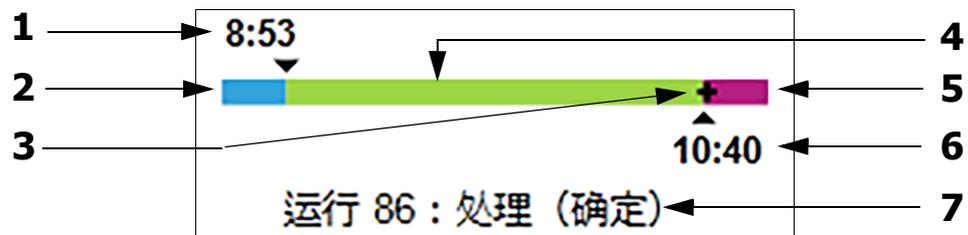


图 65: 运行进度 (正在处理)

编号	描述
1	安排的启动时间
2	正在启动时段 - 蓝色: 启动正常; 红色: 启动超时
3	当前进度
4	处理时段 (绿色条)
5	处理后水化时段 (紫色条)
6	运行结束的大概时间
7	运行状态 (参阅上面的运行状态)

5.1.7 启动或停止运行

装入并锁定玻片架即开始了一次运行，玻片架将被扫图，系统则检查下列内容以确保玻片架可以运行：

- 所有玻片均兼容。
- 所有试剂均可用。

玻片被扫图后，运行状态被设置为**玻片就绪**（参阅上面的**运行状态**），进度条出现在正在启动阶段（参阅上面的**运行进度**）。当玻片不兼容问题得到解决、所有玻片已被识别，且经检查确认所有需要的试剂都存在时，运行即可被启动。

- 若要尽快启动运行，单击 。对于延迟启动，则右键单击玻片架，在弹出菜单中选择**延迟启动**。详细说明请参阅 **5.1.8 延迟启动**。
 - 在运行前检查和进程安排完成后，运行状态被设置为**正在启动**。进度条仍处于正在启动阶段。
 - 一旦进程安排完成，状态就变为**已安排**。此时进度条出现在处理阶段。预定启动时间被显示，启动状态（正常或者超时）会显示在进度条的左端。
 - 当染色处理在预定时间启动时，状态改变为**处理（正常）**。如果启动超时，警告或警报会在处理开始时清除，但进度条的启动部分仍为红色。
 - 注意：**正在启动**和**已安排**状态可能会占用一些时间，从而有可能超过启动时限。如果可能发生这种情况，您可以解锁玻片架，并在重新启动之前以人工方式进行玻片水化。如果在处理开始前解锁某个玻片架，该次运行不被视为已放弃，可以重新启动。

 每次应仅启动一个运行，稍等 1-2 分钟后再启动下一个运行。每启动一个运行后等待片刻以确认启动成功。如果不成功，运行状态将显示为**已拒绝/玻片就绪**。参阅上面的**运行状态**。

停止运行

在按下启动按钮（或激活延迟启动）后直至染色处理实际开始之前 – 此时运行处于**正在启动**或**已安排**状态 – 运行处理可以被中止而不必放弃。如需在此时取消处理请求，可解锁操作仪上的玻片架（在此期间启动和放弃按钮被禁用）。玻片信息仍保留在系统中，而运行可根据需要稍后重新启动。对于被拒绝的运行，**玻片历史**列表中会单独写入一行信息。

如需在染色处理已启动时放弃运行，可单击 。操作仪将在完成当前步骤后停止该次运行的操作，**玻片历史**屏幕上的玻片状态则更改为**完成（通知）**。

 在放弃运行之前应慎重考虑，因为被放弃的运行无法重启，而任何未能完成染色处理的玻片可能受到不良影响。

5.1.8 延迟启动

在 BOND 系统中，浸蜡玻片的运行可以被预定在一个指定的将来时间（从当前时间开始至多一周内）启动。例如，可以将夜间启动的操作定时为在第二天上班前不久结束运行。使玻片在开始处理前处于安全状态、浸蜡完好，并尽量缩短处理后的水化时间。

-  有些非 Leica Biosystems 试剂如果在操作仪中等待延迟启动的时间太久，可能会变质。应查看产品数据表中的试剂使用和储存信息。Leica Biosystems 始终建议将对照组织和检测组织放置在相同的玻片上。

设置延迟启动时间

如要采用延迟启动运行一个玻片架，可按通常方式制备玻片并锁定玻片架。当运行状态为**玻片就绪**时，在**系统状态**屏幕上该玻片架的右键弹出菜单中选择**延迟启动**。

在**延迟启动**对话框中设置启动玻片架的日期和时间，然后点击**确定**（参阅 9.1 玻片历史屏幕中的**使用日期及时间选择框**），系统如常进入**正在启动**状态，并根据其他操作为该次运行安排进程，玻片架随即在**已安排**状态下等待至设定的启动时间后开始正常操作。

5.2 程序状态屏幕

该屏幕显示有关单个玻片状态的详细信息。
若要显示程序状态屏幕，转至系统状态屏幕，单击程序状态页签。

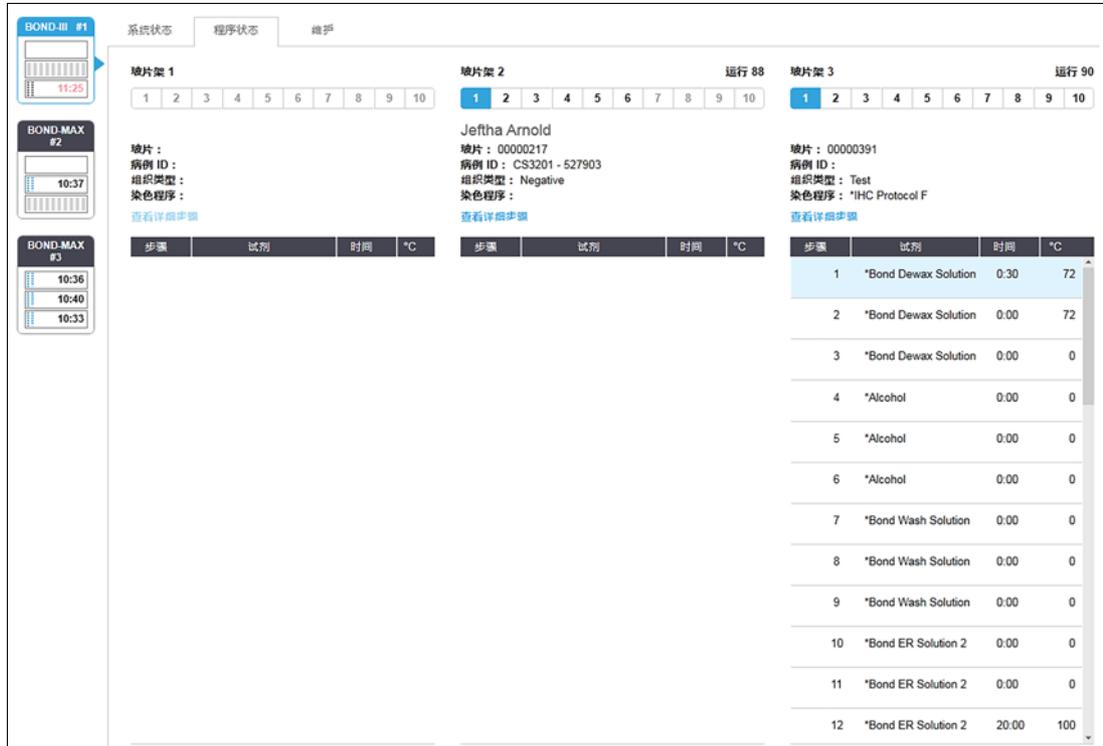


图 66: 程序状态屏幕

要查看某张玻片的运行进度情况，单击屏幕顶部附近的对应的玻片位置按钮。对应于无玻片位置的选项按钮呈灰色，无法选择。

i 如果患者姓名太长，无法适合可用空间（玻片架 1、2 和 3），姓名末尾会被截短为“...”。若想在弹出字段中查看患者全名，将鼠标指针悬停在被截短的姓名上即可。

当选择某个玻片位置时，软件会显示一些玻片详细信息和程序进度。如需查看其他玻片详细信息，可单击**查看详细信息**以打开**玻片属性**对话框。

选定玻片的程序步骤显示在玻片详细信息下方。当前步骤以蓝色突出显示；已完成步骤显示一个带有绿色圆圈的勾号，如有意外事件发生则会显示  图标。

如果当前步骤所需的所有操作都已执行，但在下一步骤开始之前有一段等待时间，该勾号或  为灰色，并会保持灰色直至下一步骤开始时变为正常的颜色。

您可以查看运行事件，方法是右键单击步骤列表，在弹出菜单中选择**运行事件**。您还可以使用弹出菜单打开**玻片属性**对话框。

5.3 维护屏幕

若要显示**维护**屏幕，转到**系统状态**屏幕，单击**维护**页签。



图 67: **维护**屏幕中有几个命令按钮，用于执行一系列维护任务，见下表：

命令	描述
更换注射器	在更换注射器的同时控制操作仪。 参阅 12.13 注射器 。
清洗液流系统	灌注液流系统。 参阅 12.5 重启操作仪中的清洗液流系统 。
清洗抽吸探针	用 BOND Aspirating Probe Cleaning System 清洁抽吸探针。 参阅 12.6.1 清洁抽吸探针 。
更换抽吸探针	在更换抽吸探针时控制操作仪。 参阅 12.6.2 更换抽吸探针 。
清洗大用量液流自控装置探针	将大用量液流自控装置（仅 BOND-III）移动到位，以便将探针擦拭干净。 参阅 12.12.1 清洁大用量液流自控装置探针
更换大用量液流自控装置探针	将大用量液流自控装置（仅 BOND-III）移动到位，以便更换探针。 参阅 12.12.2 更换大用量液流自控装置探针
维护报告	生成所选操作仪的维护报告。此命令始终可用。参阅 5.3.1 维护报告

维护屏幕显示当前选定的操作仪的名称以及相关的维护命令按钮。一系列对话框可帮助您执行所选择的维护任务。

当某个维护任务无法执行时，例如当维护已在进行中时，其命令按钮即被禁用。当操作仪断开连接时，所有的命令按钮（除了**维护报告**以外）都被禁用。

5.3.1 维护报告

维护报告显示特定操作仪在所选时间范围内的信息。

1. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其**系统状态**屏幕。
2. 点击**维护**页签，然后点击**维护报告**按钮。



维护报告

选择操作仪

序列号: 3210123

名称: BOND-III #1

类型: BOND-III

时间跨度

自: 2016/4/5

至: 2017/4/5

最近 12 个月

生成 取消

图 68: 维护报告对话框

在下拉列表中选择操作仪，然后使用**自**和**至**日历控件选择时间范围。或者，您可以点击**最近十二个月**将时间范围设定为这一时期。

点击**生成**生成维护报告。

报告将显示在新窗口中。报告的右上角显示下表中的信息：

字段	描述
科室	在管理客户端 实验室设置 屏幕上的 科室 字段中输入的科室名称 – 参阅 10.5.1 实验室设置
时间范围	用于设置报告的时间范围的“自”和“至”日期时间栏
操作仪	在管理客户端 硬件配置 屏幕中的 名称 字段中输入的操作仪的唯一名称 – 参阅 10.6.1 操作仪
操作仪序列号	操作仪的唯一序列号

关于该报告有以下几点说明：

- 当维护日期已到时（此时估计日期将会显示“立即进行维护”），系统状态屏幕上的操作仪图标上将显示一个注意图标（如 [5.1.2 硬件状态](#)所述），右键点击可查看提示通知。
- 下一次维护任务的估计日期是根据两次维护之间处理的玻片数量和/或推荐时间范围而估算的。
- 如果在报告的时间范围内没有事件历史，将显示一段相关声明来代替历史表格。
- 历史表格中的第一个日期既可以是报告时间范围的起始日期，也可以是操作仪的启用日期（如果以后有如此操作）。相关的“自上次维护/更换后处理的玻片”列将始终显示 0 张玻片。
- 历史表格中的最后一个日期是报告时间范围的结束日期。
- 每台玻片染色装置都有玻片计数，并有全部 3 台染色装置的总玻片计数。每次成功完成维护任务后，玻片计数将重置为零。
- 每台玻片染色装置的大用量液流自控装置探针都有各自的玻片计数。
- 每台玻片染色装置的注射器有各自的玻片计数。
- 主注射器有单独的玻片计数。
- 在 BOND 5.0 或更早版本中完成的维护操作的“完成状态”列中可能显示“未知”。
- 在 BOND 4.0 或更早版本中完成的维护操作将不会显示。

6

玻片设置（在 BOND 控制器上）

创建玻片以使用 BOND 进行处理的标准工作流程包括以下几个主要步骤：

1. 制备玻片上用的切片。
2. 在 BOND 软件中为玻片创建一个病例（或者从实验室信息系统（LIS）导入病例）。
3. 若有必要，添加或编辑医生详细信息。
4. 输入玻片详细信息（或者从实验室信息系统（LIS）导入）。
5. 按实验室的标准操作方法创建对照玻片。
6. 粘贴玻片标签（除非已粘贴实验室信息系统（LIS）标签）。
7. 将玻片放到玻片架上，再将玻片架放到操作仪中。

当玻片处理开始后，即可在**玻片历史**屏幕上生成一系列玻片、病例和运行报告。参阅 [9 玻片历史（在 BOND 控制器上）](#) 中的详细内容。

如果标准工作流程不适合您的实验室，还有其他工作流程。

本章有以下章节：

- [6.1 玻片设置屏幕](#)
- [6.2 使用对照](#)
- [6.3 使用病例](#)
- [6.4 管理医生](#)
- [6.5 使用玻片](#)
- [6.6 玻片标签](#)
- [6.7 玻片设置概要报告](#)
- [6.8 即时玻片和病例创建](#)
- [6.9 玻片兼容性](#)

6.1 玻片设置屏幕

玻片设置屏幕显示已输入 BOND 但尚未处理的病例和玻片。对于实验室信息系统 (LIS) 集成系统, 该屏幕可显示从实验室信息系统 (LIS) 导入的病例和玻片。对于非实验室信息系统 (LIS) 系统, 您可以在该屏幕中创建病例和玻片, 并在必要时对它们进行编辑。玻片必须属于某个病例, 因此, 您必须先创建病例, 然后再创建玻片。

若要显示**玻片设置**屏幕, 点击功能栏上的**玻片设置**图标。

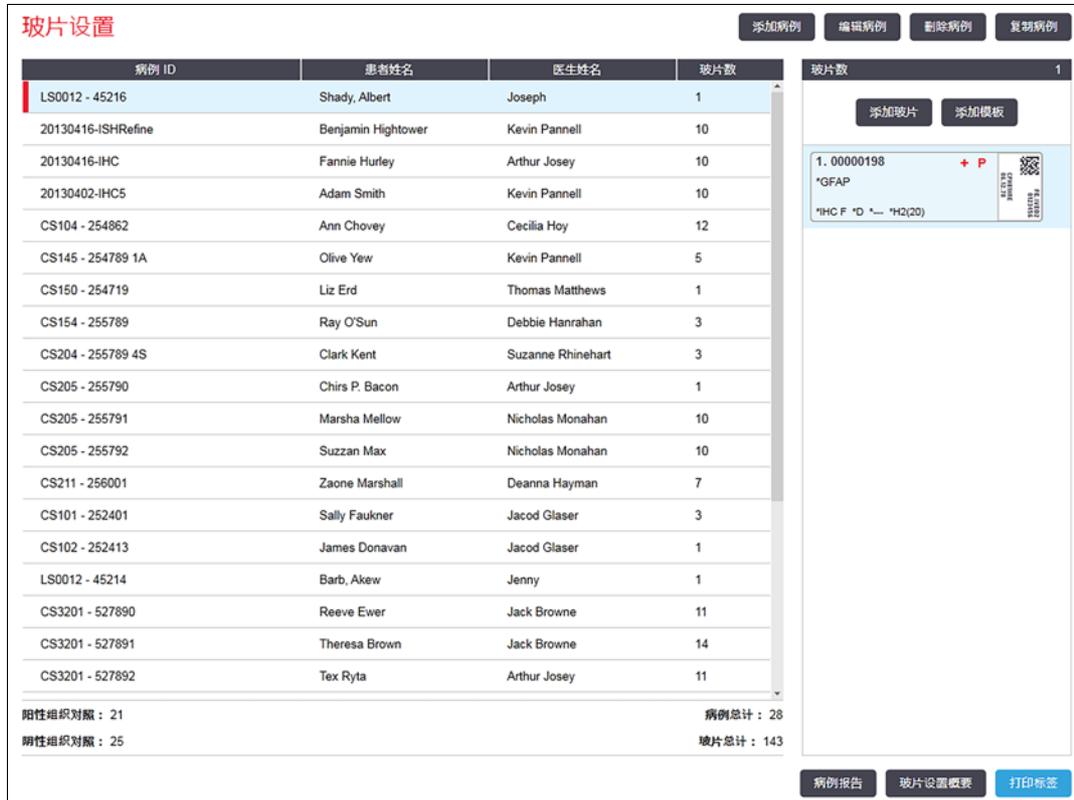


图 69: 玻片设置屏幕

图 69 显示了**玻片设置**屏幕。屏幕右上方包含用于病例的功能, 屏幕右侧包含用于玻片的功能。

6.2 使用对照

Leica Biosystems 建议将对照作为 BOND 系统的常规使用项目。某些诊疗系统包括自有的对照玻片, 但系统说明书仍可能建议采用额外的机构内自备对照。请切记: 对照是对整个处理过程的检验。参阅 [14.3 质量控制](#) 中的进一步讨论。

i 为了尽可能充分检验 BOND 系统的性能, Leica Biosystems 强烈建议将合适的对照组织与患者组织放在相同的玻片上。

尽管强烈建议将对照组织与检测组织放置在同一玻片上, 但 BOND 软件也允许玻片仅包含对照组织和试剂对照。切记将仅有对照组织的玻片仔细做好标记, 以避免与患者检测标本混淆。

6.2.1 对照组织

每张玻片都必须作为下列组织类型之一输入 BOND 软件：

- 测试组织
- 阴性组织
- 阳性组织

此设置在**添加玻片**对话框中进行 (见 [6.5.2 创建玻片](#))。任何包含患者检测组织的玻片皆应设置为“检测组织”。“阳性组织”和“阴性组织”对照设置仅用于仅包含对照组织的玻片。

每当在**添加玻片**对话框中更改了新建玻片的组织类型时，**标记**字段将自动清除，以确保您能为该组织选择正确的标记。

阴性或阳性组织玻片在**玻片设置**屏幕中被分别标示为“-”或“+”。**玻片历史**屏幕的**类型**列将显示每张玻片的“检测”、“阴性”或“阳性”类型。

为了使玻片自身作为对照能一目了然，我们把“组织类型”作为默认玻片标签模板的信息字段之一，这将在阳性对照组织标签上打印一个较大的“(+)”，在阴性对照组织标签上打印一个较大的“(-)”，而在检测组织的该区域中不打印任何标记。我们建议在您设置的其他玻片标签中也包含该字段 (参阅 [10.3 标签](#))。

6.2.2 对照试剂

在玻片设置期间，通过选择相应的试剂做标记来为玻片设置对照试剂，以代替标准抗体或探针。

对于免疫组化 (IHC)，BOND 软件有一个阴性对照试剂选项。在**添加玻片**对话框中选 IHC，然后在**标记**下拉列表中选择***阴性**，BOND 就会为这些步骤输送 BONDWash Solution (洗涤溶液)。

对于原位杂交 (ISH)，BOND 软件包含用于 RNA 和 DNA 的阴性和阳性对照试剂。在**标记**列表中选择相应的对照探针。

如果标记字段包含在适用的玻片标签模板中，则除了使用**玻片设置**屏幕和玻片标签上显示的标记名称外，对照试剂的玻片无需其他特别标注。

6.3 使用病例

本节描述玻片设置屏幕左侧用于设置病例的功能。描述性章节后面的各小节给出了添加、编辑和删除病例详细信息的步骤。

以下章节包括：

- 6.3.1 病例对照和活动病例信息
- 6.3.2 病例标识
- 6.3.3 添加病例
- 6.3.4 病例重复、激活和完成
- 6.3.5 编辑病例
- 6.3.6 复制病例
- 6.3.7 日常病例选项
- 6.3.8 病例报告

6.3.1 病例对照和活动病例信息

单击**添加病例**可添加新病例的详细信息。

6.3.3 **添加病例**对此过程进行了说明。

单击**编辑病例**可编辑现有病例的详细信息。

6.3.5 **编辑病例**对此过程进行了说明。

单击**删除病例**可删除现有病例。

6.3.5 **编辑病例**中的**删除病例**说明了如何删除病例。

单击**复制病例**可添加病例及该病例玻片的副本。

6.3.6 **复制病例**说明了如何复制病例。

右键单击病例，在弹出的菜单中也可找到**编辑**、**删除**和**复制**命令。

点击**病例报告**（在病例列表下方）可查看选定病例的报告（参阅 6.3.8 **病例报告**）。

按钮下方的表格显示下述活动病例信息：

病例 ID	病例标识。可以是任意字母数字字符。 由于该字段可以包含字母和数字，单击表格的病例 ID 列标题可将该字段作为文本进行排序 – 以“10”开头的标识符将排在以“2”开头的标识符的前面。
患者姓名	患者的标识。
医生姓名	负责该患者的医生或病理医师的姓名。
玻片	为选定病例设置的未经处理的玻片数目。 当玻片染色处理启动时，玻片即从 玻片设置 屏幕被移到 玻片历史 屏幕，此数目也相应地被更新。

左侧带有红色边框的病例表明该病例有一个或更多优先实验室信息系统（LIS）玻片（参阅 11.2.5 **优先玻片**）。

在活动病例列表下方有一个所有病例和玻片的摘要，如下所示：

阳性对照组织	当前已输入但未运行的所有病例的阳性对照组织的总数。
阴性对照组织	当前已输入但未运行的所有病例的阴性对照组织的总数。
病例总计	活动病例总数。
玻片总数	当前已输入但未运行的所有病例的玻片总数。

6.3.2 病例标识

BOND 系统使用两种主要的病例标识符：病例 ID 和病例编号（在软件中分别为**病例 ID**和**病例号**）。

- **病例 ID**：用户输入的采用实验室识别方法的病例 ID。对于在 BOND 中创建的病例，病例 ID 是在创建病例时在**添加病例**对话框中输入的。对于 LIS-ip 系统，病例 ID 是从实验室信息系统 (LIS) 接收的（在实验室信息系统 (LIS) 中可能称为“登记号”或其他术语）。
- **病例号**：BOND 系统自动分配给系统中每个病例（在 BOND 中创建的和从实验室信息系统 (LIS) 接收到的病例）的唯一识别号码。病例号显示在**病例属性**对话框中。

4.1 版本以前的 BOND 版本不要求病例 ID 是唯一的，因此，可能会有两个或更多个不同病例共用同一个病例 ID。但这些病例很可能有不同的患者姓名，并且病例编号必定不同。在 BOND 4.1 及以上版本中，所有的新病例 ID 必须是唯一的。

病例也经常通过患者姓名被识别，但患者姓名不是必需的，也不必是唯一的。

6.3.3 添加病例

要添加病例，可从**玻片设置**屏幕开始执行以下操作：

1. 在**玻片设置**屏幕上单击**添加病例**，显示**添加病例**对话框（参阅图 70）。

图 70: 添加病例对话框

在**病例 ID**、**患者姓名**、**病例注释**和**医生**字段中输入相应的详细信息。

- i 可以添加没有任何病例信息的病例。
 - 2. 如果所需的医生不在**医生名单**内，可点击**管理医生**打开**管理医生**对话框以添加该医生（参阅 6.4 **管理医生**）。
 - 3. 如果为该病例创建的玻片的分配容量与早已设置好的默认分配容量不同，则选择一个分配容量。
 注意：在 BOND-III 仪器中处理的所有玻片都要求是 150 µL 的分配容量。此外，所有类型的操作仪中的原位杂交（ISH）染色都采用 150 µL 分配容量。
 有关玻片可用区域和分配容量的内容，请参阅 6.5.8 **分配容量和组织在玻片上的位置**。
 - 4. 在**制备程序**列表选择一个制备程序选项（参阅图 70），使其成为该病例玻片的默认程序。
 - 5. 若要在不向系统输入任何信息的情况下离开对话框，可单击**取消**。
 若要输入病例的详细信息，请单击**确定**。
 - 6. 病例被添加到病例列表中。
- i 如果系统中已存在该病例 ID，则**病例 ID 重复**对话框将会打开（参阅下面的**病例重复、激活和完成**）。

6.3.4 病例重复、激活和完成

BOND 4.1 以前的软件版本曾允许不同的病例拥有相同的病例 ID。这些病例一般通过患者姓名加以区分，而且唯一病例号也可确保其区分。BOND 不再允许新病例使用与已有病例相同的病例 ID – 每个新病例必须被给予一个唯一的病例 ID，或者被确认为与系统中某个原有病例属同一个病例。

如果您输入的某个病例的病例 ID 在系统中早已存在，**病例 ID 重复**对话框就会打开，显示具有相同病例 ID 的已有病例。若要使用已有病例，选中该病例并点击**使用所选病例**（另参阅下面的**合并病例**）。否则，点击取消退出对话框，更改病例 ID，将其创建为新病例。

病例 ID 重复对话框中的病例可能是已删除病例、已过期病例（即病例中的所有玻片都已被处理 – 参阅下文），也可能是仍列在**玻片设置**屏幕上的现有病例。当已过期病例被选中并恢复到病例列表中后，病例即被称为“已激活”。

参阅 10.2 实验室信息系统（LIS）中的**重复病例 ID** 关于实验室信息系统（LIS）病例的重复病例 ID 的说明。

合并病例

如果您编辑一个病例 ID，使其与一个已有病例 ID 相同，然后在随后出现的**病例 ID 重复**对话框中点击**使用所选病例**，则被编辑病例中的所有未处理玻片就会被移到已有病例中。

 只有包含未处理玻片的病例才能被编辑，因此，包含已处理玻片的病例无法更改。

已处理病例保留时间

当某个病例中的最后一张玻片处理完成后，该病例即在玻片架解锁后 10 分钟内被从玻片设置屏幕上移除（根据默认设置）。

您可以通过设置，让 BOND 在病例中最后一批玻片处理完毕后将该病例在**玻片设置**屏幕上保留一定天数。这个“已处理病例保留时间”的设置和管理客户端的**实验室**屏幕中进行（参阅 **10.5.2 病例与玻片设置**）。

已过期病例存储在系统中，但不能查看。通过重新添加该病例（将其激活）或利用实验室信息系统（LIS）向病例中添加玻片，已过期病例即可被恢复到列表中。

 不包含任何已处理玻片的病例不会自动从玻片设置屏幕上移除。

6.3.5 编辑病例

要编辑病例详细信息，在列表中选择该病例，然后单击**编辑病例**，软件即显示**病例属性**对话框，该对话框的使用方法与前面描述的**添加病例**对话框相同。

-  如果您编辑了一个病例的详细信息，而该病例的玻片标签已打印，在尝试运行玻片之前应重新打印标签（屏幕上将显示相关的提示信息）。

删除病例

要删除病例，在列表选中它后点击**删除病例**。

-  当**玻片设置**屏幕中某个 BOND 病例仅包含未处理的玻片时，您可以手动删除该病例，使其成为“已过期”病例（所有的实验室信息系统（LIS）病例一旦不包含未处理玻片后即自动过期）。
-  如果某个病例包含正在处理或已处理的玻片，则该病例无法被手动删除。
-  删除病例也将同时删除为该病例创建的全部未处理玻片。您可以恢复已删除病例的详细信息，但不能恢复其玻片。

6.3.6 复制病例

若需为某个患者建立新病例，复制病例是一种十分方便的方式。您可以视需要更改新病例中的病例详细信息，或保留相同内容。新病例号会自动创建，但您必须输入一个新的病例 ID。

-  如果病例包含的某张玻片涉及到已删除程序，则该病例无法被复制。

被复制的玻片可以在**玻片设置**屏幕上进行处理和打印标签。删除不需要的玻片的方法是在玻片上单击右键并选择**删除玻片**。

复制病例：

1. 在**玻片设置**屏幕左侧的病例列表中选择要复制的病例。
2. 点击**复制病例**；软件将显示**复制病例**对话框。
3. 输入一个新的病例 ID 并视需要编辑病例详细信息。
4. 选择**未处理玻片**，或视需要选择**所有玻片**。
 - 未处理玻片 – 仅复制原始病例中的未处理玻片。
 - 所有玻片 – 复制原始病例中的全部玻片（未处理、正在处理和已处理的）。系统会将新病例中的全部玻片标记为未处理。
5. 点击**确定**。

系统即创建新病例并根据选定的选项复制玻片。所有已复制玻片（包括实验室信息系统（LIS）玻片）的表现方式与在**添加玻片**对话框中创建的玻片相同（参阅 [6.5.1 玻片字段及控件说明](#)）。

6.3.7 日常病例选项

BOND 系统可被设置为每 24 小时自动创建一个新病例，将每天的全部玻片都创建到这同一个病例中。这可以为玻片处理数量较少的实验室节省时间，因为不必输入患者姓名和病例 ID。日常病例具有以下属性：

- 病例 ID 被设置为新的一天的日期。
- 分配容量和制备程序默认为在管理客户端设置的系统默认设置。可以对其进行编辑。
- **患者姓名和医生**字段保持空白，且不能更改。

您仍可以按通常方式创建单独的病例，其中包括日常病例选项。参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#) 中关于设置日常病例选项的说明。

6.3.8 病例报告

您可以为单个病例生成报告。报告可显示基本的病例详细信息和病例中全部玻片的信息，如玻片 ID 以及用于玻片的染色程序和试剂。打印的报告上留有空白处，可在其中填写关于每张玻片的注释。参阅 [9.6 病例报告](#) 中的完整说明。

在**玻片设置**和**玻片历史**屏幕上可生成病例报告。选择相应的病例或玻片，然后点击**病例报告**按钮。病例报告仅包含已在操作仪中处理并解锁的玻片的试剂详细信息。

6.4 管理医生

BOND 保存了一份医生名单，以便您选择将医生添加到病例详细信息中。在**添加病例**或**病例属性**对话框中的“首选”医生列表中选择医生，或者在从同一病例属性对话框中打开**管理医生**以添加或编辑医生。

针对每位医生将显示以下字段：

- 姓名：– 医生的姓名
- LIS ID：– 由实验室信息系统提供的唯一标识符（若适用）
- 首选 – 医生的首选状态（创建病例时，只有首选医生才会显示在下拉列表中）。该状态在**编辑医生**对话框中设置。

这些值也显示在**编辑医生**对话框中。另外，**编辑医生**对话框还有：

- ID：– 由 BOND 系统自动生成和分配的唯一 ID
- 注释：– 可编辑字段，用于一般性注释或其他姓名信息

打开**管理医生**对话框，点击**新建**或**编辑**即可添加新医生或编辑已有医生的详细信息。编辑仅限于注释字段和更改首选状态 – 您无法在创建医生之后更改医生的姓名。

可以将医生从**管理医生**对话框中删除。先前创建的包含已删除医生的病例将继续显示该医生的姓名，但新病例则不能够选择该医生。新建医生不能重新使用已删除的医生姓名。

6.5 使用玻片

本节介绍**玻片设置**屏幕中的玻片创建和管理。最后一节介绍分配容量设置以及分配容量对组织在玻片上的位置的影响。


- [6.5.1 玻片字段及控件说明](#)
- [6.5.2 创建玻片](#)
- [6.5.3 复制玻片](#)
- [6.5.4 编辑玻片](#)
- [6.5.5 删除玻片](#)
- [6.5.6 手动识别玻片](#)
- [6.5.7 添加玻片模板](#)
- [6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置](#)

6.5.1 玻片字段及控件说明

玻片列表上方有两个按钮：


- 单击**添加玻片**可为选定的病例添加玻片。
- 单击**添加模板**可为选定的病例添加模板。
更多信息可参阅 [6.5.7 添加玻片模板](#)。

屏幕右边的玻片列表可显示在屏幕左边选定的病例的玻片详细信息。每个玻片都显示玻片 ID 和将在该玻片上运行的操作规程详细信息。玻片右边的标签区域用以下颜色编码来表明其被创建的位置：

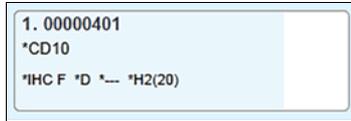


白色：

在**添加玻片**对话框中创建的玻片 (参阅 [6.5.2 创建玻片](#))

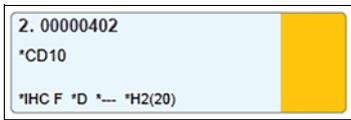

黄色：


在**玻片识别**对话框中创建的玻片 (参阅 [6.8 即时玻片和病例创建](#))



浅灰色：


LIS 玻片 (参阅 [11 实验室信息系统 \(LIS\) 集成 组件 \(在 BOND 控制器上\)](#))

玻片还显示以下符号：

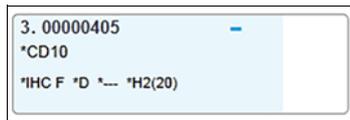


负号：

阴性组织玻片 (见 [6.5.2 创建玻片](#) 中的步骤 4)

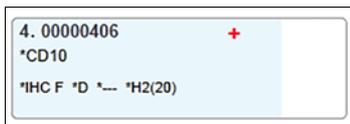

正号：

阳性组织玻片 (见 [6.5.2 创建玻片](#) 中的步骤 4)



红色字母 P：

实验室信息系统 (LIS) 优先玻片 (参阅 [11.2.5 优先玻片](#))



示例标签：

玻片标签已打印

双击玻片，打开该玻片的**玻片属性**对话框。右键单击删除玻片，或为其打印标签。

6.5.2 创建玻片

若要创建 Leica 诊疗系统玻片，请参阅随系统一起提供的说明。

要创建新玻片：

1. 点击病例列表中的病例。
2. 点击**添加玻片**打开**添加玻片**对话框。

图 71: 添加玻片对话框

新玻片将被自动编号，获得一个唯一**玻片 ID**，但该编号要在您点击对话框中的**添加玻片**按钮保存该玻片后才会显示。

3. 如有需要，可添加玻片注释。
4. 单击**组织类型**按钮组中的单选按钮选择组织类型（“检测组织”、“阴性组织”、“阳性组织”）。参阅 [6.2.1 对照组织](#)，并参阅了解关于对照，[14.3.2 对照组织](#)的更多讨论。
5. 必要时可更改玻片的分配容量（参阅 [6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置](#)）。

6. 选择染色方法。
 - 如果要进行单染，在第一个字段中选择**单染**（默认设置）；若是双染玻片，选择**顺次双染**或**并行双染**（参阅 7.1.1 染色方法）。
 - 在第二个字段中选择**常规**（默认设置）（只有当 Bond™ Oracle™ HER2 IHC 系统说明书中指定选择 **Oracle** 时，才能选择该设置）。
7. 选择染色方式（免疫组化（IHC）或原位杂交（ISH））。
8. 如果选择了单染，在**单染**页签的**标记**下拉列表中选择一抗或探针；顺次双染在**第一次**页签中选择；如果选择了并行双染，则在**并行双染**页签中选择。

若要使用阴性免疫组化（IHC）对照试剂，可选择默认阴性试剂 ***阴性** 或者您创建的阴性试剂（参阅 14.3.3 免疫组化（IHC）阴性对照试剂）。

如需运行阴性原位杂交（ISH）对照试剂，可选择“*RNA Negative Control Probe”或“*DNA Negative Control”。

如需运行阳性原位杂交（ISH）对照试剂，可选择“*RNA Positive Control Probe”或“*DNA Positive Control Probe”。



如需在**标记**下拉列表中添加或删除项目，可在软件的**试剂设置**屏幕上选中或取消选中试剂的**首选**字段。更多信息请参阅 8.2.1 添加或编辑试剂。

9. 为每个操作阶段选择相应的程序。

当选定某种一抗或探针时，软件将输入默认程序。请检查每个阶段所设置的程序是否正确，必要时在相应的下拉列表中选择新的程序。如果某一特定阶段不需要程序，则选择 * - - - -。

默认程序是在**试剂设置**屏幕中设定的。参阅 8.2.1 添加或编辑试剂。



如需在**程序**下拉列表中添加或删除项目，可在**程序设置**屏幕上选中或取消选中程序的**首选**字段。更多信息请参阅 7.2.1 程序详细信息。

10. 如果采用顺次双染，单击**第二次**页签选择第二标记。

对于第一个标记，核对默认程序，需要时可作更改。
11. 点击**添加玻片**。

添加玻片可添加玻片以及当前显示在**添加玻片**对话框中的详细信息，其后对话框保持打开，这样就可以方便快速地为选定的病例添加多个玻片。
12. 当病例玻片添加完毕时，点击**关闭**。

6.5.3 复制玻片

i 涉及到已删除程序的玻片无法被复制。

复制已有玻片：

1. 双击需复制的玻片，打开**玻片属性**对话框。
2. 点击**复制玻片**。
对话框变更为**添加玻片**，其中有一个**添加玻片**按钮。
3. 检查玻片详细信息并作必要的更改。
4. 点击**添加玻片**。

新病例，包括任何注释都将作为复制玻片被添加到相同病例中。

6.5.4 编辑玻片

如需在**玻片设置**屏幕上编辑玻片的详细信息，双击玻片打开**玻片属性**对话框。按 [6.5.2 创建玻片](#) 中的说明更改详细信息。

i 如果您编辑了已打印标签的玻片的详细信息，需重新打印标签，然后再处理玻片。

6.5.5 删除玻片

若要从玻片列表中移除某个玻片时，在**玻片设置**屏幕上的玻片列表中右键单击该玻片，然后在子菜单中选择**删除玻片**。也可以用删除键删除选中的玻片。

6.5.6 手动识别玻片

可以随时对 BOND 系统中的任何玻片进行识别。点击功能栏中的**搜索**图标，打开**手动 ID 输入**对话框。



图 72：手动 ID 输入对话框

仅对于有一维或二维条形码标签 (例如由 BOND 打印标签) 的玻片, 扫描其标签可以打开该玻片的**玻片属性**对话框。或者手动输入 8 位数的数字 ID, 包括前边的几个零, 然后点击**验证**。

对于有字母数字组合 ID 的玻片, 在字段中键入四位字符的玻片 ID (标签 ID 的前四位字符), 然后点击**验证**。

6.5.7 添加玻片模板

模板是相关组织类型的预定义标记物设置。使用模板可以快速添加多张玻片, 这些玻片具有通常需一起使用的标记 – 参阅 [8.4 试剂模板屏幕](#)。

如需向病例中添加玻片模板, 可在**玻片设置**屏幕中执行以下操作:

1. 单击**添加模板**, 从**模板中添加检测**对话框随即打开。
2. 从下拉列表中选择模板, 模板中的玻片会显示出来。
3. 如果有必要, 可通过取消选中复选框排除某些玻片, 然后单击**确定**。

BOND 就会将玻片添加至病例。

对于原位杂交 (ISH) 玻片, 分配容量自动设置为 150 μL 。

对于免疫组化 (IHC) 玻片, 分配容量设置为病例默认值。

对于所有玻片, 制备程序会设置为病例默认设置。

 模板可用于添加使用单染或并行双染的染色方法的玻片, 但不能用于添加使用顺次双染的玻片。

6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置

BOND 软件有两种分配容量设置, 用于在**添加玻片**对话框中对每张玻片进行设置 (参阅 [6.5.2 创建玻片](#))。100 μL 设置仅用于 BOND-MAX 操作仪中的免疫组化 (IHC) 玻片。在 BOND-III 中处理的所有玻片以及 (在两种类型操作仪中处理的) 所有原位杂交 (ISH) 玻片都必须使用 150 μL 设置。

分配容量设置将决定试剂在玻片上分布的区域以及分配的试剂量:

- 对于 100 μL 分配量, Covertile 被向下回拉至玻片的大约中间位置, 抽吸探针则在 Covertile 的顶部 (约为玻片的中间位置) 输送抗体。
- 对于 150 μL 分配量, Covertile 覆盖大部分玻片, 试剂仍然在 Covertile 的顶部输送, 使更大面积的玻片能接触到试剂。

接触试剂的玻片面积的不同, 意味着正确放置组织非常重要。100 μL 分配量通常仅能使一个样本被染色, 样本应放置在玻片的下半部分 (远离标签的部分)。而对于 150 μL 分配量, 在玻片上放置两个组织标本更加容易; 若只有一个标本, 则应放置在玻片的中间。不同分配量设置的可用玻片区域如 [图 73](#) 所示。Leica BOND Plus 玻片则有标记用于显示组织应当被放置的区域。

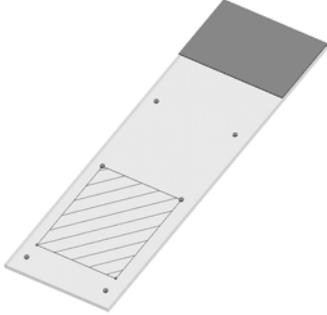
	100 μL	150 μL
可用区域		

图 73: 有条纹块的区域表示组织在不同分配容量的玻片上应当放置的位置。
Leica BOND Plus 玻片则具有图中所示的位置标记圆点 (参阅 2.6.1 玻片)。

BOND-III 操作仪仅在 150 μL 位置分配试剂 – 如果装载了 100 μL 分配容量的玻片, 将不能启动操作。

对于 BOND-MAX 和 BOND-III 中的免疫组化 (IHC) 玻片, 抗体的分配量显示在**添加玻片**对话框中, 为 100 μL 或 150 μL 。对于原位杂交 (ISH) 玻片 (两种仪器), 150 μL 设置是强制性的, 操作仪会采用 150 μL 时的 Covertile 位置和探针位置。但对于以下情况, BOND 分配的探针量将超过 150 μL :

- 对于 RNA 探针, BOND 分两个步骤分配 220 μL – 150 μL 和 70 μL ;
- 对于 DNA 探针, BOND 分两个步骤分配 240 μL – 150 μL 和 90 μL 。

洗涤和其他步骤则视程序的不同而应用不同的分配量。

分配容量默认值

对于 BOND-MAX 中的免疫组化 (IHC) 操作, 可以为各个玻片单独设置分配容量 (150 μL 或 100 μL), 但 BOND 则允许设置两种级别的默认值。可以设置整个系统的默认值 (参阅 10.5.2 病例与玻片设置)。单个病例的这一默认值可以用**添加病例**对话框中设定的病例默认值覆盖 (参阅 6.3.3 添加病例), 而最终在**添加玻片**对话框中, 可以为单个玻片设置分配容量 (参阅 6.5.2 创建玻片)。

需在同一次运行中一起处理的玻片必须都具有相同的分配容量 (参阅 6.9 玻片兼容性)。

6.6 玻片标签

需要在 BOND 系统中染色的所有玻片都必须粘贴标签以便软件进行识别，从而对它们运行正确的染色程序。在 BOND 中创建的玻片标签全都有标签 ID (用字母数字字符或条形码表示)，用于在操作仪中自动识别玻片。在实验室信息系统 (LIS) 中创建的标签 (使用条形码 ID) 也能被自动识别。但是，玻片标签上还应包含可人工识读的附加信息，以便在标签 ID 无法被自动识别时 (例如当标签脏污时) 仍可以识别玻片 (参阅 10.3 标签)。

玻片必须在被放入仪器之前贴上标签。应注意正确粘贴标签，以便 ID 扫图仪能够有效地对标签 ID 进行扫描 (对于 1D 或 2D 条形码) 或扫图 (对于字母数字 ID 以及某些情况下的条形码)。

您必须使用 Leica Biosystems 提供的玻片标签，与 BOND 玻片标签仪配合使用。

- 6.6.1 打印标签和在玻片上粘贴
- 6.6.2 玻片 ID 和标签 ID

6.6.1 打印标签和在玻片上粘贴

i 若要打印单张玻片的标签，右键单击该玻片，然后选择**打印标签**。在这种情况下，**打印玻片标签**对话框不会弹出。在包含设定的仪器组的 BOND-ADVANCE 系统中，将使用默认的玻片标签仪打印标签。否则，将使用排在列表第一位的玻片标签仪 (参阅 10.6.3 玻片标签仪)。

1. 设置了所有玻片后，在**玻片设置**屏幕上单击**打印标签**。
2. 选择要打印的玻片标签：
 - 所有未打印玻片标签 – 所有病例中尚未打印标签的玻片。
 - 当前病例的所有未打印玻片标签 – 当前病例中尚未打印标签的玻片。
 - 当前病例 – 当前选定病例的所有玻片，包括以前打印过标签的玻片。

i 玻片标签的打印顺序是其病例的创建顺序；而在每个病例中，则按照玻片的创建顺序打印。

3. 选择要使用的玻片标签仪。
(在管理客户端的**硬件**屏幕中设置默认标签仪 – 参阅 10.6.2 仪器组。)

4. 单击**打印**。

i 当玻片标签正在打印时，**玻片设置**屏幕的左下角会显示一个闪动的图标。

5. 确保玻片的磨砂区域 (粘贴标签的区域) 完全干燥 (仅用纸巾擦拭是不够的)，然后粘贴标签，使玻片 ID 与玻片末端平行对齐。

当使标签位于上方拿起玻片时，标签应正面向上 (和组织处于玻片的同一面)。



要将标签贴正，因为操作仪无法正确扫描未对齐的标签。



图 74：将标签贴在玻片各个边缘以内



将标签的所有部分都安置在玻片的四个边缘以内。暴露的粘性表面会导致玻片标签（以及玻片）粘在 Covertile 或其他设备上，从而损坏玻片。

外部脱蜡及抗原修复

如果要在 BOND 仪器外进行脱蜡和抗原修复，最好在贴好玻片标签后进行。这可以避免在您输入玻片详细信息和设置 BOND 运行所需的程序时玻片变干燥，还可避免在这些步骤之后往湿玻片上贴标签的麻烦。

- i** 如果要在仪器外使用二甲苯进行脱蜡，应避免触摸标签，这样打印内容就不会变得模糊。也可事先用 BOND 玻片标签封套将标签密封好。
- i** 长时间在二甲苯和/或水中浸泡或接触这类溶液会降低玻片 ID 标签的粘贴效果。我们建议标签在二甲苯或水中浸泡的时间不应超过十分钟。在仪器外部脱蜡和脱水时，应注意将试剂液位保持在玻片标签以下。



仅可将 BOND Dewax Solution 用于 BOND 仪器。不要使用二甲苯、二甲苯替代品或其他能损害仪器部件并导致液体泄漏的试剂。

6.6.2 玻片 ID 和标签 ID

每次创建新玻片时，BOND 系统会提供唯一“玻片 ID”。每次打印玻片标签时，BOND 系统也会创建唯一的“标签 ID”。

可通过管理客户端设置标签 ID 为字母数字 ID (OCR)、1D 条形码或 2D 条形码（参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#)）。

- i** 实验室信息系统（LIS）玻片的玻片 ID 可以由实验室信息系统（LIS）定义，并可能是任意数字值（8 位数字或更少）。

条形码标签 ID

条形码标签使用 4-ASCII 字符标签 ID，是玻片的唯一标识符。

字母数字标签 ID

字母数字标签的前四位字符是唯一的“玻片 ID”，在打印到玻片标签上时，其后面还要附加一个三位字符的后缀，以帮助在扫图期间正确地识别玻片。

玻片识别

标签被粘贴到玻片上以后，系统就可以对玻片染色装置各个位置上的玻片进行识别（参阅 5.1.5 在机玻片识别中的[自动玻片识别](#)）。

没有玻片 ID 或者玻片 ID 不可识别的玻片必须被手动识别到系统中（参阅 5.1.5 在机玻片识别中的[在机手动玻片识别](#)），或者重新打印标签贴到玻片上并进行玻片扫图。

在管理客户端的[标签设置](#)屏幕中设置需显示在玻片标签上的信息（参阅 [10.3 标签](#)）。

6.7 玻片设置概要报告

玻片设置概要列出了[玻片设置](#)屏幕上当前设置的所有玻片（来自所有病例）。玻片被根据病例和提供的详细信息（如标记和分配容量）进行分组。报告下方是一个列表，显示报告中的玻片所需的所有试剂和试剂系统，以及各种试剂和试剂系统的检测数。BOND-MAX 和 BOND-III 仪器分别有单独的列表。

此报告对于运行准备很有帮助。它能帮助您确定放入每个玻片架上的玻片是否兼容（参阅 [6.9 玻片兼容性](#)），并显示需要装载的试剂和试剂系统。

如需创建玻片设置报告，点击[玻片设置概要](#)。

报告显示每个玻片的如下信息。

字段	描述
玻片 ID	BOND 系统为每张玻片分配一个唯一标识符
标记	标记
染色程序	染色程序
制备	制备程序（如有）
HIER	热抗原修复（HIER）程序（如有）
酶	酶修复程序（如有）
分配容量	分配的试剂量（参阅 6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置 ）
组织类型	检测组织、阳性对照组织或阴性对照组织

 对于顺次双染玻片，在标记、程序、分配容量和组织类型列中显示两行，按玻片 ID 分组。

参阅 [3.7 报告](#)中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

6.8 即时玻片和病例创建

默认情况下，BOND 系统被设置为在玻片架装入操作仪、玻片被扫图后，即可创建新病例和玻片。

下文中的第一章节提供关于创建“即时”病例和玻片的说明，第二章节描述其他可选工作流程的选项设置。

- 6.8.1 扫图后创建新病例和 / 或玻片
- 6.8.2 在机玻片识别选项

6.8.1 扫图后创建新病例和 / 或玻片

在玻片被装载并扫图后，按以下步骤添加病例和玻片信息（该步骤与 5.1.5 在机玻片识别中的**在机手动玻片识别**中描述的辅助 ID 步骤类似，但这里还涉及新病例和玻片的创建）。

1. 按照通常的方式将玻片放入操作仪。
没有必要在 BOND 软件中创建病例或玻片，或者打印标签 – 可以使用手写标签或第三方标签。
2. 系统将无法识别玻片，因此会显示标签的图像。

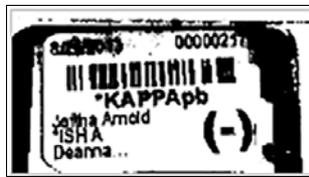


图 75: 未自动识别的玻片

i 如果在某台特定的操作仪上总是无法显示标签图像，可能是该仪器被设置为不捕获玻片标签图像。联系客户支持部门重新设置该操作仪。

3. 如需打开**玻片识别**对话框，可按以下方法之一操作：
 - (i) 双击玻片图像。
 - (ii) 右键单击图像，从子菜单中选择**手动选择**。

将显示玻片识别对话框，且**新病例**和**新玻片**按钮为可用状态（图 76 中的 1 和 2）。



图 76: 显示玻片状态的“玻片识别”对话框。（在有些实验室中，**新病例**按钮被禁用，或者**新病例**与**新玻片**按钮同时被禁用 – 参阅下面的**在机玻片识别选项**）

活动玻片在玻片架中突出显示（第 3 项）。

该对话框中有一个放大的标签图像（第 4 项），用以帮助进行玻片识别。将光标悬停在右窗格的玻片上可以查看进一步放大的标签图像。

左侧窗格列出了所有病例和当前玻片。在默认设置下，只显示玻片标签已被打印的病例（您可以对此进行更改使其也显示玻片标签尚未被打印的病例。参阅 6.8.2 在机玻片识别选项中的**外来玻片标签**）。

中间的窗格显示的是为左边窗格中的选定病例设置的玻片，其中的玻片还未和在操作仪上扫图的玻片相匹配。同样，在默认设置下只显示已打印了标签的玻片。但此设置可以更改，以显示为该病例设置的所有玻片。



确保您选择了正确的标签图像，因为不正确的标签会影响您的玻片。

4. 如需创建新病例，单击**新病例**（第 1 项）。
按照通常的方式为选定的玻片创建新病例（参阅 6.3.3 **添加病例**）。
5. 点击**添加病例**对话框中的**确定**后，在**玻片识别**对话框中的病例列表中选择新病例。
6. 要为刚创建的病例创建新玻片，可单击**新玻片**（第 2 项）。
此步操作将打开**添加玻片**对话框。

7. 按通常的方式在软件中为右窗格中选定的具体玻片创建新玻片 (参阅 [6.5.2 创建玻片](#))。添加后, 新玻片将显示在对话框的中间窗格中 (同时新病例在左侧的病例列表中保持选定状态)。
8. 确保右窗格中仍然选定了正确的标签图像, 然后单击**插入**, 将其与中间窗格中的新玻片匹配。玻片被从中间窗格移除, 右窗格中的标签图像被替换, 以显示为刚创建的新玻片输入的系统信息。如果玻片匹配错误, 可以通过在右窗格中选择该玻片并单击**移除**来取消该步操作。
9. 此时即可按通常的方式对玻片进行操作。
对于玻片架上其余的玻片, 可重复创建新病例和玻片的步骤。

6.8.2 在机玻片识别选项

通过有选择地启用或禁用**玻片识别**对话框中的选项, 管理客户端的设置可以允许或强制采用不同的玻片识别工作流程。

限制或禁止创建即时病例和玻片

默认设置下, BOND 允许装载未在 BOND 软件中创建 (或不是从实验室信息系统 (LIS) 导入) 的玻片, 并允许在玻片已被扫图后, 使用**玻片识别**对话框在软件中创建病例和玻片。您可以选择将系统设置为禁止用此种方式创建新病例 (但仍允许为已有病例创建新玻片), 或完全禁止在装载玻片后创建玻片 (和病例)。根据您的设置, **玻片识别**对话框中的**新病例**按钮将被禁用, 或者**新病例**与**新玻片**按钮同时被禁用 (参阅 [图 76](#))。

在管理客户端的**实验室设置**屏幕中限制即时病例与玻片创建选项 (参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#))。

外来玻片标签

您可以将 BOND 设置为要求 (或不要求) 所有玻片在处理之前都必须由 BOND 打印标签。实验室信息系统 (LIS) 玻片和非实验室信息系统 (LIS) 玻片分别有不同的设置。

非实验室信息系统 (LIS) 玻片的默认设置要求使用 BOND 进行打印。这意味着未带有 BOND 打印标签的实物玻片将不会自动与在软件中为其创建的玻片相匹配 (即便 ID 是相同的)。而且, 您无法使用**玻片识别**对话框手动匹配玻片, 因为该对话框仅显示由 BOND 打印的玻片。因而, 没有 BOND-实验室信息系统 (LIS) 集成设备的使用手写标签或第三方设备打印标签的实验室必须将此选项设置为关闭。这样就可使系统内创建的所有玻片能与装载到操作仪中的玻片相匹配, 无论其标签是否由 BOND 打印。

若要启动处理未使用 BOND 打印标签的玻片, 在管理客户端**实验室**屏幕中取消选中**强制在 BOND 中打印** (见 [10.5.2 病例与玻片设置](#))。 (不必仅为了允许创建即时病例和玻片而取消选中**强制在 BOND 中打印** - 参阅上面的**限制或禁止创建即时病例和玻片**。)



在取消选中**强制在 BOND 中打印**选项之前创建的玻片, 在未打印标签之前不能进行染色处理, 不过, 在取消选中该选项之后创建的玻片将无需打印标签。

实验室信息系统 (LIS) 玻片的默认设置不要求由 BOND 打印, 这意味着由实验室信息系统 (LIS) 打印标签的玻片可以自动与 BOND 软件中的玻片 (从实验室信息系统 (LIS) 导入) 相匹配。或者, 如果无法进行自动匹配 (例如, 若某个玻片标签的字迹模糊), 可以使用**玻片识别**对话框手动匹配玻片。但是, 如果您的工作流程中具有在实验室信息系统 (LIS) 中创建的玻片, 而您希望强制使用 BOND 打印标签, 可开启此选项 (在管理客户端 **LIS** 屏幕中选择**强制 LIS 在 BOND 中打印** - 参阅 [10.2 实验室信息系统 \(LIS\)](#))。

6.9 玻片兼容性

为了使各次运行的步骤同步，从而确保玻片架中的所有玻片都获得最佳染色结果，BOND 软件要在玻片架被载入后检查玻片的兼容性。不兼容玻片被显示在**系统状态**屏幕上。您必须在启动运行之前移除或替换不兼容玻片（参阅 5.1.4 玻片信息中的**调整不兼容玻片的设置**）。

使常规玻片兼容的必需要求：

- 有相同的分配容量；
- 全部为单染，或全部为并行双染，或全部为顺次双染；
- 使用相同的制备程序；
- 使用相同的染色程序；以及
- 使用兼容的预处理程序和 / 或原位杂交（ISH）变性和杂交程序。

程序的兼容性规则在下面的**程序兼容性**中提供。

玻片设置报告（**6.7 玻片设置概要报告**）可帮助您确认在各个玻片架上装载了兼容玻片。

6.9.1 程序兼容性

染色和制备程序具有严格的兼容性规定，而对于加热预处理和酶预处理程序以及 ISH 杂交和变性程序，则可以稍有差别。这些程序的兼容性取决于操作仪类型（BOND-III 或 BOND-MAX）、程序步骤的数量和持续时间，以及步骤操作期间的仪器状况。当这些因素全部相同，或者其不同可以调整而不影响染色质量时，程序就是兼容的。

所有程序类型的兼容性规则列表如下。

染色程序

每张玻片必须使用相同的染色程序。顺次双染运行则必须按相同的顺序使用相同的两个染色程序。

免疫组化（IHC）和原位杂交（ISH）玻片不能混合在单染运行中，但可以合并到顺次双染运行中。

制备程序

对于“脱蜡”和“烤片与脱蜡”程序

1. 同一玻片架中的所有玻片都必须使用相同的程序；并且
2. 有制备程序的玻片不能同没有制备程序的玻片相混合。

预处理程序

仅需热修复、仅需酶修复、需热修复和酶修复、以及无需抗原修复的玻片都可以一起运行。当程序运行于其他玻片时（热修复始终先于酶修复），不接受当前预处理的玻片则被水化。

类似地，所有需要和不需要原位杂交（ISH）变性及杂交的玻片组合都是兼容的。

以下章节给出了预处理程序与具有相同预处理类型的程序的兼容条件。

加热预处理

1. 加热预处理程序被视为兼容的规则是：

- (i) 操作步骤数相同，以及
- (ii) 各步骤的孵育时间相同，不包括加热步骤。

对于同时进行的加热步骤，步骤的最长时间设置将被用于所有玻片。时间设置较短的玻片仅按照其设置时间进行加热，到时间后其玻片加热器即被关闭。

2. 使用抗原修复溶液 1 和 2 的程序可以混合运行。
3. 采用加热预处理的玻片可以和不采用加热预处理的玻片一同运行 – 在其他玻片被处理的同时，不接受预处理的玻片在室温下用抗原修复溶液进行水化。

酶预处理

1. 酶预处理程序被视为兼容的规则是：

- (i) 操作步骤数相同，以及
- (ii) 各步骤有相同的孵育时间。

2. 一次运行可使用两种类型的酶。
3. 采用酶预处理的玻片可以和不采用酶预处理的玻片一同运行 – 在其他玻片被处理的同时，不接受预处理的玻片在室温下进行水化。

原位杂交 (ISH) 变性

变性程序在具有相同的孵育时间时即具兼容性。孵育温度可以不同。

ISH 杂交

杂交程序在具有相同的孵育时间时即具兼容性。孵育温度可以不同。

7

程序（在 BOND 控制器上）

在 BOND 软件中，程序是指为进行组织标本染色而执行的一系列步骤。

BOND 系统中提供了一组预定义的 Leica Biosystems 程序，这些程序不能编辑或删除。预定义程序已经过 Leica Biosystems 的严格测试和验证，若正确使用，可以获得极佳的染色结果。不过，您可以通过复制和编辑已有程序来创建自己的程序。



对于您自己创建或编辑的用户程序，您必须自行负责测试和验证。能够创建和保存程序并不表明该程序适用于拟定的任务。

本章有以下章节：

- [7.1 程序类型](#)
- [7.2 程序设置屏幕](#)
- [7.3 创建新程序](#)
- [7.4 编辑用户程序](#)
- [7.5 程序报告](#)
- [7.6 预定义程序](#)

7.1 程序类型

BOND 中的所有程序都根据其预定要执行的具体功能而分为某种“类型”。例如，预染 HIER 程序是一个类型，而 IHC 顺次双染程序则是另一个类型。

- 程序的类型不能更改。
- 若要创建新程序，您必须复制一个与新程序类型相同的现有程序，然后您可按需要编辑该程序。

通常在任何一次染色运行中，会有多个不同类型的程序同时运行，以制备玻片、应用标记、并应用显色剂。运行中使用的这些程序和顺序通常需要进行修改才能用于双染。

- [7.1.1 染色方法](#)
- [7.1.2 程序序列](#)

7.1.1 染色方法

双染是将两种不同的标记和显色剂应用于单个玻片。BOND 有两种双染方法：顺次双染 – 在不同的染色程序中依次使用两种标记；并行双染 – 在单一的染色程序中将两种标记混合在一起使用。

在程序的创建和编辑中，单染被视为顺次双染的一个特例来处理。

每个染色程序都有一个“染色方法”，来指明其与双染或单染有关的作用。“顺次双染”类型的程序有三个“染色方法”选项：

- 单染 – 单独使用，应用单一标记。
- 第一次 – 用于顺次双染中的第一个程序
- 第二次 – 用于顺次双染中的第二个程序

所有预定义的顺次双染程序都有“单染”染色方法，这一点不能更改。但用户创建的顺次双染程序的染色方法可以更改任意一个或多个选项。例如，可以将某个用户程序设置为有时单独使用，而有时则用作双染的第一个程序。

“并行双染”类型的程序只有一个染色方法选项，即“并行双染”。

i 对于并行双染，如果无法使用或复制某个合适的预定义并行双染程序，可编辑一个单染程序，在其中增加第二种显色剂和所需的其他任何辅助试剂。增加的试剂可装在开放容器中。

下表列出了程序类型和染色方法：

	类型	染色方法	描述
染色	IHC 染色 单染和顺次双染	单染	用于检测单染的单一抗体的程序
		第一次	用于检测顺次双染中的一抗的程序
		第二次	用于检测顺次双染中的二抗的程序
	IHC 染色 并行双染	并行双染	用于检测并行双染中的混合抗体的程序
	ISH 检测 单染和顺次双染	单染	用于检测单染的单一探针的程序
		第一次	用于检测顺次双染中的第一探针的程序
第二次		用于检测顺次双染中的第二探针的程序	
ISH 检测 并行双染	并行双染	用于检测并行双染中的混合探针的程序 (目前没有这一类型的程序)	
预染 (BOND-III 和 BOND-MAX)	制备	不适用	脱蜡，或烤片（用于组织固定）然后使组织脱蜡
	加热预处理	不适用	使用加热方法的抗原修复
	酶预处理	不适用	使用酶方法的抗原修复
	原位杂交（ISH）变性	不适用	DNA ISH 变性程序
	ISH 杂交	不适用	ISH 杂交程序

7.1.2 程序序列

通常，对每张玻片会采用多种不同类型的程序序列，即选择适合于组织、标记和常规实验室程序的制备、抗原修复、变性、杂交和染色程序。可以在创建玻片时（参阅 [6.5.2 创建玻片](#)）单独为每张玻片设置这些序列，但在不需要特殊程序时，BOND 还允许您设置默认程序以加速玻片创建过程：

- 在管理客户端程序中为整个 BOND 系统设置默认制备程序（如*Dewax）（参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#)）；
- 在**试剂设置**屏幕中为每种标记设置其他所有程序类型的默认程序（参阅 [8.2.1 添加或编辑试剂](#)）。

设置合适的默认程序可尽量缩短花费在制备单个玻片上的时间。玻片被创建后，您可以视需要更改单个玻片的程序。

一个序列中的程序的运行次序可由 BOND 自动设置，见下表所示。任何程序均不包括探针分配和移除 – 将自动进行这些步骤。

次序	程序（或探针）	免疫组化（IHC） 或原位杂交（ISH）	注释
1	制备	两种	可选性脱蜡以备化学处理。
2	HIER （热抗原修复）	两种	对大多数玻片需运行热抗原修复（HIER）或热抗原修复（HIER）程序 – 极少数情况下需运行两种，或两种皆不运行。
3	EIER （酶抗原修复）	两种	
4	探针	原位杂交（ISH）	探针应用 – 不包括在任何程序中。
5	变性	原位杂交（ISH）	DNA 探针的变性程序。 DNA 探针应始终使用变性程序。
6	杂交	原位杂交（ISH）	原位杂交（ISH）所需杂交程序。
7	探针	原位杂交（ISH）	探针移除 – 不包括在任何程序中。
8	染色	两种	应用显色剂和相关试剂所需的程序。免疫组化（IHC）一抗在此程序中分配。

程序序列中选择的程序可以预定义或者您可以创建自定义程序并选择它们（参阅 [7.3 创建新程序](#)）。

顺次双染的程序和程序序列

顺次双染实质上是依次运行两个单染程序序列。这些程序可以是两个免疫组化 (IHC) 序列、两个原位杂交 (ISH) 序列、或两者各一以任何次序排列。一般情况 (但并非所有情况) 下, 第一个标记使用 BOND Polymer Refine Detection 系统和 DAB 显色剂, 第二个标记使用 BOND Polymer Refine Red Detection 系统和快红显色剂。

通常, 序列中应用第二标记的某些程序可以被略过, 若包括在内, 则应予以修改。用于第一标记和第二标记的染色程序中的步骤通常也应予以修改 (程序必须进行某些修改以设置恰当的染色方法 – 参阅上述上面的 [染色方法](#))。下文提供了一些关于顺次双染的程序和程序序列的修改建议。在所有情况下, 您都应当自行做测试以检验结果。

- 制备程序仅可在第一标记序列中运行 – BOND 不允许选择用于第二标记的制备程序。
- 通常, 抗原修复仅需在应用第一标记前运行一次。如果还需对第二标记运行修复, 采用较短的持续时间即可。
- 在原位杂交 (ISH) 双染中必须对两个标记应用杂交程序, 但对于第二个标记, 采用比单染所需时间较短的持续时间即可。
- 如果用两种 DNA 探针进行双染, 在应用第一标记前, 变性操作通常只需进行一次。如果需对第二标记进行变性处理, 通常只需较短的持续时间。
- 对于染色程序, 如果从第一个程序的末尾删除苏木精步骤, 从第二个程序的开头删除过氧化物阻断步骤 (如有), 通常可获得最佳染色结果。

7.2 程序设置屏幕

若要设置程序，单击功能栏上的**程序设置**图标。



程序设置						复制	打开	删除	报告
程序名称	程序类型	说明	修改者	修改日期	首选				
*IHC Protocol F	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine IHC protocol	Leica	2013/4/10	✓				
*IHC Protocol G	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer AP Red IHC protocol	Leica	2013/4/10	✓				
*IHC Protocol J	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine Red IHC protocol	Leica	2013/4/10	✓				
*IHC Protocol K	免疫组化 (IHC) 染色	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	2013/4/10	✓				
*IHC Protocol K - 50 Test	免疫组化 (IHC) 染色	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	2013/8/23	✓				
GFAP (ER2, Enzyme1)	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine IHC protocol	paul	2013/8/22	✓				
IHC Protocol EDS	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Define IHC protocol	paul	2013/8/22	✓				
IHC Protocol F DS	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine IHC protocol	jimmy	2013/8/22	✓				
MyIHC Protocol F	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine IHC protocol	supervisor	2017/4/5	✓				
Negative F	免疫组化 (IHC) 染色	Bond Polymer Refine IHC protocol	jimmy	2013/8/22	✓				
*FISH Protocol A	原位杂交 (ISH) 检测	FISH System protocol - 30 Test	Leica	2013/4/10	✓				
*ISH Protocol A	原位杂交 (ISH) 检测	Bond Polymer Refine RNA ISH protocol	Leica	2013/4/10	✓				
*ISH Protocol B	原位杂交 (ISH) 检测	Bond Polymer Refine DNA ISH protocol	Leica	2013/4/10	✓				
FISH Protocol ASDS	原位杂交 (ISH) 检测	FISH System protocol - 30 Test	jimmy	2013/8/22	✓				
ISH Protocol ASDS	原位杂交 (ISH) 检测	Bond Polymer Refine RNA ISH protocol	jimmy	2013/8/22	✓				
ISH Protocol BDS	原位杂交 (ISH) 检测	Bond Polymer Refine DNA ISH protocol	jimmy	2013/8/22	✓				

程序组: 染色 程序类型: 全部 染色状态: 全部 程序来源: 全部 首选状态: 首选

图 77: 程序设置屏幕

在**程序设置**屏幕中有一个表格，其中列出了各个程序和一些基本信息。预定义程序以星号 (*) 作为其名称和缩略名的首字符。

您可以从该表中选择一个程序进行操作，如复制、编辑和生成报告，这些操作可以通过表格上方的按钮或右键菜单实现。

表格下方的筛选器允许您设定要显示的程序类型。您可以在染色和预染程序之间选择，并进一步精选以显示具体的程序类型（参阅 [7.1 程序类型](#)）。另外，您可以对染色方法、程序来源和首选状态进行筛选。

程序列表中的信息说明如下:

标题	描述	选项
程序名称	程序的全称	预定义 (Leica Biosystems) 程序以星号 (*) 开头
程序类型	描述程序的功能	参阅 7.1 程序类型
描述	描述程序的功能和应用	
修改者	标明该程序的创建人或最后修改人	Leica 表示预定义的 Leica Biosystems 程序
修改日期	程序创建日期或最后修改日期	
偏好	显示程序的首选状态	<ul style="list-style-type: none"> 已勾选 – 这是首选程序, 可在添加玻片对话框中选择 未勾选 – 这不是首选程序, 不能在添加玻片对话框中选择

7.2.1 程序详细信息

若要打开列于**程序设置**屏幕中的程序以进行查看或编辑, 可双击该程序 (或将其突出显示, 然后点击**打开**), 软件即显示**编辑程序属性**对话框和该程序的详细信息。

对于预定义的 Leica Biosystems 程序, 只有首选项设置可以编辑, 但对于用户程序, 其他设置也可更改。

编辑程序属性

名称: MyIHC Protocol F

别名: MyIHC

说明: Bond Polymer Refine IHC protocol

染色方法: 单染 第一次 第二次 首选

BOND-MAX BOND-III 导入程序 程序类型: 免疫组化 (IHC) 染色

首选检测系统: Bond Polymer Refine Detection

步骤号	洗涤	试剂	供应商	室温	温度	孵育 (分)
1		*Peroxide Block	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		5:00
5		*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		15:00
9		*Post Primary	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		8:00
13		*Polymer	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		8:00
17		*Mixed DAB Refine	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
18		*Mixed DAB Refine	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		10:00
22		*Hematoxylin	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		5:00

显示洗涤步骤 插入试剂段 | 重置 | 删除试剂段

保存 取消

图 78: 用户程序的**编辑程序属性**对话框

对话框为每个仪器组中已启动的操作仪类型（BOND-III 和 BOND-MAX）显示一个页签（如无已启动的类型，则显示两种页签）。创建新程序时或编辑用户程序时，还会出现一个**导入程序**按钮。参阅 [7.4.4 多种仪器类型和程序版本](#) 获取详细信息。

选择表格下方的**显示洗涤步骤**可查看所有的操作规程步骤（包括洗涤步骤）；取消选中则隐藏洗涤步骤。

编辑程序属性对话框显示以下程序信息。

名称	程序的全名。
缩略名	程序的缩略名，如玻片标签上所使用的。
描述	对程序的简要说明。
染色方法	（见下文）
程序类型	类型可表明程序的功能以及确定允许的步骤和试剂。
首选检测系统	该程序的首选检测系统。 这一项不适用于预染程序。

程序信息下方的表格列出了每个程序步骤及其属性（参阅图 78）。该表格中编辑了用户程序中的可编辑步骤（参阅 [7.4 编辑用户程序](#)）。

以下详细信息被显示在该表格中：

项目	描述
步骤编号	程序步骤的操作顺序。
清洗	检查是否为洗涤步骤。
试剂	该步骤中使用的试剂。
供应商	试剂供应商。不可编辑。
室温	检查该步骤中是否为室温。
温度	除室温外的其他已选玻片温度（仅预染程序）。
孵育（分）	试剂在玻片上停留的最短时间。

染色方法

染色程序包括一个“染色方法”部分。单染和顺次双染程序具有以下选项：

- **单染** – 程序用于单染
- **第一次** – 是顺次双染的第一个程序
- **第二次** – 是顺次双染的第二个程序

并行双染程序只有一个染色方法选项：**并行双染**。

参阅 [7.1.1 染色方法](#) 中对染色方法的进一步说明。

首选状态

在**添加玻片**对话框中仅可选择首选程序，因此，您应将计划要使用的程序设为首选状态，设置方法是选中**首选**选项框 – 取消选中则设置为非首选。

7.3 创建新程序

您可以通过复制已有的用户程序或 Leica Biosystems 程序来创建新程序。复制程序时，其类型保持不变且以后也不能更改。因此，若想创建新的 IHC 程序，您必须复制已有的 IHC 程序；若要创建新的热抗原修复 (HIER) 程序，就复制已有的热抗原修复 (HIER) 程序，以此类推。

要复制一个程序，从**程序设置**屏幕的列表中选择该程序，然后单击**复制**按钮。选定程序的复制版本将出现在**新程序属性**对话框中，用于进行编辑。

新程序需要一个符合 **7.4.3 程序规则** 中指定的规则的唯一的名称和缩略名。除更改程序名称和缩略名外，不需要更改新程序的其他任何部分。不过，您可以按照下文中的**编辑用户程序**所述更改程序的任何内容。

编辑后，点击**保存**。若程序符合规则，您会被要求确认您正在创建一个程序并“自担风险”。此信息旨在提醒您，Leica Biosystems 无法预见用户创建或编辑的程序的染色质量。一旦您确认愿意继续，对程序的更改就将被保存。

7.4 编辑用户程序

您可以使用**编辑程序属性**对话框编辑用户程序 (但不是 Leica Biosystems 程序)。如需编辑某个程序，在**程序设置**屏幕上的列表中选中它，然后点击**打开** (或双击该程序)。此外，也可设置一个新程序，方法是复制一个同类型的已有程序，然后对它进行编辑 (参阅 **7.3 创建新程序**)。

染色程序的试剂步骤可被添加和删除，新试剂和孵育时间可以进行设定。额外的洗涤步骤可被添加或删除。预染程序的步骤数不能更改，但可以更改某些步骤的温度和孵育时间。参阅 **7.4.3 程序规则** 中列出的允许编辑的项目。

因为新试剂的分配必须跟随洗涤步骤，染色程序中新试剂的插入将会自动增加一个程序“试剂段”，它由试剂步骤和后随的三个洗涤步骤组成。

在编辑程序时，包含全部所需信息的被更改步骤或新步骤均带有绿色边框；需要额外信息的新步骤带有红色边框。

在编辑期间，您可以查看所有程序步骤，或使用表格下方的**显示洗涤步骤**选项按钮隐藏洗涤步骤。

- i** 对于大多数程序步骤，孵育时间应设置在 30 分钟以下。超过这一时间可能导致组织干燥。如果需要更长的孵育时间，可将该步骤重复一次或多次，并将需要的时间均分到这几个步骤中。唯一的例外是 ISH 杂交步骤，该步骤必须超过 30 分钟，并且决不可分为时间较短的多个步骤。
- i** 能够创建和保存一个程序并不表明此程序适用于预定任务。您必须自行负责测试和验证自己创建或编辑的任何程序。
 - 7.4.1 编辑程序步骤
 - 7.4.2 添加和删除程序步骤
 - 7.4.3 程序规则
 - 7.4.4 多种仪器类型和程序版本
 - 7.4.5 删除程序

7.4.1 编辑程序步骤

按照以下说明在**新程序属性**对话框中设置新程序，或在**编辑程序属性**对话框中编辑已有程序。参阅 7.4.3 程序规则以确保创建有效程序。

- i** 每次您保存程序时，系统都会保存一个副本。您创建程序报告时，必须选择其中一个副本 (参阅 7.5 程序报告)。为避免产生多个冗余程序副本，可以仅在设置完成时保存程序。
 - 1 输入新程序的程序名称和缩略名。
 - 2 视需要输入程序说明。
 - 3 设置染色程序的染色方法 (参阅 7.1.1 染色方法)。
 - 4 设置程序的**首选**状态 (参阅上述上面的**首选状态**)。
 - 5 对于染色程序，从**首选检测系统**下拉菜单中选择用于该程序的检测系统。
 - 6 添加或删除程序步骤 (参阅 7.4.2 添加和删除程序步骤)，直至达到所需的程序步骤数。
 - 7 如要更改新程序和已有程序的可编辑参数，首先双击您想要更改的参数：
 - (i) 在下拉列表中选择试剂。

注：选择"*标记"以便标出 IHC 程序中使用一抗的步骤。

注意，洗涤步骤仅可使用 *BOND Wash Solution 或 *去离子水。
 - (ii) 设置孵育时间，单位为分钟和秒 (mm:ss)。这是在进行下一步骤前玻片应静置的最短时间。关于孵育时间限制，请参阅 7.4.3 程序规则中的步骤 9。

一般情况下，对于试剂应用步骤，Leica Biosystems 建议孵育时间不要超过 30 分钟。若需要更长时间，可以创建分配同一试剂的重复步骤 (参阅下述下面的**重复试剂步骤**)。
 - (iii) 设置温度 (用于预染程序的某些步骤)。

如果您想设置非室温温度，首先取消勾选**室温**参数。然后选择**空温度**参数，用整数输入摄氏温度。

如果您想更改温度为室温，选择并勾选**室温**参数。

关于允许的温度范围，请参阅 7.4.3 程序规则中的步骤 8。
 - (iv) 单击任意其他步骤以确认已更改参数。

7.4.2 添加和删除程序步骤

您可以在用户免疫组化 (IHC) 和原位杂交 (ISH) 程序中添加和删除步骤,但不能在预染程序中进行。添加或删除步骤时使用程序步骤表下方的按钮。这些按钮对文字内容敏感,其可用性和功能根据选定步骤的不同而变化。

参阅以下章节中的详细说明:

- **试剂段**
- **重复试剂步骤**
- **洗涤步骤**

试剂段

添加新试剂段 (一个试剂步骤和三个必需洗涤步骤):

- 1 选择一个试剂并单击**插入试剂段**。新试剂段将插入到试剂上方。



如果选择了最后一个试剂,您可以选择在该试剂下方插入新试剂段。

新试剂段 (包括试剂和洗涤步骤) 即显示在列表中。洗涤步骤带有绿色边框,表示对保存的程序更改;试剂步骤带有红色边框表示您必须为该步骤选择试剂。

- 2 双击空**试剂**参数并从下拉菜单中选择所需试剂。

根据需要编辑新试剂和洗涤步骤的其他参数。

若要删除某个试剂段,选择该试剂,然后单击**删除试剂段**。如要删除有重复试剂的试剂段,应首先删除重复。

重复试剂步骤

重复步骤指先后使用两个或多个相同的试剂,且中间没有洗涤步骤。

- 1 从步骤列表中选择您要重复的试剂步骤。
- 2 单击**重复**。
- 3 与当前步骤具有相同参数的新步骤将被添加在当前步骤的上方。
新步骤以绿色边框标出,表示对保存的程序的更改。
- 4 如有需要,编辑新步骤的孵育时间。



如果您更改了某个重复步骤的试剂类型,则该序列中的所有其他试剂步骤也会更改 – 重复步骤必须使用相同的试剂。

若要删除重复步骤,选中该步骤后单击**删除重复**。

洗涤步骤

-  添加洗涤步骤会改变玻片上的液流属性，导致染色效果不佳。在诊断应用前，确保对新的或编辑过的程序进行验证。
-  您必须确认在显色步骤前后均设置了去离子水洗涤步骤。
-  如果您没有看到洗涤步骤，选择步骤列表区域下方的**显示洗涤步骤**选项按钮。

插入额外的洗涤步骤：

- 1 从步骤列表中选择现有洗涤步骤（原位杂交（ISH）和IHC程序）。
- 2 单击**插入洗涤**。
对于原位杂交（ISH）和 IHC 程序，新洗涤步骤被添加在当前洗涤序列的末尾。
新步骤将以绿色边框标出，表示对保存的程序的更改。
- 3 根据需要在步骤列表中修改洗涤步骤参数。

要删除某个洗涤步骤时，选中该步骤后点击**删除洗涤**。对于原位杂交（ISH）和 IHC 程序，您仅能删除一个洗涤序列中三个必需步骤后面的洗涤步骤。

7.4.3 程序规则

您创建或编辑的程序必须符合一些基本规则才能保存。请注意，这些规则不保证程序在使用后会产生合格的结果。

- 1 程序名称必须满足以下要求：
 - (i) 是唯一的；
 - (ii) 起始字符不能用空格或星号。
- 2 程序的缩略名必须满足以下要求：
 - (i) 是唯一的；
 - (ii) 起始字符不能用空格或星号；
 - (iii) 至多包含 8 个字符。
- 3 所有 IHC 程序必须包含至少一个标记步骤。
- 4 所有染色程序必须包含至少一种来自 Leica Biosystems 检测系统的试剂。
- 5 试剂步骤之后必须是三个洗涤步骤（至少）或相同的试剂。
- 6 染色程序的最后三个步骤必须是洗涤步骤。
- 7 IHC 染色程序的所有步骤的温度必须是室温。

- 8 对于预染程序，加热步骤的温度必须处于下表的温度范围以内：

程序步骤	温度范围 (°C)
烤片和脱蜡，烤片步骤	35–72
加热预处理	35–100
酶预处理	35–100
变性	70–100
杂交	37–65

- 9 步骤孵育时间必须以分钟和秒 (mm:ss) 为单位进行设置，并且应处于下表所述的范围内。此范围不是强制性的：

程序步骤	孵育时间范围 (分钟)
烤片和脱蜡，烤片步骤	0–60
加热预处理 (室温步骤)	0–15
加热预处理 (加热步骤)	5–60
酶预处理 (步骤 1)	0
酶预处理 (酶处理步骤)	0–15
变性	5–20
杂交	20–950
染色程序，试剂步骤	0–60
染色程序，洗涤步骤	0–55

一般情况下，应避免试剂应用步骤的孵育时间超过 30 分钟。如果需要更长时间，可创建分配同一试剂的重复步骤 (参阅上述上面的[重复试剂步骤](#))。

- 10 每个步骤必须完整地定义试剂、孵育时间和 (如果适用) 温度。
- 11 单染和顺次双染的每个程序可仅有一种混合试剂 (如混合 DAB)，用于最多两个程序步骤。(因此，一个顺次双染程序可以有两种混合试剂 – 每个程序各一种，和最多四个应用步骤 – 每个程序各两个。)
- 并行双染程序可包括两种混合试剂，每种混合试剂在程序中最多可应用两次。
- 12 构成染色程序混合试剂所需的全部成分必须来自程序首选试剂盒。

7.4.4 多种仪器类型和程序版本

在配备了 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪的 BOND 系统中，每个程序可以有分别用于两种仪器类型的版本。“相同”程序的不同版本可解决硬件差异问题，比如 BOND-III 仪器中更快的冷却速度（在 BOND-III 程序版本中，程序的玻片冷却步骤的耗时通常短于 BOND-MAX 版本中对应步骤的耗时）。有些程序版本的差异在软件显示的步骤列表中无法看到，例如，BOND-III 程序版本包括隐藏的大流量液流自控装置说明，而 BOND-MAX 仪器中则没有此信息。

所有 BOND 系统中的预定义程序都有 BOND-III 和 BOND-MAX 两个版本。但是，如果系统中添加了新的仪器类型，您必须为该新仪器类型创建现有的用户定义程序版本，方法是从另一个程序中复制（“导入”）适用的版本，然后对其进行编辑（参阅下文）。

导入程序版本

要为新仪器类型创建一个程序版本，请按以下说明操作。此方法也可用于重写现有的程序版本，但初始设置后通常无此要求。

- 1 在**程序设置**屏幕中选择需创建新版本的用户程序，点击**打开**。

编辑程序属性对话框将打开。

- 2 点击**导入程序**。

导入程序对话框将打开。

- 3 在**操作仪**下拉列表中选择新仪器类型。

对话框中显示的程序列表将更新为仅显示所选仪器类型的程序版本。

- 4 可以选择或取消选择**首选**，以便仅显示首选程序或显示全部程序。

- 5 在列表中选择要复制的程序，点击**导入**。

为方便后续设置，选择与需创建新版本的程序尽可能相似的程序。例如，选择使用相同的试剂系统，以及可能情况下同样多的步骤的程序。

导入程序对话框关闭。此时，导入的程序版本即被输入到新仪器类型的**编辑程序属性**对话框中的页签上。



仅更新了已选仪器类型页签。

- 6 编辑新程序版本，使其性能等同于已有的程序版本（参阅 [7.4.1 编辑程序步骤](#)）。您可来回点击各个操作仪页签而不会丢失数据。

- 7 点击**保存**。



用户应自行负责验证其程序是否能使两种类型的操作仪产生同等的染色效果。

7.4.5 删除程序

若要删除某个用户程序，在**程序设置**屏幕上的列表中选中它，然后点击**删除**。

预定义的 Leica Biosystems 程序（以星号开头）不能被删除，但可以隐藏它们 – 打开程序，取消选择**首选**，然后将**程序设置**屏幕中的**首选状态**筛选器设置为“首选”。

7.5 程序报告

程序报告显示选定程序的步骤详细信息。若要生成报告，可在**程序设置**屏幕上的列表中选择程序，然后点击**报告**。如果系统中同时具有 BOND-MAX 和 BOND-III 仪器，选择所需的程序版本的操作仪类型，然后点击**生成报告**。您还可以选择当前版本，或早先使用的程序版本。设置结束后，点击**生成报告**。

报告将显示在新窗口中。报告的右上角显示下表中的信息：

字段	描述
全称	程序的全称。
ID	程序的唯一标识号。
类型	程序类型 (参阅 7.1 程序类型)。
建立者	所显示版本的创建者的用户名。
创建时间	对于预定义程序，指程序被导入数据库数据更新的日期和时间；对于用户定义的程序，指创建的日期和时间。
科室	在管理客户端的 实验室设置 屏幕中输入的科室名称 (参阅 10.5.1 实验室设置)。
染色状态	程序在双染或单染中适合的作用 (参阅 7.2.1 程序详细信息中的染色方法)。

报告正文显示各步骤的下列信息：

- 试剂和供应商
- 步骤类型 (试剂或洗涤)
- 孵育时间
- 温度
- 分配类型 (描述 Covertile 位置和分配容量 – 您的服务代表可能需要了解这些)。

参阅 [3.7 报告](#) 中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

7.6 预定义程序

以下章节说明随同 BOND 软件提供的预定义程序。

i 如果在下一次软件发布之前进行了更新，列出的操作规程可能会有变化。下表为当前发布的操作规程。

- [7.6.1 染色程序](#)
- [7.6.2 预染程序](#)

7.6.1 染色程序

每个染色程序都需要采用特定的 BOND 检测系统。

关于各检测系统的详细信息，请参阅每种产品随附的文献资料或访问 Leica Biosystems 的网站：
www.LeicaBiosystems.com

您可以用这些程序作为基础构件，并利用程序编辑功能定制自己的程序（参阅 [7.3 创建新程序](#)和 [7.4 编辑用户程序](#)）。

i 下面列出的程序中，有些程序使用的检测系统可能尚未获得您所在地区的法规批准。这些程序不会出现在您拥有的软件中。

免疫组化（IHC）

名称	首选检测系统	检测系统注意事项
*IHC Protocol B	Bond Intense R Detection	生物素 / 链霉亲和素系统，适用于需要广泛选择二抗的研究应用。它可以提供过氧化物阻断、加强 DAB 显色和苏木精复染（包括蓝化）。
*IHC Protocol F	Bond Polymer Refine Detection	用于 BOND 系统的优化的高扩增无生物素检测系统，可清晰显示高强度染色的膜结合抗原。
*IHC Protocol H	Bond™ Oracle™ HER2 IHC System 注： 使用需经法规批准。	由 HER2 一抗和 HER2 阴性对照组成的完整的 HER2 检测系统，配有高灵敏的紧密聚合物检测系统。 此系统包含 HER2 特异染色对照玻片，可以实现完全自动的均匀一致的 HER2 免疫组织化学染色和复染。
*IHC Protocol J	BOND Polymer Refine Red Detection	用于体外检测用途，是高灵敏的紧密聚合物系统，可通过碱性磷酸酶和苏木精复染（包括蓝化）提供亮红色免疫染色。
*IHC Protocol K	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (检测 100 次)	用于体外检测用途，可检测组织结合鼠和兔 IgG 一抗。 专用于在 BOND 系统中对福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片进行染色。
*IHC Protocol K - 检测 50 次	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (检测 50 次)	用于体外检测用途，可检测组织结合鼠和兔 IgG 一抗。 专用于在 BOND 系统中对福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片进行染色。

ISH

名称	首选检测系统	检测系统注意事项
*FISH Protocol A	Leica HER2 FISH System – 检测 30 次 注： 使用需经法规批准。	由 RTU LSI HER2/CEP17 双探针和杂交后洗涤溶液 2 组成的完整的双探针 LSI HER2/CEP17 FISH 系统，可利用原位荧光杂交（FISH）检测 FFPE 人类乳腺癌组织标本中的 HER2 基因扩增。适用于体外诊断。 注：LSI 和 CEP 是 Abbott Molecular Inc. 的商标。版权所有。经许可使用。
*ISH Protocol A	BOND Polymer Refine Detection	一种经优化后供 BOND 系统使用的高扩增、不含生物素的检测系统，利用抗 FITC（异硫氰酸荧光素）连接肽检测 RNA。
*ISH Protocol B	BOND Polymer Refine Detection	一种经优化后供 BOND 系统使用的高扩增、不含生物素的检测系统，利用抗生物素连接肽检测 DNA。

7.6.2 预染程序

程序类型	程序名称	注释
制备	*Dewax	制备程序使用 BOND Dewax Solution 去除用来包埋组织的石蜡并使标本再水化。
	*Bake and Dewax	脱蜡之前，组织经过烘烤以提高其在玻片上的粘附力。具体信息请参阅 14.2.3 脱蜡和烤片
加热预处理	*HIER with ER1 or ER2	热抗原修复使组织切片暴露于加热的缓冲溶液，有助于改变组织结构并强化染色。有多种预定义的加热预处理程序，其采用的时间长度和温度各不相同。
酶预处理	*Enzyme 1 *Enzyme 2 *Enzyme 3 *Enzyme 5	具有八种可用的酶预处理程序。 这些程序使用的酶和孵育次数不同。
ISH 变性	*Denaturation (10 min)	有一个（10 分钟）预定义原位杂交（ISH）变性程序。
原位杂交（ISH）杂交	*ISH Hybridization (2Hr) *ISH Hybridization (12Hr)	有两种预定义 ISH 杂交程序（2 小时和 12 小时）。

8

试剂管理（在 BOND 控制器上）

BOND 系统会记录系统中使用的全部非大容量试剂，跟踪记录每个试剂容器及其内容物。另外，该系统还允许您设置有指定标记的玻片模板，以加快病例的创建过程。

本章有以下章节：

- [8.1 试剂管理概述](#)
- [8.2 试剂设置屏幕](#)
- [8.3 试剂清单屏幕](#)
- [8.4 试剂模板屏幕](#)

8.1 试剂管理概述

BOND 中的试剂管理包括单个试剂详细信息的设置和维护、所有试剂包（不包括大容量试剂）的清单管理，以及在创建玻片时使用的被称为“模板”的标记组的创建。

若要打开试剂管理屏幕进行上述操作，可点击功能栏上的**试剂设置**图标。



点击屏幕左上角的页签可打开相应的屏幕（**设置**、**清单**或**模板**）。

试剂设置					
设置		清单	模板		
名称	缩略名	类型	供应商	首选	
*CD10 (56C6)	*CD10	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD15 (Carb-1)	*CD15	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD20 (MJ1)	*CD20	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD25 (4C9)	*CD25	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD30 (1G12)	*CD30	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD5 (4C7)	*CD5	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD56 (CD564)	*CD56	一抗	Leica Microsystems	✓	
*CD7 (LP15) *NEW*	*CD7	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Cytokeratin 20 (Ks20.8)	*CK20	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Cytokeratin 20 (PW31)	*CK20	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Cytokeratin 7 (RN7)	*CK7	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Estrogen Receptor (6F11)	*ER	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5)	*GFAP	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Immunoglobulin A (N1CLA)	*IgA	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Immunoglobulin D (DRN1C)	*IgD	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Immunoglobulin G (Polyclonal)	*IgG	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Melan A (A103)	*MelA	一抗	Leica Microsystems	✓	
*Negative	*Neg	一抗	Laboratory Specified	✓	

试剂包类型：所有试剂 试剂类型：一抗 供应商：Leica Microsystems 首选状态：首选

图 79：试剂设置屏幕

试剂设置屏幕能够显示 BOND 系统已知的所有试剂的完整列表。该列表不包括预先包装的试剂系统（例如 BOND 检测系统），但会显示构成试剂系统的各个试剂。表中还列有混合试剂，即在操作仪中用检测系统中的成分混合而成的试剂。此屏幕用于查看试剂属性，在系统中创建新试剂，以及设置试剂选项。

相比之下，**试剂清单**屏幕显示的是试剂系统清单以及单独包装的试剂。对于任何类型的试剂或系统，列表都将显示全部库存以及可用的单个试剂的信息。

试剂模板屏幕可以创建通常一起用于特定诊断的标记组。当在 BOND 软件中创建玻片时，选择一个模板即可为模板中的每个标记都创建一个玻片，大大加快了此过程的速度。

- [8.1.1 基本信息](#)
- [8.1.2 诊疗系统](#)

8.1.1 基本信息

- [试剂种类](#)
- [试剂工作流程](#)
- [试剂识别](#)
- [替代试剂](#)

试剂种类

除了大容量试剂以外，BOND 系统还使用四个不同种类的“试剂包类型”试剂：

- BOND 检测系统：预包装的检测试剂盘，与用户在玻片设置期间选择的标记共同使用
- Leica 诊疗系统：预包装的标记试剂盘以及辅助试剂和检测试剂，用于帮助评估患者，以考虑给予某种药物。此系统可包括对照玻片（参阅 [14.1.2 诊疗系统](#)）
- BOND 清洗系统：预包装的清洁溶液盘，用于仪器的清洁（参阅 [12.6.1 清洁抽吸探针](#)）
- 试剂容器：盛有标记（一抗或探针）或辅助试剂的单个试剂容器，有即用型容器和开放容器两种（参阅 [2.6.3 试剂系统和容器](#)）

BOND 检测系统、清洗系统和诊疗系统被统称为“试剂系统”。

“标记”指免疫组化（IHC）中的一抗，或者原位杂交（ISH）中的探针。

试剂被细分为以下“试剂类型”：

- 一抗：免疫组化（IHC）中使用的标记试剂
- 探针：原位杂交（ISH）中使用的标记试剂
- 辅助试剂：所有非标记试剂，用于在使用标记染色之前或之后处理组织
- 混合试剂：在程序运行期间利用试剂系统中的成分或单个容器中的成分创建的辅助试剂。混合试剂不会有库存，但系统中必须有它们参与程序步骤。

可根据这些分类对[试剂设置](#)和[试剂清单](#)屏幕上的试剂和试剂系统列表进行筛选。

试剂工作流程

在 BOND 使用试剂之前必须先识别它，识别过程分三步：

1. 试剂类型必须包含在[试剂设置](#)屏幕上的试剂列表中 – 所有的 Leica Biosystems 即用型试剂和许多 Leica Biosystems 辅助试剂（包括 BOND 检测系统、诊疗系统和清洗系统中的试剂）都是预定义的，但其他试剂则必须由用户添加至列表中。
2. 在收到新一批货物时，各试剂容器和试剂系统需扫描至 BOND 中，或称为“登记”，以将它们添加至清单中。
3. 在准备使用某个试剂或系统时，将其装载到试剂架中，由 BOND 对其进行识别，并在试剂被使用时更新清单。

BOND 记录每个容器和系统中的试剂含量以及每种试剂类型的总量。对于 Leica Biosystems 试剂，您可以设置一个续订购限值，以便在库存量过低时发出警告。参阅 [8.3.2 试剂或试剂系统详细信息](#)中的[更改最低库存设置](#)。

试剂识别

各试剂容器有两个可供识别的条形码。容器正面的较长条形码用于登记容器，并用于在登记后对容器进行识别（参阅 [8.3.3 登记试剂和试剂系统](#)）；容器顶部（容器盖下面）的较短条形码则将 BOND 使用的唯一包装标识符（UPI）编码后用于识别装载到操作仪中的试剂容器。对于装载后未能成功扫描的试剂容器，可使用唯一包装标识符（UPI）进行手动识别（参阅 [5.1.3 试剂状态中的修复未检测到的试剂](#)）。

试剂系统通过试剂架两侧的两个条形码识别。应使用两个条形码登记试剂系统和在登记后对其进行识别。试剂系统中的各容器的顶部和正面有唯一包装标识符（UPI）条形码，BOND 使用它们来识别装载到操作仪中的试剂系统。如果自动识别失败，您必须输入这两个条形码，以便手动识别试剂容器。

您可以随时显示已登记的任何试剂或试剂系统的信息，方法是再次扫描各容器侧面的较长条形码，或试剂系统两侧的两个条形码。

如果试剂包无法扫描，点击功能栏上的 **搜索** 图标或者 **试剂清单** 屏幕中的 **输入 ID** 按钮打开 **手动 ID 输入** 对话框。



键入试剂包 ID 或多个 ID，然后点击 **验证**（对于试剂系统，输入每个条形码后点击 **验证**）。这将在 **试剂清单详细信息** 或 **试剂系统清单详细信息** 对话框中打开该容器或试剂系统。

替代试剂

在染色处理开始以前，操作仪中必须已装入足量的全部所需试剂，但偶尔会有某个本来存在的试剂在需要时却不可用的情况，这可能是由于操作人员取出了某个试剂架，或者某个试剂容器中的实际试剂量少于原先测得的容量。如果发生此种情况，BOND 将尝试用另一容器中的同类型试剂替代缺少的试剂。在替代某个不可用试剂时，BOND 系统采用以下规则：

- 系统首先尝试用来自同一试剂系统的同类型试剂替代缺少的试剂。
如果成功，运行将继续并且不发出通知。
- 然后系统会尝试使用其他来源的同类型且同批号的试剂替代缺少的试剂。
如果成功，运行将继续并且不发出通知。
- 接下来系统会尝试使用其他来源的同类型但不同批号的试剂替代缺少的试剂。
如果成功，运行将继续，但受影响的玻片会有事件通知。
- 如果试剂替代不可行，将用一种大容量试剂代替缺少的试剂，以用于受影响玻片的各次试剂分配，直至运行结束。
运行将继续，但受影响的玻片会有事件通知。
- 如果所有玻片都受到影响并且需要用大容量试剂进行替代，此次运行将被放弃。

8.1.2 诊疗系统

用于 Bond 的 Leica 诊疗产品由试剂系统组成，并可包括对照玻片，还需要标准大容量试剂，某些系统中还需要辅助试剂。

应始终遵循诊疗系统随附的说明进行操作，并注意以下几点：

- 随同 Leica Bond™ Oracle™ HER2 IHC 系统一起提供的对照玻片称为“Oracle 对照玻片”，它不同于 Oracle 运行所使用的机构内自备的对照玻片：
 - 自备对照玻片在软件中创建时使用的是**添加玻片**对话框中的**标准组织类型**和**标记**设置，而不是 **Oracle 对照**选项。
 - Oracle 对照玻片必须使用 **Oracle 对照**选项以及适当的**组织类型**选项来创建。
- Oracle 对照玻片只能和它们所属的特定系统一起使用。
- Oracle 玻片标签需使用在管理客户端的**标签**屏幕上定义的专用 Oracle 标签模板(参阅 [10.3 标签](#))。

8.2 试剂设置屏幕

试剂设置屏幕显示 BOND 软件已知的所有试剂的列表，包括试剂系统中的试剂和在操作仪中用试剂系统中的成分混合的试剂。所有 BOND 即用型一抗都预定义在列表中（且不可删除），且 BOND 即用型 ISH 探针以及一些常用的 Leica Biosystems 辅助试剂也是如此。

表格下方的筛选器用于设定需显示的试剂类型。您无法筛选试剂包类型，但可以筛选试剂类型（一抗、探针、辅助试剂、混合试剂、Oracle 试剂以及并行双染一抗与探针），并可筛选供应商和首选状态。

表格上方的按钮允许您进行如下操作：向列表中添加新试剂；打开在表中选择的试剂，以查看或编辑其详细信息；或删除在表中选定的试剂（只能删除非 Leica Biosystems 试剂）。

 您无法登记此表中未列出的试剂或没有设为首选状态的用户定义试剂。

表格中包含各试剂的如下详细信息：

名称	试剂全称。 首字符 “*” 表示预定义的 Leica Biosystems 试剂。
缩略名	试剂的简短名称，用于玻片标签和状态屏幕。
类型	试剂的类型，如一抗。
供应商	试剂供应商的名称。
偏好	被勾选的（首选）标记包含在 BOND 软件其他位置的玻片设置列表中。

可编辑的试剂属性

除名称和供应商详细信息以外，试剂的可编辑选项还有：

1. 对于标记

- (i) 在玻片创建期间选择标记时默认选择的程序 (参阅 [6.5.2 创建玻片](#))。可为单染的标记应用和双染中第一次和第二次标记应用设置不同的程序；
- (ii) 首选状态 – 只有首选标记才能在玻片创建期间显示在**标记**下拉列表中 (参阅 [6.5.2 创建玻片](#))，在模板创建期间则显示在**试剂模板属性**对话框中的**可用标记**列表中 (参阅 [8.4.1 创建模板](#))。试剂屏幕列表也可用这一属性进行筛选；
- (iii) 有害状态 – 标示为“有害”的标记被冲洗掉成为有害废液。预定义试剂的这一设置不能更改。

2. 对于辅助试剂

- (i) 与试剂配伍的大容量试剂 – BOND 系统可自动防止非配伍的辅助试剂同大容量试剂接触；
- (ii) 首选状态 – 可用此属性筛选试剂屏幕列表；
- (iii) 有害状态 – 标示为“有害”的试剂被冲洗掉成为有害废液。预定义试剂的这一设置不能更改。

参阅以下章节：

- [8.2.1 添加或编辑试剂](#)
- [8.2.2 删除试剂](#)

8.2.1 添加或编辑试剂

要在列表中添加试剂，点击**试剂设置**屏幕中的**添加**。BOND 即显示**添加试剂**对话框。参阅下方图 80。

图 80: 添加试剂对话框

欲更改某个已有试剂的详细信息，选中该试剂，然后单击**打开**，或双击该试剂。**编辑试剂属性**对话框即打开，它和**添加试剂**对话框相同，并且选定试剂的详细信息已被输入。

按照以下说明添加或编辑试剂：

1. 如要添加新试剂，在**名称**字段中输入描述性的名称。
新试剂名称不能用"*"开头，此符号专用于 Leica Biosystems 试剂。
1. **i** 小心不要使用能导致创建操作规程或玻片时出现该试剂与另一试剂相混淆的名称。
2. 在**缩略名**字段中输入新试剂的简短名称。缩略名长度限为八个字符。
此名称将显示在**状态**屏幕中的玻片图标上，并被打印在玻片标签上。
3. 如果 BOND 连接了实验室信息系统 (LIS)，则在**通用名**字段中输入实验室信息系统 (LIS) 中使用的试剂名称 (对辅助试剂不适用)。
4. 若要创建新试剂，在**类型**下拉列表中选择试剂类型，对话框就会根据您的选择而变化。
5. 在**供应商**栏中输入试剂**供应商**的名称。

6. 如果试剂是一种标记 (如一抗, 或者 RNA 或 DNA 探针), 选择使用该标记的不同类型染色运行中需使用的默认程序。

在**单/双染**字段中选择**单染/顺次双染**以在**单染**页签中设置单染运行中所用标记的默认程序。对于顺次双染运行中的标记, 在**第一次**和**第二次**页签中设置第一次和第二次应用的默认程序。

选择**并行双染**以设置并行双染运行中标记的默认程序。



如果试剂是 RNA 或 DNA 探针, 上述所有页签中会显示其他程序 (变性和杂交)。

对于预定义 BOND 标记, 如果您想按照针对该标记的建议返回其出厂默认程序, 按**恢复出厂默认程序**按钮 (您需要以主管用户角色登录才能恢复出厂默认设置)。

7. 仅在试剂为用户创建的辅助试剂的情况下, 检查大容量溶液的配伍性, 必要时进行调整。

大多数系统都在**配伍大用量溶液**列表中默认显示 BOND Wash Solution (*Bwash) 和去离子水 (*DI)。这表示这两种溶液的任一种将在液流系统中被使用以抽吸试剂。尽管大用量溶液不应与辅助试剂直接接触, 但它们在抽吸探针中仍可能有微量接触。为完全避免此种可能性, 选择您不想让其同试剂接触的大用量溶液, 点击 << 将其移至**可用的大用量溶液**列表中。

必须至少有一种大用量溶液被设置为配伍溶液。



如果允许不配伍溶液相互接触, 则会产生不良染色结果并有可能损坏操作仪。请联系 Leica Biosystems 以确定溶液是否配伍。

8. 对于标记, 点击**首选**以便在玻片设置对话框中显示一抗或探针。

对于辅助试剂, 首选状态仅由**试剂设置**和**清单**屏幕上的列表筛选器使用。

9. 如果您想将试剂冲洗到有害废液容器中, 点击**有害**。

10. 单击**保存**将试剂详细信息添加至 BOND 系统中。

可在操作过程中随时单击**取消退出**而不做任何更改。

8.2.2 删除试剂

若要删除某个试剂, 在**试剂设置**屏幕上的列表中选中它, 然后点击**删除**。预定义的 Leica Biosystems 试剂 (以星号开头) 不可被删除。



当删除某个试剂的详细信息时, 该试剂的试剂包清单详细信息也会被删除。已删除的试剂详细信息或清单详细信息无法恢复。

如果您不再需要以前曾使用过的某个试剂, 最好将其标为非首选, 而不要删除它。这可以将它从软件的大多数屏幕上清除, 而又能在系统中保留它。

8.3 试剂清单屏幕

试剂清单屏幕列出了在 BOND 系统中登记的所有试剂和试剂系统，以及它们当前的库存量。使用该屏幕可查看和管理清单。

试剂设置

设置 清单 模板

详细信息 输入 ID 详细信息报告 试剂使用情况

名称	供应商	类型	目录号	容量 (mL)	最低 (mL)
*Kappa Probe	Leica Microsystems	RNA 探针	PB0645	27.50	11.00
*CD15 (Carb-1)	Leica Microsystems	一抗	PA0039	44.85	7.00
GFAP (ER2, Enzyme1)	AAA Antibodies	一抗	开放容器	0.00	0.00
*Anti-Fluorescein Antibody	Leica Microsystems	辅助试剂	AR0222	30.00	15.00
*CD30 (1G12)	Leica Microsystems	一抗	PA0153	0.00	1.00
*Melan A (A103)	Leica Microsystems	一抗	PA0233	7.00	0.00
*CD7 (LP15) *NEW*	Leica Microsystems	一抗	PA0017	0.00	14.00
*Lambda Probe	Leica Microsystems	RNA 探针	PB0669	16.50	5.50
*Estrogen Receptor (6F11)	Leica Microsystems	一抗	PA0151	14.00	7.00
*CD5 (4C7)	Leica Microsystems	一抗	PA0168	6.55	0.00
*Cytokeratin 20 (PW31)	Leica Microsystems	一抗	PA0918	0.00	7.00
*Estrogen Receptor (6F11)	Leica Microsystems	一抗	PA0009	0.00	10.00
*Immunoglobulin D...	Leica Microsystems	一抗	PA0061	7.00	2.00
*Glial Fibrillary Acidic...	Leica Microsystems	一抗	PA0026	0.00	5.00
*CD25 (4C9)	Leica Microsystems	一抗	PA0305	47.50	14.00
*CD10 (56C6)	Leica Microsystems	一抗	PA0131	0.00	0.00
*Immunoglobulin G...	Leica Microsystems	一抗	PA0904	7.00	3.00
*CD20 (MJ1)	Leica Microsystems	一抗	PA0906	47.65	14.00

试剂包类型: 试剂类型: 清单状态: 供应商: 首选状态:

试剂容器: 全部 全部 全部 全部 首选

图 81: 试剂清单屏幕

存量少于最低库存的 Leica Biosystems 试剂在屏幕上以红色突出显示。

此表下方的筛选器用于设置需显示的试剂或试剂系统的类型。

对于 BOND 检测系统、Oracle 系统和清洗系统 (在 **试剂包类型** 筛选器中选择)，只需用 **清单状态** 来筛选，即：查看所有已登记的有库存的系统，或存量低于再订购标准的系统。

对于单个试剂容器，还可通过 **供应商**、**首选状态** 和 **试剂类型** 进行筛选 (即：查看“一抗”、“探针”、“并行双染一抗”、“并行双染探针”、“辅助试剂”或“全部”试剂)。

根据试剂类型，可能显示以下部分或全部详细信息。

名称	试剂全称。
供应商	试剂供应商的名称。对试剂系统不显示。
类型	试剂类型，如一抗。对试剂系统不显示。
目录编号	再订购时需引用的试剂目录编号。试剂系统不显示这一项（该列存在于表中，但所有的数值为空）。
容量 (mL)	可用的试剂总量，包括当前已装入或未装入操作仪的所有已登记的试剂包（参阅下面的 测定试剂量 ）。
剩余运行	用于 Oracle 系统，指系统中剩余的运行次数。
剩余清洗	指清洗系统中的剩余清洗次数。
最低 (mL)	仅用于 Leica Biosystems 试剂，指在提示您续订购时的库存容量（参阅 8.3.2 试剂或试剂系统详细信息中的 更改最低库存设置 ）。
最低（运行）	用于 Oracle 系统，是指当提示您续订购时的剩余运行次数（参阅 8.3.2 试剂或试剂系统详细信息中的 更改最低库存设置 ）。
最低（清洗）	用于清洗系统，指提示您再次订购时的剩余清洗次数（参阅 8.3.2 试剂或试剂系统详细信息中的 更改最低库存设置 ）。

试剂表上方的控制按钮允许您管理试剂清单。

- 点击[详细信息](#)可查看选定试剂类型的单个试剂包信息，并为它们设置选项。
更多信息请参阅 [8.3.2 试剂或试剂系统详细信息](#)。
- 当使用手持式扫描仪不能自动识别 ID 时，在[手动 ID 输入](#)对话框中单击[输入 ID](#)，将试剂清单添加至系统中。
更多信息请参阅 [8.3.3 登记试剂和试剂系统](#)。
- 点击[详细信息报告](#)可生成当前表格中列出的试剂或试剂系统报告。
参阅 [8.3.4 清单详细信息报告](#)。
- 单击[试剂使用](#)生成指定时间段内的试剂使用报告。
参阅 [8.3.5 试剂使用报告](#)

另参阅 [8.3.1 测定试剂量](#)中关于 BOND 如何跟踪记录试剂清单的概括说明。

8.3.1 测定试剂量

BOND 系统使用两种方法确定试剂架上的容器中的试剂量：一是根据初始容量和随后的用量计算试剂量，另外一种是使用液位感应 (LLS) 系统直接测量。

试剂量计算是以试剂的初始容量减去被分配的量，加上重新灌装的量 (开放容器)。如果试剂通过蒸发或洒漏而损耗，则计算会有偏差。

液位感应系统被整合到抽吸探针中。当抽吸探针浸入容器中时，液位感应系统能通过检测试剂的高度来测定试剂量。在默认设置下，液位感应容量测量 (通常称为“浸入测试”) 将根据一系列条件自动进行。这些条件包括 (例如)：容器已超过 30 天未测量；试剂可能会有蒸发；容器被另一系统使用过；等等。这些默认浸入测试的进程被安排在不会延迟染色操作的时候执行，这样就有可能发现某个起初被认为可用、后来却可能显示为试剂量不足以供预定运行使用的试剂。当发生此种情况时，警报将被激活，操作者必须重新灌装容器 (仅开放容器) 或确认有合适的替代试剂可用 (参阅 8.1.1 基本信息中的 **替代试剂**)。

或者，您可以将 BOND 设置为每次染色运行前对容器进行浸入测试。可以单独对开放容器、即用型容器和试剂系统进行此种设置。此设置能确保已启动的运行有足够的试剂使用直至运行结束，但在执行浸入测试时会使操作延迟。这些选项的设置和管理客户端的 **实验室设置** 窗格中进行 (参阅 10.5.1 **实验室设置**)。

报告检测系统容量

为了使报告的 BOND 检测系统的容器能够同报告的单个容器的容量相比较 (以便估计检测系统可以处理的玻片数量)，系统容量是以单个容器的毫升数报告的。但是，由于检测系统是由容量不同的容器组成的，必须采用一个报告容量的规则，本节即对此进行说明。

注意，此规则不适用于 Oracle 系统或清洗系统，因为它们分别报告剩余运行次数或剩余清洗次数。

对于检测系统，容量是相对于系统中最大的单个容器而报告的。例如，如果最大的容器容量为 30 mL，系统容量就相对于 30 mL 来报告。BOND 软件会假设新系统中的所有容器都已满，因此，一个最大容器为 30 mL 的系统在首次被登记时就被报告为有 30 mL 容量。

当试剂被使用时，所报告的数值是相对容量最低的容器中的容量。如果这个容器的容量与系统中最大容器的容量不相同，该数值就被规格化为最大容器的容量。例如，在一个有数个 30 mL 容器和两个 2.4 mL 容器的系统中，其中一个 2.4 mL 容器相对于初始容量可能含有最少的试剂量。如果其中剩有 1.2 mL (其初始容量的一半)，那么整个系统的容量就被报告为 30 mL 的一半，即 15 mL。

8.3.2 试剂或试剂系统详细信息

如需显示单个试剂包或试剂系统的详细信息，双击试剂清单表中的试剂类型，或者选中试剂包或试剂系统后点击**详细信息**。



图 82: 试剂清单详细信息对话框

清单详细信息对话框显示选定的试剂或试剂系统的各自单个包装。对话框中的字段和选项根据试剂包类型和供应商不同而有变化。默认设置仅显示含有可用的、未过期试剂的试剂包。您也可以显示（还没到使用期限的）空试剂包，或显示上个月过期的所有试剂包，方法是在对话框中相应地选择**可用**、**空**或**已过期**。

所有试剂包类型的**试剂包名称**都会被显示。此外，BOND 试剂会显示**目录编号**以供续订购时使用，且 BOND 试剂（不是试剂系统）还显示有**试剂包名称**，其中包括试剂包规格。

BOND 试剂和系统还有一个**最低库存**字段，可显示库存标准，达到这一标准时，将提示您再次订购试剂（参阅下面的**更改最低库存设置**）。

您可以使用手持式扫描仪扫描已登记试剂容器或试剂系统侧面的条形码，以打开其清单详细信息对话框。被扫描的清单项目将在详细信息表格中突出显示，而**显示筛选器**（可用、空或已过期）将相应地自动设定。

对话框中的表格显示试剂包的如下信息：

UPI	唯一包装标识符 (参阅 8.1.1 基本信息中的 试剂识别)。
批号	试剂包的批号。
有效期	试剂包的有效日期。此日期过后不应再使用该试剂包。
已注册	试剂包首次在 BOND 中登记的日期。
首次使用	试剂包首次在 BOND 中使用的日期。
标记为空	试剂包被标记为空的日期。可以由软件自动设置，或手动设置 (参阅下面的 将试剂包标记为空或非空)。
初始容量 (mL)	新的、已装满的试剂包中的试剂容量。 试剂系统无此显示。
容量 (mL)	容器中的当前试剂容量。至于检测系统，请参阅上面的 报告检测系统容量 。
重新灌装 (mL)	对于开放容器，可用于重新灌注容器的剩余试剂量。
剩余清洗	对于清洗系统，用剩余试剂可进行的清洗次数。
剩余运行	对于 Oracle 系统，用剩余试剂可以执行的运行次数。

清单详细信息对话框中的按钮可用于设置一系列清单详细信息 (适合于试剂包类型) 和创建指定试剂或系统的详细信息报告。以下章节描述了设置和报告选项。

更改最低库存设置

预定义的 Leica Biosystems 试剂和试剂系统可进行“最低库存”设置。当试剂总库存量低于设定的试剂量时，试剂即在**试剂清单**屏幕中以红色突出显示，提醒用户续订购该试剂或系统。

如需更改最低储存设定值，可点击**设置最低库存量**。在弹出对话框中，在**最低存储**字段中输入所需的最低储存量，根据试剂包类型使用毫升、运行数或清洁数，点击**确定**。

试剂报告

单击**详细信息报告**为刚才选定的试剂或试剂系统生成报告。更多详细信息请参阅 **8.3.4 清单详细信息报告**。

将试剂包标记为空或非空

您可将某个试剂包标记为空，例如，在其完全用完之前被丢弃时。要进行此操作，可在表格中选择试剂包，然后点击**标记为空**，软件即在**标记为空**字段中输入当前日期。

若要将一个标记为空的试剂包恢复原状态，在表中选中它，然后点击**标记为非空**。这一操作只有在该试剂包未被放入操作仪时才能实现。试剂包将显示其被标记为空之前所含有的试剂量。

选择表上方的**空**单选按钮可显示被标记为空的项目。

重新灌装开放试剂容器

您可以重复使用 BOND 开放试剂容器分配至多 40 mL 的特定试剂。如果灌装量低于容器的容积，容器重新灌装的次数就不受限制。

按以下说明重新灌装开放容器：

1. 用所需容量的试剂灌装容器。
2. 扫描容器（如下面的**登记试剂和试剂系统**所述），然后单击**重新灌装**。
如果向容器中添加更多试剂将超过 40 mL 的限值，重新灌装按钮将不可用。
3. 设置新试剂的有效日期。

-  **注意：**在灌装开放容器时（无论首次还是再次灌装），软件会假定容器被灌装至可用的最大容量，即用户在首次登记试剂时标明的容量（mL）或当前容量加上允许重新灌装容量的余量。在进行浸入测试时，如果有必要，所报告的容量会被更正。这只在容器被使用后才会发生。
-  每个开放容器在首次登记时都被指定了某一试剂。开放容器在每次重新灌装时必须使用相同的试剂。

8.3.3 登记试剂和试剂系统

登记试剂包可将其添加至清单中。在登记试剂包之前，试剂必须被列在**试剂设置**屏幕上。

-  试剂包在 BOND 中使用之前必须先登记。
如果把未登记的试剂容器装入操作仪，软件将无法识别它，并且将在**系统状态**屏幕中该试剂的位置上显示一个信息图标 。
-  BOND 会跟踪试剂使用情况，并在必须更换试剂时发出警告。
不要尝试重新灌装即用型 BOND 试剂容器，因为 BOND 会识别出这是使用过的容器并拒绝使用它。

如果 BOND 无法识别您通过扫描登记的新试剂包，有可能是因为您没有安装最新版本的 BOND 数据定义（BOND Data Definitions, BDD）文件。您可在网站上查找最新的 BDD 文件，如果其“数据版本”高于**关于 BOND**对话框中显示的版本，即可下载并安装（通过管理客户端的**BDD 更新**屏幕进行）。新版本 BDD 文件安装完毕后，重启临床客户端程序，然后重新尝试登记新试剂容器或试剂系统。

登记不同类型试剂包的方法在以下章节中说明：

- [登记试剂系统](#)
- [登记 BOND 即用型试剂](#)
- [登记非即用型试剂](#)
- [手动 ID 输入](#)

登记试剂系统

若要登记 BOND 检测系统、诊疗系统或清洗系统，扫描试剂架侧面的两个条形码即可。

- 有些试剂系统的试剂架上只有一个条形码，例如只有一个或两个容器的试剂系统。软件将显示**添加试剂系统**对话框。



警告 激光危险。 可能会对眼睛造成严重伤害。避免眼睛直视激光束。

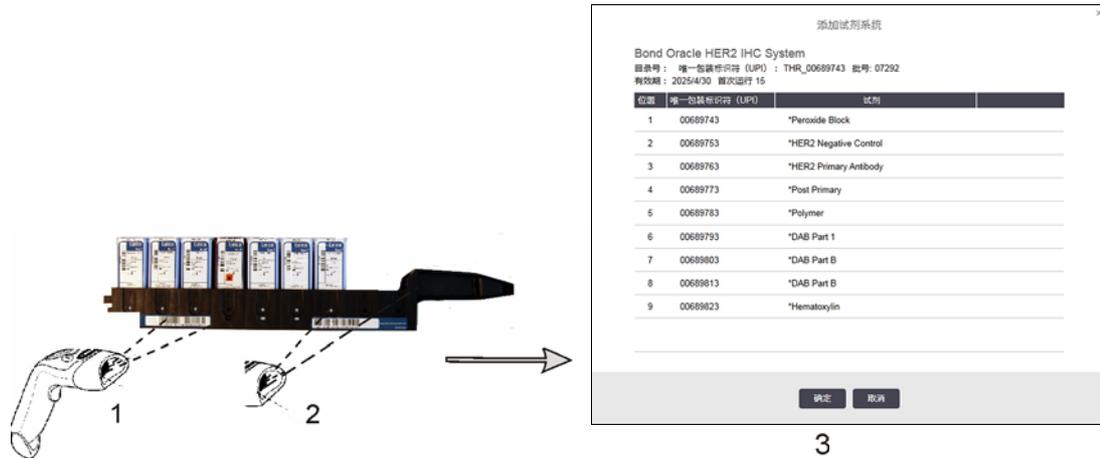


图 83: 登记 BOND 检测系统

确认对话框中的信息与试剂包的信息相同，然后单击**确定**。

- 不要尝试登记作为试剂系统一部分的单个试剂容器。

登记 BOND 即用型试剂

如需登记 BOND 即用型试剂包，可扫描容器正面的条形码。软件将显示**添加试剂包**对话框。

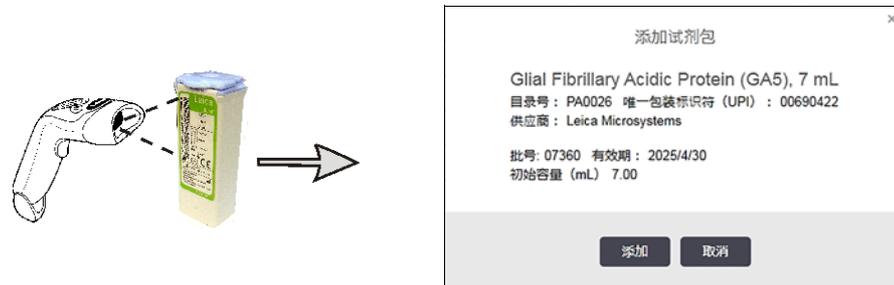


图 84: 登记 BOND 试剂包

确认对话框中的信息与试剂包的信息相同，然后单击**添加**。

登记非即用型试剂

非 BOND 即用型试剂包提供的试剂可装入 BOND 开放容器或滴定容器中在 BOND 系统中使用。当非即用型试剂制备完毕并灌装入 7 mL 或 30 mL 的开放容器后，或灌装入 6 mL 的滴定容器后，即可进行登记，方法和登记 BOND 试剂大致相同：

1. 确保试剂已在系统中创建并已设置为首选。用户定义的试剂必须是首选状态才能列入清单。(参阅 [8.2.1 添加或编辑试剂](#))。

请注意，用 BOND Enzyme Pretreatment Kit (Bond 酶预处理试剂盒) 创建的酶是在系统中预定义的，不需要手动创建。

2. 扫描开放容器或滴定容器正面的条形码，以打开**添加开放容器**对话框。
3. 从**试剂名称**下拉列表中选择试剂名称。(供应商名称显示在试剂名称旁边的括号中。)

列表中包含在系统中创建的所有首选非 BOND 辅助试剂和标记，以及四种可以用 BOND Enzyme Pretreatment Kit 制备的预定义酶试剂。如果您尚未在系统中创建试剂，点击取消退出**添加开放容器**对话框，先创建试剂(参阅上述步骤 1)。

4. 键入从试剂供应商文档中查得的试剂批号。
5. 点击**有效期**字段，用日历控件设置有效期(也可以键入日期)。



您可输入简短的日期，比如日和月份 D/M、DD/MM 或 DD/MMM；年份默认为当前年份。如果您输入月份和年份 MM/YYYY 或 MMM/YYYY，则日期即被默认为该月份的一号。

如果输入了无效日期，**有效期**字段周围会出现红线边框，同时显示一条验证错误信息。

当您点击**有效期**字段以外区域时，有效的日期输入项会被自动重定格式以符合系统的日期格式。如果在输入一个无效日期之前已输入了至少一个有效日期，当您点击该字段以外区域时，该字段将被重置为最后输入的有效日期。

6. 点击**确定**登记试剂。

手动 ID 输入

如果 BOND 系统未能读取试剂的条形码，在**试剂清单**屏幕中进行如下操作：

1. 单击**输入 ID**。
BOND 软件将显示**手动 ID 输入**对话框。
2. 在对话框中的第一行键入试剂 ID (在试剂包正面的条形码旁边)。
3. 点击**验证**。

如果条形码多于一个(如检测系统)，则每输入一个试剂包编号后都要点击**验证**。

4. 当试剂包编号被验证为有效后，软件显示相应的**添加试剂包**对话框。
5. 核实**添加试剂包**对话框中的试剂包详细信息，或按需要添加详细信息，然后点击**确定**登记试剂包。

8.3.4 清单详细信息报告

对于在**试剂清单**屏幕上的表格中显示的试剂或试剂系统，可以生成清单详细信息报告。生成的报告将显示各个可见试剂或系统的信息，包括总的剩余库存量。如果总库存低于最低库存量（参阅 8.3.2 试剂或试剂系统详细信息中的[更改最低库存设置](#)），其在报告中就会被标示为“低”。

设置屏幕下方的筛选器，使之显示您感兴趣的试剂或试剂系统，然后点击**详细信息报告**。报告生成并显示在新窗口中。

试剂清单报告的右上角显示下表中的信息。

字段	描述
科室	在管理客户端 实验室设置 屏幕上的 科室 字段中输入的科室名称 – 参阅 10.5.1 实验室设置
标题	用于选择该报告中的试剂或试剂系统的筛选器设置。

对于列在表中的各种试剂，报告的正文将显示：

- 名称
- 现有的总储存量（低于最低库存量时会被标记）
- 目录编号（对于 BOND 即用型容器）或“开放”（对于开放容器）
- 类型（一抗、探针、辅助试剂、或试剂系统类型）
- 供应商

对于各单个试剂包，报告将显示：

- UPI
- 批号
- 有效期
- 登记日期
- 首次使用日期
- 上次使用日期
- 剩余量。

参阅 [3.7 报告](#)中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

8.3.5 试剂使用报告

试剂使用报告可显示指定时间范围内的试剂用量和用该试剂处理的检测数量。报告内容按单个容器详细列出，并显示试剂总计。

报告内容包括指定时间内使用的所有试剂，无论该试剂当前是否显示在**试剂清单**屏幕上，但不包括试剂系统的使用情况。

点击**试剂使用**打开日期选择对话框，您必须在其中设置报告要涵盖的时间范围。设置**自**和**至**的日期和时间（参阅 9.1 玻片历史屏幕中的**使用日期及时间选择框**），然后点击**生成**，报告生成并显示在新窗口中。

试剂使用报告的右上角显示下表中的信息。

字段	描述
科室	在管理客户端 实验室设置 屏幕上的 科室 字段中输入的科室名称 – 参阅 10.5.1 实验室设置
时间范围	用于设置报告的时间范围的“自”和“至”日期时间栏

对于在该段时间范围中使用的各种试剂，报告将显示：

- 名称（试剂的缩略名）；
- 使用的各个容器的唯一包装标识符（UPI）；
- 使用的各个容器的批号；
- 使用的各个容器的有效期；
- 处理的玻片数量，包括每个容器处理的玻片数和该试剂处理的玻片总数；
- 在该段时间内使用的试剂容量，包括每个容器的容量和该试剂的总量。

参阅 **3.7 报告**中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

8.4 试剂模板屏幕

模板是用户定义的一组标记。您可以使用模板快速向系统中添加多个玻片。

模板仅可用于常规单染玻片；不能用于设置双染玻片。且必须拥有主管用户角色才能创建模板。

欲显示**试剂模板**屏幕，点击功能栏上的**试剂设置**图标，然后点击**模板**页签。

更多信息请参阅：

- [8.4.1 创建模板](#)
- [8.4.2 查看或编辑模板详细信息](#)
- [8.4.3 移除模板](#)

8.4.1 创建模板

按下述步骤创建模板（必须拥有主管用户角色）：

1. 单击**添加模板**。
软件将显示**试剂模板属性**对话框。



图 85：试剂模板属性对话框

试剂模板属性对话框右侧的表格列出了模板的内容，左边的表格列出了所有可用标记。

2. 在对话框顶部的**模板名称**字段中输入模板名称。
没有名称的模板将无法保存。

- 若要向模板中添加标记，在左边表格中的可用抗体或探针列表中选择个项目，然后单击

检测组织 >

要添加阳性对照组织，在标记上单击，然后单击

阳性组织 >

要添加阴性对照组织，在标记上单击，然后单击

阴性组织 >

- 要从模板中删除某项目，在右侧的表中选中它，然后单击

< 移除

-  模板必须包含检测组织。没有检测组织的模板将无法保存。
- 当模板正确后，单击**确认**保存详细信息。
如果不想保存模板，单击**取消**。

8.4.2 查看或编辑模板详细信息

如需查看模板详细信息，在**试剂模板**屏幕左侧的表格中选择模板，模板中的标记即会显示在屏幕右侧的表格中。若要编辑模板，点击**模板属性**，然后按 [8.4.1 创建模板](#) 所述进行编辑。

8.4.3 移除模板

如需从系统中移除一个模板，在**试剂模板**屏幕上的表格中选择模板，然后单击**移除模板**。您将被要求确认是否移除。

-  移除模板时应慎重。被删除的模板的详细信息无法恢复。

9

玻片历史（在 BOND 控制器上）

玻片历史屏幕显示在 BOND 系统中预定进程、正在运行或运行完毕的玻片的详细信息。

已预定进程但在处理启动前被中止（通过解锁玻片架）的运行，其单个玻片记录被从历史列表中删除，而代之以表示整个玻片架的单行记录，显示的状态为“已拒绝”。对这些运行可以生成运行事件报告和运行详细信息报告。

本章有以下章节：

- [9.1 玻片历史屏幕](#)
- [9.2 玻片选择](#)
- [9.3 玻片属性和玻片重新运行](#)
- [9.4 运行事件报告](#)
- [9.5 运行详细信息报告](#)
- [9.6 病例报告](#)
- [9.7 程序报告](#)
- [9.8 玻片概要](#)
- [9.9 导出数据](#)
- [9.10 玻片历史摘要](#)

9.1 玻片历史屏幕

如需查看玻片历史详细信息或者生成运行事件、运行详细信息或病例报告，可选择功能栏上的**玻片历史**图标。



玻片历史

玻片筛选器 日期范围 自: 2013/1/1 6:12 PM 至: 2017/4/5 6:12 PM 最近 7 天 应用

处理日期	运行 ID	玻片 ID	标记	患者姓名	病例 ID	类型	状态
2013/8/27	84	00000288	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000289	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000241	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000291	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000292	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000290	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000293	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000294	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000295	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/27	84	00000296	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	检测	进行中
2013/8/26	90	00000399	*CD5	Cherry Dale	CS3225 - 527991	检测	进行中
2013/8/26	90	00000398	*Tyros	Jacob Dean	CS3225 - 527990	检测	进行中
2013/8/26	90	00000396	*CD20	Jacob Dean	CS3225 - 527990	检测	进行中
2013/8/26	90	00000395	*CD5	Jacob Dean	CS3225 - 527990	检测	进行中
2013/8/26	90	00000394	*Tyros	Amanda Francis	CS3224 - 527909	检测	进行中
2013/8/26	90	00000391	*CD5	Amanda Francis	CS3224 - 527909	检测	进行中
2013/8/26	90	00000400	*CD20	Cherry Dale	CS3225 - 527991	检测	进行中
2013/8/26	90	00000397	*MelA	Jacob Dean	CS3225 - 527990	检测	进行中
2013/8/26	90	00000393	*MelA	Amanda Francis	CS3224 - 527909	检测	进行中

运行 ID 编号可能不是顺序递增

玻片概要 导出数据 玻片历史摘要 玻片属性 运行事件 运行详细信息 病例报告 程序报告

图 86: 玻片历史屏幕

玻片历史列表显示一定时间范围内的玻片运行，时间范围用列表上方的**日期范围**筛选器来限定；还可显示用**玻片 ID** 筛选器查找到的特定玻片（参阅 9.2 玻片选择）。

注意，屏幕上显示的运行 ID 编号可能不是顺序递增。运行 ID 号是在玻片架被锁定时分配的，因此，如果某个玻片架被锁定、解锁，然后再次锁定（在运行开始前），其运行 ID 号将递增，而第一次锁定后分配的编号将被略过。

玻片的颜色编码按照**玻片设置**屏幕上使用的编码（参阅 6.5.1 玻片字段及控件说明）：

- 白色：在**添加玻片**对话框中创建的玻片
- 黄色：在**玻片识别**对话框中创建的玻片（参阅 6.8 即时玻片和病例创建）
- 浅灰色：实验室信息系统（LIS）玻片
- 红色：优先实验室信息系统（LIS）玻片（参阅 11.2.5 优先玻片）。

列表中报告了每个玻片的下列数值：

- 处理日期 (玻片处理启动的日期)
- 运行 ID
- 玻片 ID
- 标记 (一抗或探针的名称)
- 患者姓名
- 病例 ID
- 类型 (检测组织, 或者阳性或阴性对照组织)
- 状态 (正在进行或已完成, 以及是否注明了意外事件; 对于在处理开始前被中止的运行, 还可能有“已拒绝”状态)。

i 如果状态是“完成 (通知)”，请仔细检查运行事件报告以确定意外事件是否影响到染色。意外事件以粗体文字显示。

若想查看某个玻片的信息，在列表中选中它，然后点击列表下方的相应按钮。

9.2 玻片选择

通过显示在限定时间范围内处理的全部玻片来筛选将在**玻片历史**屏幕上列出的玻片；也可通过输入玻片 ID 来显示特定玻片。点击下拉菜单，然后选择您想使用的玻片筛选器。

日期范围玻片筛选器



图 87: 日期范围玻片筛选器

使用**日期范围**玻片筛选器可以指定该屏幕的报告时间范围；只有在此时间范围内处理的玻片才会被显示。设置“自”和“至”日期，必要时设置时间，以指定将显示的时间范围，然后点击**应用**即可显示玻片。

如果在您定义的时间范围内处理的玻片数超过 1000 张，则仅显示最先的 1000 张玻片。要想查看全部这些玻片的详细信息，您必须导出玻片数据 – 参阅 [9.9 导出数据](#)。

至字段的初始设置是当前日期和时间，而**自**字段是整一周前的时间。如果您更改了设置，可以通过点击**最近七天**返回这一设置。

使用日期及时间选择框

如需设置日、月和年份，点击日历图标，然后选择日期。通过点击日历标题栏中的箭头可滚动显示月份，或者点击标题栏的中间选择另一月份或滚动显示年份。也可直接在该字段中键入日期。

如需设置时间，在时间字段中单击，然后使用向上和向下按钮（或键盘上的上、下箭头键）。根据光标放置的位置，时间变化幅度可以是一小时、十分钟或一分钟。也可直接在该字段中键入时间。

玻片 ID 玻片筛选器

使用**玻片 ID** 玻片筛选器可以查找某个具体玻片的信息。在**玻片 ID** 字段中键入玻片 ID，然后点击**应用**。

9.3 玻片属性和玻片重新运行

若要查看**玻片历史**列表中某个玻片的属性，选中该玻片后点击**玻片属性**（或双击），打开的对话框与在**玻片设置**屏幕中打开的对话框相同（[6.5.4 编辑玻片](#)）。

当**玻片属性**对话框在**玻片历史**屏幕中被打开时，您无法在其中编辑任何患者或检测详细信息（因为玻片已处理完毕或正在处理），但可以在**注释**字段中添加注释，或重新运行玻片 – 参阅下面的[重新运行玻片](#)。

9.3.1 重新运行玻片

如果玻片不符合要求，它会被加上标记以便重新运行。按下述步骤在**玻片属性**对话框中启动玻片重新运行：

1. 点击**复制玻片**。
玻片属性对话框变更为**添加玻片**对话框，并且字段可编辑。
2. 作必要的更改后，点击**添加玻片**。
3. 确认复制玻片的病例、患者和医生，将玻片添加至**玻片设置**屏幕。
添加玻片对话框仍保持打开，以便您添加更多玻片。
4. 单击**关闭**返回**玻片历史**屏幕。
5. 以正常方式运行新创建的玻片。

9.4 运行事件报告

此报告是在**玻片历史**屏幕中生成的，可显示与选定玻片一起运行的玻片架上所有玻片的所有事件。点击**运行事件**即生成此报告。

运行事件报告还可以在玻片被处理期间生成。在**系统状态**或**程序状态**屏幕上右键点击相应的运行或列表，然后在菜单中选择**运行事件**。有玻片通知的事件用粗体字显示以方便查找。

运行事件报告的右上角显示下表中的信息：

字段	描述
操作仪序列号	该次运行所使用的操作仪的序列号
操作仪	该次运行所使用的操作仪的名称
玻片架	该次运行所使用的玻片染色装置的编号
分配容量	分配的试剂的容量（参阅 6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置 ）
开始时间	运行被启动的日期和时间
运行进度	运行是否“已结束”或仍在“处理中”
染色模式	使用的染色方法，例如常规单染

该次运行中所有玻片的玻片标签图像被显示在报告顶部。报告正文显示该次运行中各个事件的时间、事件编号和事件描述。若有必要，Leica Biosystems 将使用事件编号进行错误追踪。

参阅 [3.7 报告](#) 中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

9.5 运行详细信息报告

此报告是在**玻片历史**屏幕上生成的，可显示与当前选定玻片在同一玻片架上的各个玻片的详细信息。玻片架必须已结束操作并已解锁。点击**运行详细信息**即可生成报告。报告右上角显示下表中的信息：

字段	描述
操作仪序列号	该次运行所使用的操作仪的序列号
操作仪名称	该次运行所使用的操作仪的名称
玻片架	该次运行所使用的玻片染色装置的编号
开始时间	运行被启动的日期和时间
运行启动者	启动该次运行的用户名

对于该次运行中的每张玻片，报告正文都会显示一个玻片标签图像和以下信息。

字段	描述
玻片 ID	BOND 系统为每张玻片分配一个唯一标识符
玻片创建者	玻片创建者的用户名，或者相关的“实验室信息系统（LIS）”
病例号	BOND 软件生成的唯一病例标识符
组织类型	检测组织、阳性对照组织或阴性对照组织
分配容量	分配的试剂的容量（参阅 6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置 ）
患者姓名	患者的标识
病例 ID	玻片设置过程中输入的病例标识
染色程序	所使用的染色程序
制备	所使用的制备程序（如有）
HIER 程序	所使用的热抗原修复（HIER）程序（如有）
酶程序	所使用的酶修复程序（如有）
变性	仅针对原位杂交（ISH），采用的变性程序（如有）
杂交	仅针对原位杂交（ISH），采用的杂交程序（如有）
LIS 参考 [2-7]	安装了 LIS-ip 的系统的其他实验室信息系统（LIS）参考信息（参阅 11.2.6 实验室信息系统（LIS）玻片数据字段 ）
染色	使用的染色方法，例如常规单染
完成状态	指明玻片是否正在处理、已完成或已评分，以及是否有通知事件报告
注释	可随时在玻片属性中输入注释
签批：	“签批”是打印的纸质报告上的保留空间，供主管人员针对各个玻片进行签字

使用的试剂（或首选试剂盒包含混合试剂成分）

UPI	玻片使用的每种试剂或首选试剂盒的唯一包装标识符
名称	玻片使用的每种试剂或首选试剂盒的名称
通用名	通用名，用于安装了 LIS-ip 的系统
批号	玻片使用的每种试剂或首选试剂盒的批号
有效期	玻片使用的每种试剂或首选试剂盒的有效日期

参阅 [3.7 报告](#) 中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

9.6 病例报告

病例报告显示与当前选定玻片属同一病例的每张玻片的详细信息。该报告可通过**玻片设置屏幕**、**玻片历史屏幕**和**玻片识别对话框**生成。病例报告的右上角显示下表所列信息：

字段	描述
病例 ID	玻片设置过程中输入的病例标识
患者姓名	患者姓名
病例注释	其他病例信息
医生	负责该患者的医生或病理医师的姓名
医生注释	其他医生信息
建立日期	创建病例的日期和时间
病例号	BOND 系统生成的唯一病例标识符

报告正文显示病例中各张玻片的下列信息：

字段	描述
玻片 ID	BOND 系统为每张玻片分配一个唯一标识符
玻片创建者	玻片创建者的用户名，或者相关的“实验室信息系统 (LIS)”
回合	被处理玻片所在的运行的编号
运行启动者	启动该次运行的用户名
组织类型	检测组织、阳性对照组织或阴性对照组织
分配容量	分配的试剂的容量 (参阅 6.5.8 分配容量和组织在玻片上的位置)
染色程序	所使用的染色程序
制备	所使用的制备程序 (如有)
HIER 程序	所使用的热抗原修复 (HIER) 程序 (如有)
酶程序	所使用的酶修复程序 (如有)
变性	仅针对原位杂交 (ISH)，采用的变性程序 (如有)
杂交	仅针对原位杂交 (ISH)，采用的杂交程序 (如有)
LIS 参考 (2-7)	安装了 LIS-ip 的系统的其他实验室信息系统 (LIS) 参考信息 (参阅 11.2.6 实验室信息系统 (LIS) 玻片数据字段)
染色	使用的染色方法，例如常规单染
完成状态	指明玻片是否正在处理、已完成或已评分，以及是否有通知事件报告
注释	可随时在玻片属性中输入注释
签批：	“签批”是打印报告的保留空间，供管理员在其中签上评分和注释

使用的试剂

UPI	玻片使用的每种试剂的唯一包装标识符
名称	玻片使用的每种试剂的名称
通用名	通用名，用于安装了 LIS-ip 的系统
批号	玻片使用的每种试剂的批号
有效期	用于该玻片的每一种试剂的有效期

参阅 [3.7 报告](#) 中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

9.7 程序报告

若要为选定玻片所使用的程序生成报告，选择玻片后点击**程序报告**。从玻片上运行的程序中选择所需的程序，然后点击**报告**以创建报告。参阅 [7.5 程序报告](#) 中的报告说明。

9.8 玻片概要

玻片处理概要显示在指定时间段内启动的玻片数量。信息同时以列表和图形格式显示指定时间范围内单位时间中处理的玻片数量。

要报告已处理的玻片数量，在**玻片历史**屏幕中点击**玻片概要**，打开**玻片概要**对话框。

在**操作仪**下拉列表中根据名称选择某台操作仪或选择**全部**（全部操作仪，或 BOND-ADVANCE 中客户端当前连接的仪器组中的全部操作仪）。

在**时间精度**栏中选择要用于报告已启动玻片数量的时间单位，例如，选择“天”，生成的报告显示指定时间段内每天启动的玻片数量，而“月”则给出该时间段内每个月启动的玻片数量。

设置**至**和**自**日期。在**时间精度**字段中设置的时间单位从**自**日期开始以完整的时间单位增进，直至接近**至**日期，此时可能需要用细分单位完成时间段设置。

点击**生成**以预览报告。

参阅 [3.7 报告](#) 中关于报告窗口和打印选项的详细内容。

9.9 导出数据

在玻片历史屏幕中点击**导出数据**以创建一个文件，该文件包括在选定日期范围内完成染色处理的所有玻片的详细信息。导出的文件是标准的“逗号分隔值”（CSV）文件格式，且文件能够方便地导入第三方电子表格应用程序（如 Microsoft Excel）。数据导入电子表格后，其显示格式允许进行（取决于电子表格功能）排序、搜索和创建自定义的报告和图表。

对于选定日期范围内的每张玻片，下列信息将包含在导出文件中：

- 程序日期
- 操作仪序列号
- 玻片 ID
- 运行启动者
- 标记唯一包装标识符（UPI）
- 标记唯一包装标识符（UPI）2
- 患者姓名
- 组织类型（检测组织，阳性或阴性对照组织）
- 状态
- 注释
- 制备程序版本
- 热抗原修复（HIER）程序版本
- 酶程序版本
- 变性程序版本
- 杂交程序版本
- 染色程序版本
- 热抗原修复（HIER）程序版本 2
- 酶程序版本 2
- 变性程序版本 2
- 杂交程序版本 2
- 染色程序版本 2
- 检测系统序列号
- 检测系统序列号 2
- 操作仪名称
- 运行 ID
- 玻片创建者
- 染色
- 标记名称
- 标记名称 2
- 病例 ID
- 医生
- 分配容量
- 制备程序名称
- 热抗原修复（HIER）程序名称
- 酶程序名称
- 变性程序名称
- 杂交程序名称
- 染色程序名称
- 热抗原修复（HIER）程序名称 2
- 酶程序名称 2
- 变性程序名称 2
- 杂交程序名称 2
- 染色程序名称 2
- 检测系统名称
- 检测系统名称 2

 列表中含有数字 2 的标题仅涉及顺次双染玻片，其中包含与该玻片的第二次染色有关的信息。

使用下列步骤导出玻片详细信息：

1. 选择所需日期范围 (参考 9.2 玻片选择)。
2. 单击**导出数据**。
3. 看到提示后选择保存文件。

文件将保存在下载文件夹 (或选择**另存为**选项保存至另一文件夹)。

保存的文件可以用标准电子表格程序打开, 如 Microsoft Excel, 并可以根据应用程序所提供的功能进行操作。文件打开时, 可能需要您指定一些文件参数。文件格式为“csv”, 其参数如下:

- 文件类型是**分隔的**
- **分隔符或分隔标志是逗号**
- 使用**通用**列格式。

i 注: 导出的玻片详细信息中的染色处理启动时间与屏幕上玻片历史中的启动时间不会完全相符。玻片历史屏幕上显示的启动时间是按下运行启动按钮  的时间, 而导出数据中报告的时间是运行在操作仪中实际开始的时间。

9.10 玻片历史摘要

玻片历史摘要报告显示的是, 在**玻片历史**屏幕中选择玻片时所选的时间范围内, 仪器组中处理的 (或正在处理的) 所有玻片的信息。该报告有一个签批区域, 可用作已处理玻片的记录。

若要创建玻片历史摘要报告, 打开**玻片历史**屏幕, 设定**自**和**至**日期与时间, 从而在屏幕中导入所设定的时间内仪器组中处理的全部玻片 (参阅 9.2 玻片选择)。点击**玻片历史摘要**即可生成报告。

i 在处理量较大的实验室中, **玻片历史**屏幕中的默认时间范围 (一周) 可能会包括数千张玻片。对如此多的玻片生成一份报告将花费数分钟时间 - 若有可能, 可考虑定义较短的时间范围, 而不必接受默认设置。

报告包含的各玻片的详细信息如下:


- | | |
|---------|--------|
| • 病例 ID | • 组织类型 |
| • 患者姓名 | • 分配容量 |
| • 玻片 ID | • 状态 |
| • 标记 | • 签批 |

10

管理客户端（在 BOND 控制器上）

BOND 系统的所有常规设置（除操作规程和试剂以外）都在独立的软件应用程序“管理客户端”中进行。只有拥有管理员角色的用户才能运行管理客户端程序和使用其中的全部功能。

管理客户端有下列几个屏幕，可以用横贯客户端屏幕顶部的功能栏中的图标打开：



- 10.1 使用者
- 10.2 实验室信息系统（LIS）
- 10.3 标签
- 10.4 BDD
- 10.5 设置
- 10.6 硬件

10.1 使用者



BOND 系统用户的管理在管理客户端的**用户管理**屏幕上进行。您可以创建、编辑和禁用用户，但不能删除用户 – 用户将永远保留在系统中。不过，您可以禁用用户，不允许他们访问任何一个客户端。

被允许访问系统的用户拥有各种角色，这些角色可给予他们不同的软件访问权限。只有拥有管理员角色的用户才能打开管理客户端程序（并在其中执行所有的功能）。具有操作员角色的用户可以登记试剂，设置和处理玻片，并生成报告，但不能编辑试剂详细信息、试剂模板或操作规程。具有主管角色的用户拥有操作员的所有权限，另外还能够编辑试剂详细信息、模板和操作规程。用户可以拥有不止一个角色。

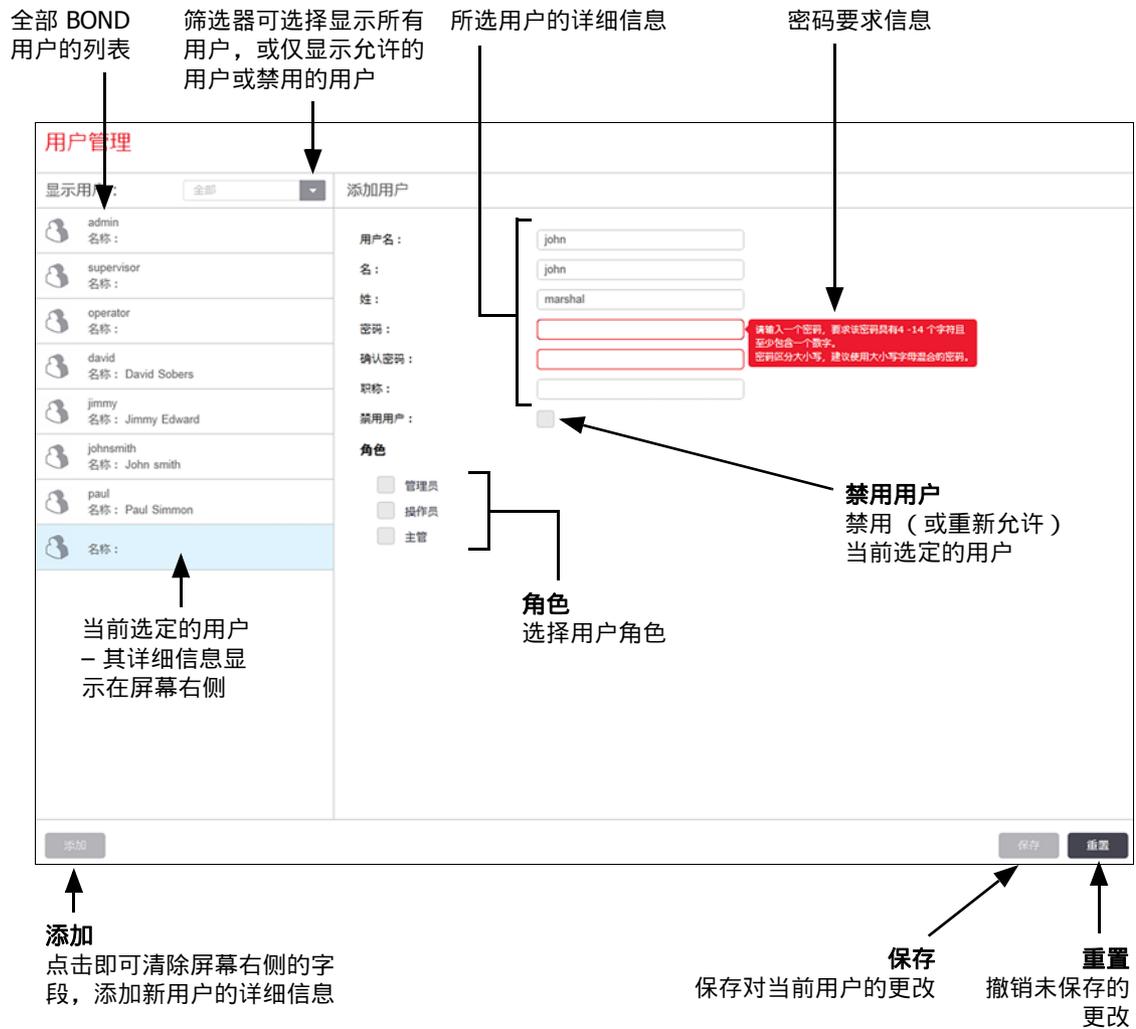


图 88: 用户管理屏幕

每个新用户都需要有一个用户名和密码, 二者在登录临床客户端程序和管理客户端程序时都是必需的。一旦创建了用户后, 用户名便不可更改, 但可以更改密码。用户可以随时在 BOND 登录对话框中更改自己的密码, 管理员也可以在**用户管理**屏幕中更改这些密码。密码必须包含 4-14 个字符, 并包括至少一位数字。

i 密码区分大小写, 建议在密码中同时包含大小写字母。BOND 系统将对密码的更改进行确认; 密码必须符合最低要求才能进行保存。不要与其他人员分享密码。离开仪器时应退出帐号。

其他用户详细信息 (姓名和职务) 为选填项。这些信息显示在日志和报告中。

10.2 实验室信息系统 (LIS)



大多数实验室信息系统 (LIS) 设置是由维修人员在安装 BOND LIS-ip 时进行的, 但有少数几个设置选项可由用户在 **LIS 设置** 屏幕中设置。该屏幕还有一个错误信息日志。

许可
显示 LIS-ip 许可密码 –
参阅下面的**许可**

重复病例 ID
使用与现有病例相同的病例
ID 设置病例操作 – 参阅下面
的**重复病例 ID**

强制在 BOND 中打印实验室信息系统 (LIS)
强制在 BOND 中打印全部实验室信息系
统 (LIS) 玻片 – 参阅 **11.7 玻片标签**

启用实验室信息系统 (LIS) 以便更新实验室信息系统 (LIS) 玻片
当实验室信息系统 (LIS) 再次发送
具有相同条形码 ID 的玻片时, 覆盖
(更新) 未处理的玻片。如果此设置
被禁用, 则 BOND 将拒绝所有实验
室信息系统 (LIS) 重复使用同一
条形码 ID 的尝试。

启用未处理实验室信息系统 (LIS) 玻片保留时间 (小时):
删除从实验室信息系统 (LIS) 接收的在
输入的时间段内未被处理的玻片。

**编辑实验室信息系统 (LIS) 数据
字段**
设置 BOND 中的玻片数据显示 –
参阅下文**实验室信息系统 (LIS)
玻片数据字段**

日志信息
– 当您点击**查看日志** (见右)
时即以列表格式显示。

查看日志
显示由实验室信息系统 (LIS) 信息发送至 BOND 引起
或者由 BOND 回复至实验室信息系统 (LIS) 信息引起
的错误列表。再次点击可更新列表中的错误信息。

图 89: LIS 设置屏幕

许可

您需要有一份 BOND LIS-ip 许可, 该许可由 Leica Biosystems 提供的密码激活。通常情况下, 负责设置 LIS-ip 连接的维修人员会替您输入此密码, 但如果未输入密码, 则屏幕上仅显示**许可**字段。输入密码即可开启 LIS-ip 功能, 并显示如图 89 所示的设置选项和日志。

重复病例 ID

使用**重复病例 ID** 设置可以设定如何处理从实验室信息系统 (LIS) 收到的病例 ID 与 BOND 中的已过期或已删除实验室信息系统 (LIS) 病例相同的病例。(如果某个实验室信息系统 (LIS) 病例与某个现有的 BOND 病例, 即在 BOND 中创建的病例拥有相同的病例 ID, 则该实验室信息系统 (LIS) 病例将被自动拒绝。) 有两个选项:

- **恢复现有病例:** 当收到新病例时, 如果其中的患者姓名与现有病例相同, 则现有病例即被恢复 (重新使用)。如果新病例有相同的病例 ID 而患者姓名却不同, 则病例会被拒绝。
如果医生姓名有变动, 将使用新姓名。
- **拒绝信息:** 新实验室信息系统 (LIS) 病例不会被传输至 BOND。报告这一结果的信息将记录在实验室信息系统 (LIS) 中。您必须更改实验室信息系统 (LIS) 中的病例 ID, 然后重新发送该病例。

有关处理非实验室信息系统 (LIS) 病例中的重复病例 ID 的讨论, 请参见 [6.3.4 病例重复、激活和完成](#)。有关实验室信息系统 (LIS) 病例的一般信息, 请参阅 [11.2.2 实验室信息系统 \(LIS\) 病例](#)。

实验室信息系统 (LIS) 玻片数据字段

BOND^{LIS}-ip 装置可以设置为由实验室信息系统 (LIS) 发送每张玻片最多达 7 个参数至 BOND。这些数据仅供查看, 显示在**玻片属性**对话框的 **LIS** 页签中。这些参数的基本设置由维修技术人员进行, 但您可以选择隐藏任意一个参数字段, 并设置这些字段的名称。

勾选您希望显示的字段, 键入字段名称。

10.3 标签



使用**标签模板**屏幕可以创建和编辑玻片标签模板, 以及选择要使用的模板。

模板类型有八种, 可用于 BOND 中的八个玻片类型:

- BOND单染
- BONDOracle
- BOND顺次双染
- BOND并行双染
- 实验室信息系统 (LIS) 单染
- LIS Oracle
- 实验室信息系统 (LIS) 顺次双染
- 实验室信息系统 (LIS) 并行双染

“BOND”模板用于在 BOND 中创建的玻片，而“实验室信息系统 (LIS)”模板用于在实验室信息系统 (LIS) 中创建但从 BOND 上打印的玻片。

每种玻片类型有三种预定义模板 (2D 条形码、1D 条形码和 OCR)。无法对这些模板进行编辑或删除。**10.5.2 病例与玻片设置**中展示的 **BOND 标签 ID** 设置决定了使用的默认模板；OCR 或是 2D 条形码。

- i** 当从 BOND 5.1 升级到 BOND 6.0 或更新版本时，将保留现有的默认模板，2D 条形码模板也可供使用。
- i** 如果您的 BOND 系统已从早前版本升级，您可以继续使用已有的条形码扫描仪。但是较早型号不支持 2D 条形码。

若要将另一模板用于某个玻片类型，可复制默认模板，在复制所得的“用户模板”上进行编辑，然后将其“激活”，使之成为 BOND 将用于此类玻片的模板。您可以为每种玻片类型创建任意数量的模板，但每次只能激活一个模板。



必须在标签中包含足够的信息，以确保在自动标签识别失败时能够人工识别标签。Leica Biosystems 建议所有玻片应包括以下字段：


- 病例 ID 或患者姓名
- 玻片 ID (若使用条形码)
- 组织类型 – 用以鉴别对照组织；以及
- 标记 – 将使用的一抗或探针。

玻片类型

选择一个玻片类型 – 所有类型模板都显示在以下窗格中

模板属性

属性当前选定的模板布局的总体属性 (在点击左边窗格中的**编辑**按钮之前仅可查看)

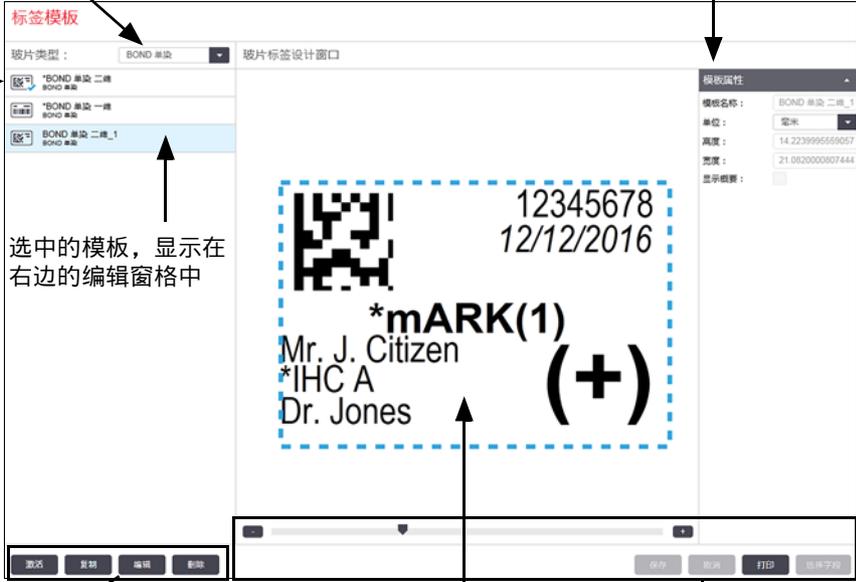

激活模板 (显示蓝色勾号) →

选中的模板，显示在右边的编辑窗格中

模板管理命令 – 参阅图 91

模板编辑命令 – 参阅图 92

图 90: 标签模板屏幕

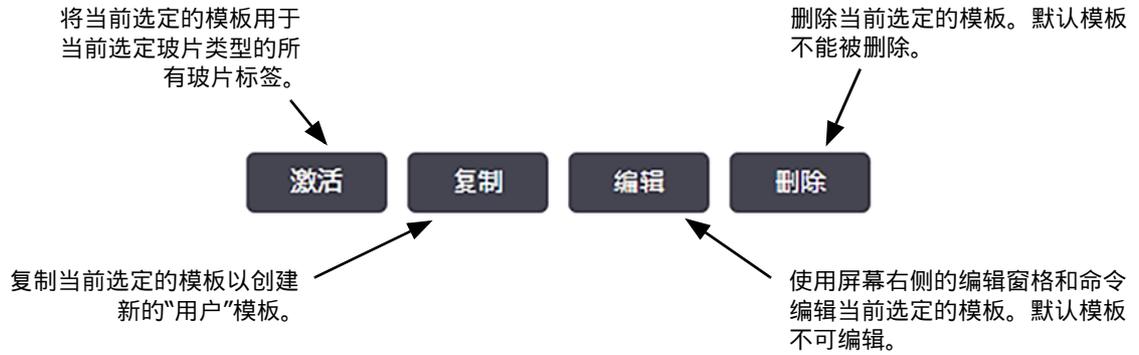


图 91: 标签模板管理命令

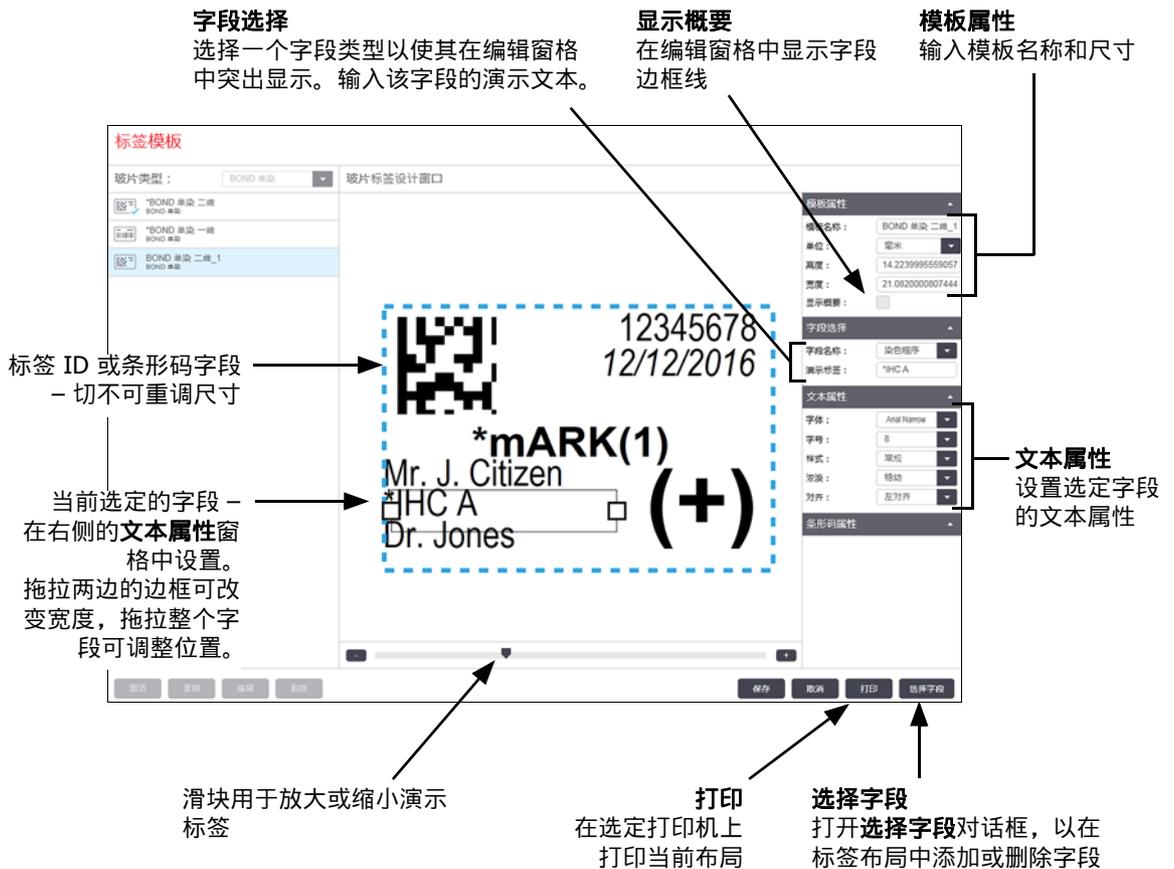


图 92: 标签模板编辑命令

另请参阅:

- 10.3.1 创建、编辑和激活标签模板
- 10.3.2 信息类型

10.3.1 创建、编辑和激活标签模板

创建新模板的方法是复制现有模板并对其进行编辑，或者编辑现有的用户模板（而非默认模板）。激活模板即可使其成为从 BOND 打印的标签所使用的模板。

- [创建新模板](#)
- [编辑模板](#)
- [激活模板](#)

创建新模板

1. 选择将使用新模板的玻片类型。
所有用于该玻片类型的现有模板将显示出来。
2. 选择欲复制的模板（选择与您想要创建的模板最相似的模板）。
3. 点击**复制**。



复制 1D 条形码模板会创建新的 1D 条形码“用户模板”。

复制 2D 条形码模板会创建新的 2D 条形码“用户模板”。

复制 OCR 模板会创建新的 OCR“用户模板”。

编辑模板

1. 在左侧窗格中选择一个模板，然后点击**编辑**。
屏幕右侧的编辑窗格、按钮和属性列表即被启用，以便编辑显示在编辑窗格中的模板布局。
2. 可以选择**显示轮廓**（在右上方的**模板属性区**）以在编辑窗格中显示字段边框线。
3. 在**模板属性**区域内输入模板名称。



标签模板名称最长限 64 个字符，并且用于相同玻片类型的所有模板名称都必须是唯一的。

4. 编辑布局：
 - (i) 添加或删除字段 – 点击**选择字段**，选择需显示的玻片属性（参阅 [10.3.2 信息类型](#)中的所有可用属性列表）。
注意：您无法删除用于自动识别的**标签 ID** 字段。
 - (ii) 位置字段 – 在编辑窗格中选择并拖放字段。
 - (iii) 调整字段宽度 – 拖拉字段两端的边框线。（字段高度由文本字号决定。）
如果设定的字段宽度不够长，使得模板使用后无法容纳特定标签的内容，则文本会被缩短并加上省略号，这样即可确知发生了文本缩短情况。
 - (iv) 设置文本属性 – 在**文本属性**区内选择字段，然后设置字体、字号、风格和字体粗细。还需设置字段内的文本对齐方式。
- 您无法更改**标签 ID** 字段的字体属性 – 字体必须保持其默认设置，以便能被操作仪的扫图仪识读。
5. 点击**保存**。
- 确保**标签 ID** 字段周围有适当的空白区。如果有任何其他字段的文本进入该区域，可能会影响自动识别。

激活模板

1. 在左侧窗格内选择模板，然后点击**激活**。
模板即被标上蓝色的勾号，表示其现在为活动模板。

10.3.2 信息类型

标签模板可以设置为显示以下玻片信息，这些信息在**标签屏幕的选择字段**对话框中选择。

标签 ID 字段用于自动识别，无法从任何模板中移除。根据您的系统设置，会显示为条形码或字母数字字符。

字段	描述
病例 ID	玻片的病例 ID (注意: 不是病例号 – 参阅 6.3 使用病例中的 病例标识)。
玻片创建者	玻片创建者的用户名, 或者相关的“实验室信息系统 (LIS)”
变性程序	变性程序的缩略名
变性程序 2	第二次变性程序的缩略名 (双染程序可能需要)
分配容量	100 µL 或 150 µL 分配容量
医生注释	记录在 BOND 系统中供送检医生参考的附注 (参阅 6.4 管理医生)。
医生	送检医生的姓名
酶抗原修复 (EIER) 程序	酶程序的缩略名。
酶抗原修复 (EIER) 程序 2	第二次酶程序的缩略名 (双染程序可能需要)。
科室	在管理客户端 实验室设置 屏幕上的 科室 字段中输入的科室名称 – 参阅 10.5.1 实验室设置 。
HIER 程序	热抗原修复 (HIER) 程序的缩略名
HIER 程序 2	第二次热抗原修复 (HIER) 程序的缩略名 (双染程序可能需要)
杂交程序	原位杂交 (ISH) 程序的缩略名
杂交程序 2	第二次原位杂交 (ISH) 程序的缩略名 (双染程序可能需要)
LIS 医生注释	用于 LIS-ip 系统, 实验室信息系统 (LIS) 中的医生注释
LIS 医生	用于 LIS-ip 系统, 医生姓名
LIS 参考 [2-8]	导入 BOND 中的实验室信息系统 (LIS) 玻片属性。参阅 11.2.6 实验室信息系统 (LIS) 玻片数据字段 。
标记	用于单染、并行双染或顺次双染第一次染色的一抗或探针的缩略名
标记 2	用于双染第二次染色的一抗或探针的缩略名。
患者注释	病例注释 (参阅 6.3.3 添加病例)
患者	患者姓名
制备程序	制备程序的缩略名
通用名	用于 LIS-ip 系统, 一抗或探针的公用名称 (参阅 11.2.4 通用标记名称); 用于单染或双染第一次染色
通用名 2	用于 LIS-ip 系统, 一抗或探针的公用名称 (参阅 11.2.4 通用标记名称); 用于双染第二次染色
玻片注释	玻片注释 (参阅 6.5.2 创建玻片)
玻片日期	标签被打印的日期 (在 Windows 的区域和语言选项 (控制面板) 中设置的短格式)。

字段	描述
玻片 ID (OCR 模式)	BOND 系统中的玻片独有的 4 位字符字母数字玻片 ID, 是标签 ID 的第一部分。
玻片 ID (条形码模式)	8 位数字玻片 ID, 是 BOND 系统中玻片的唯一 ID。
玻片优先级别	用于 LIS-ip 系统, 玻片的优先等级。
染色模式	单染、双染、诊断或治疗诊断玻片。
染色程序	单染或双染第一次染色的染色程序缩略名。
染色程序 2	双染第二次染色的染色程序缩略名。
组织类型	检测组织, 或者阳性或阴性对照组织。BOND 为阴性对照组织打印“(-)”, 为阳性对照组织打印“(+)”, 对检测组织不打印任何内容。

10.4 BDD



使用 **BDD 更新** 屏幕可更新数据库和生成审计记录文件。

BDD 更新

Leica Biosystems 将定期在网站上发布 BDD (BOND 数据定义) 更新内容, 例如添加新推出的试剂。

指定的文件: **BDD 更新进度条和状态**

导入状态: 成功

已选 BDD 更新文件

查找 BDD 更新文件并显示在左边的字段中

浏览

加载

点击即可安装左侧字段中的 BDD 更新文件

更新日志

时间	级别	类别	日志输入项
2013/8/23 11:30:52	信息	测试管理	已完成
2013/8/23 11:30:52	信息	仪器管理	已成功
2013/8/23 11:31:49	信息	仪器管理	已完成
2013/8/23 11:31:49	信息	病例管理	已成功
2013/8/23 11:31:49	信息	病例管理	已完成
2013/8/23 11:31:49	信息	规则管理	已成功
2013/8/23 11:31:49	信息	规则管理	已完成
2013/8/23 11:31:49	信息	导入 SQL 脚本	已成功
2013/8/23 11:31:50	信息	导入 SQL 脚本	已完成
2013/8/23 11:31:50	信息	标签管理	已成功
2013/8/23 11:31:51	信息	标签管理	已完成
2013/8/23 11:31:54	信息	BDD 更新	已完成

BDD 更新日志

导出修订记录

点击以生成修订记录文件 - 参阅 10.4.2 修订记录

导出修订记录

图 93: **BDD 更新** 屏幕

参阅:

- 10.4.1 BDD 更新
- 10.4.2 修订记录

10.4.1 BDD 更新

Leica Biosystems 定期在网站上发布 BDD (BOND 数据定义) 更新信息, 例如添加新上市的试剂。用于 BOND 6.0 的 BDD 更新文件的扩展名为“*.bdd”。这些更新需在 **BDD 更新** 屏幕上安装。



针对全球各个地区有不同的 BDD 更新文件, 以便符合这些地区不同的法规条例。请确保安装针对您所在地区的正确的更新文件 (关于 **BOND** 对话框可显示地区信息, 参阅 [3.9 关于 BOND](#))。如果不确定应使用的正确文件, 请联系客户支持部门。

您可以随时安装 BDD 更新。

1. 将更新文件下载到 BOND 控制器中 (也可下载至 BOND-ADVANCE 系统中的任意一台 BOND 终端)。
2. 打开管理客户端程序中的 **BDD 更新** 屏幕。
3. 点击**浏览**, 在 Windows 的**打开**对话框中查找更新文件。
点击**打开**, BDD 文件即显示在屏幕左上角附近的字段中。
4. 点击**加载**, 即可用新数据更新定义。

信息将在更新过程中被写入**更新日志**。更新结束时, 最后一行将显示“BDD 更新: 已完成”, 并且顶部窗格中进度条的下方将显示“成功”状态。

-  查看 BDD 更新是否成功的唯一方法是在 **BDD 更新** 屏幕上查看。更新过程只需几分钟时间, 因此我们建议您等到更新完成后再转至其他屏幕。
-  如果更新不成功, 数据定义将恢复至更新前的状态, 关于该结果的信息也将显示在更新日志中。若更新失败, 请联系客户支持部门。

10.4.2 修订记录

您可以生成有关系统的所有变动、包括变动执行者和变动时间的修订记录。该修订记录被写入多个 CSV 文件, 每个文件记录一种不同的信息种类。这些文件被写入控制器上的以下文件夹: BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmms。

创建修订记录文件:

1. 打开 **BDD 更新** 屏幕, 点击**导出修订记录**。
2. 选择**全部数据**即可报告系统整个使用寿命期间的所有变动, 或者选择**自定义日期范围**限定一个具体时间段, 然后定义**自**和**至**栏的日期与时间。
3. 点击**导出**。

10.5 设置



设置屏幕包括常规的 BOND 实验室设置 (**实验室设置**) 以及默认的病例设置、玻片设置和 workflow 选项 (**病例与玻片设置**)。

- [10.5.1 实验室设置](#)
- [10.5.2 病例与玻片设置](#)
- [10.5.3 数据库备份](#)

10.5.1 实验室设置

在**实验室设置**窗格中设置常规实验室选项：

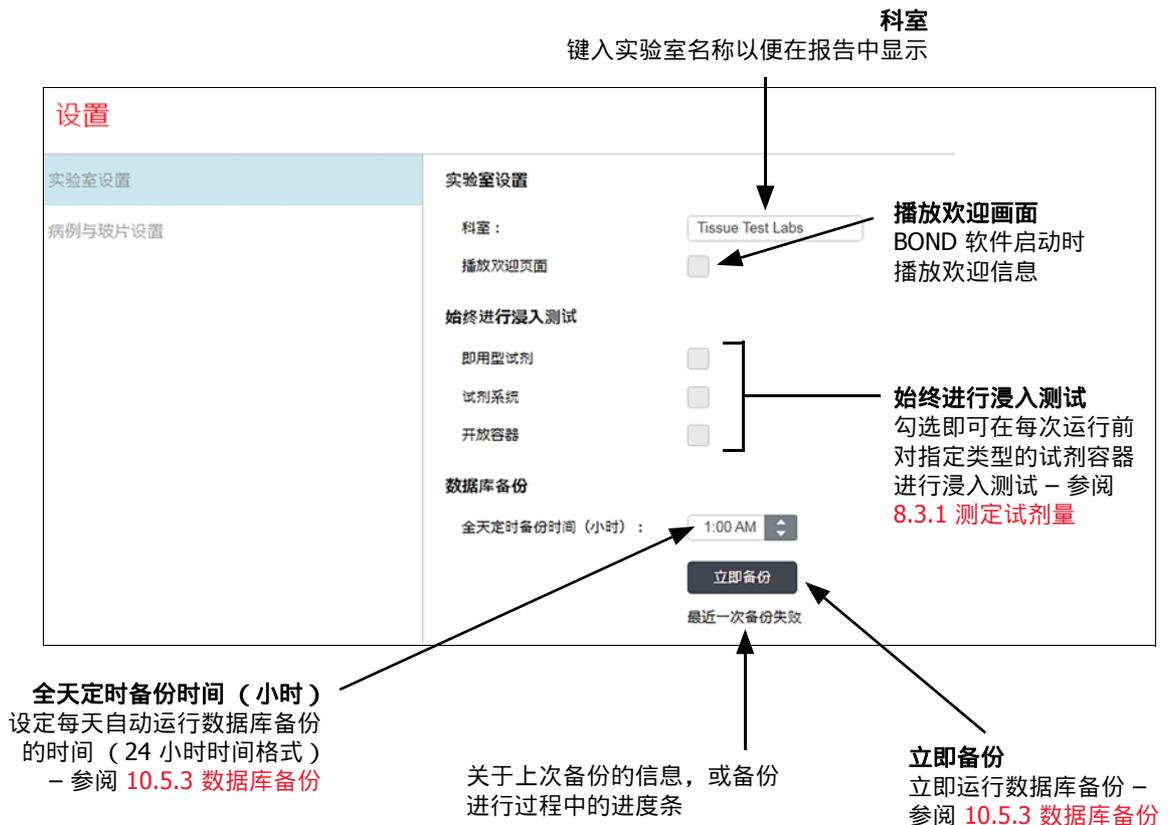


图 94: 设置屏幕实验室设置窗格

10.5.2 病例与玻片设置

病例与玻片设置包括以下设置内容：

- 病例与玻片创建中的多个可设置值的默认设置
- 病例与玻片创建中的工作流程选项。

参阅图 95 和图 96 中对病例和玻片选项的说明。

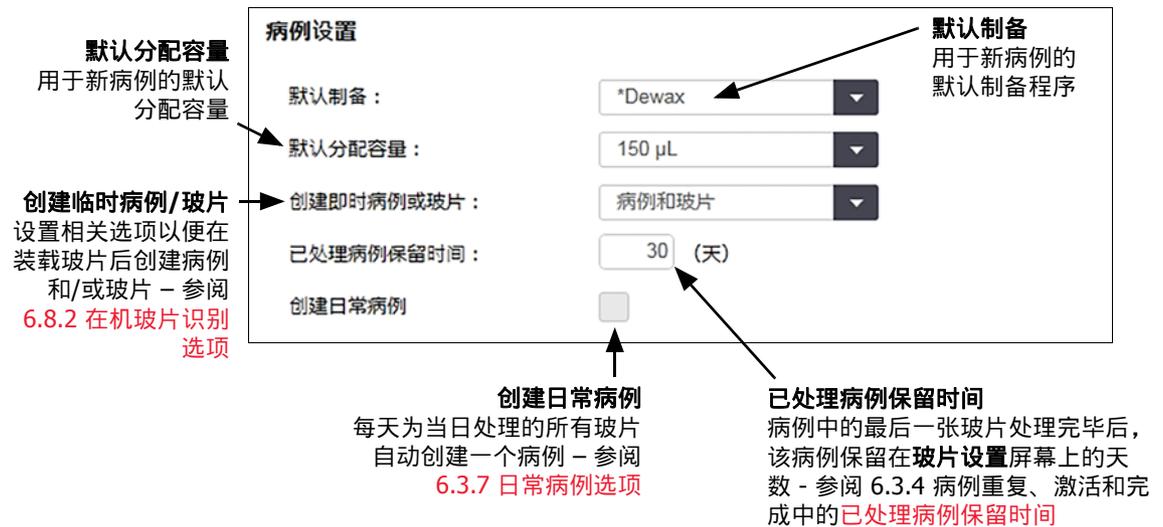


图 95：病例与玻片设置窗格中的病例设置



图 96：病例与玻片设置窗格中的玻片设置

10.5.3 数据库备份

数据库存储重要的患者信息，是正确操作 BOND 所必需的，因此，为了确保在数据库损坏时您能将其恢复，BOND 配备了一个自动和手动备份系统：

- 自动每日备份
- “手动”，应要求备份

所有的备份文件都保存在 BOND 控制器中下列文件夹的子文件夹中：

B:\BOND Drop-box\Backups

每种类型的备份皆生成两个文件，始终采用相同的名称格式：

[科室名称]_BOND_YYYY-MM-DD-HH-mm-ss

其中科室名称是在管理客户端的**设置**屏幕中输入的名称（参阅 [10.5.1 实验室设置](#)）（如果未输入科室名称，则默认为“科室”）。文件名中包含运行备份的日期和时间。主备份文件的扩展名为“.dump”，另有一个日志文件，其扩展名为“.log”。

自动每日备份的运行时间在管理客户端的**设置**屏幕上设置（[10.5.1 实验室设置](#)）。最新的备份位于“Scheduled_Latest”文件夹中。当次日的备份运行后，该文件即被移入“Scheduled_1_Days_Old”文件夹，其后六天皆如此（直至生成“Scheduled_7_Days_Old”文件夹），随后该文件即被删除。

如果 BOND 控制器在预定的备份时间时处于关机状态，则备份将不能运行。确保将备份时间设置在控制器开机并且不大可能进行染色运行的时间内。

您可以从管理客户端的**设置**屏幕中随时运行手动备份（除正运行自动备份时）。在**数据库备份**区域中的**立即备份**（参阅 [10.5.1 实验室设置](#)）。

将出现一个对话框通知您备份结束的时间。备份和日志文件保存在“Manual”文件夹中。在下次手动备份时，该文件将被移入“Manual_Previous”文件夹；第三次手动备份后，该文件则被删除 – 也就是说，仅保存两个最近的手动备份文件。

如果任何一种备份没有成功完成，管理客户端和临床客户端的功能栏右侧将显示一个图标（如右图），并一直显示到备份运行成功后消失。如果出现该图标，尽快尝试进行手动备份。若手动备份也不成功，立即联系客户支持部门。



特别是较早的 BOND 系统，其中会累积更多的数据，因此应不时地检查是否有足够的空间保存备份文件。通常，在写入一个新备份文件的同时会删除一个备份文件，因而硬盘占用量仅会以相对较小的增量增加。但到了某一时间，您可能会需要更多硬盘空间 – 若出现此种情况，请联系客户支持部门。

为进一步保证安全，可定期将备份文件备份到另一个不同位置（BOND 控制器以外）。若有可能，联系您单位的 IT 部门安排进行自动备份。否则，可每周一次（处理量大的实验室应更频繁）手动复制备份文件。BOND 控制器运行一个安全 FTP 服务器，因此 IT 部门可以通过安全 FTP 服务器登录并从 BOND 的下拉菜单文件夹下载备份文件。

如果您需要恢复数据库，请联系客户支持部门。

10.6 硬件



使用**硬件配置**屏幕可对操作仪、仪器组（由一台客户端控制的操作仪组）和玻片标签打印机进行设置。

硬件配置在三个页签中进行：

- [10.6.1 操作仪](#)
- [10.6.2 仪器组](#)
- [10.6.3 玻片标签仪](#)

10.6.1 操作仪

在**操作仪**页签中可查看 BOND 系统中的操作仪，并配置大容量试剂容器。

当一台操作仪通过网线连接至 BOND 控制器时，该操作仪会自动显示在**操作仪**页签的左侧窗格中。

 BOND 控制器仅允许连接兼容的操作仪。如果连接了不兼容的操作仪，会显示一个图标和错误信息（参阅下一页的图标及其含义图表）。

选中该操作仪，其详细信息即显示在页签的右侧。为该操作仪输入一个唯一名称，必要时可禁用某些大容量（参阅下面的**禁用大容量试剂容器**）。保存这些设置后，操作仪即被显示为“已启用”。

该操作仪将保留在页签中，包括仪器关机或断开连接时，直至您将其停止使用（参阅下面的**停止使用操作仪**）。

已连接的所有操作仪

当前选定的操作仪 - 其详细信息显示在屏幕右侧

选定的操作仪的序列号、名称 (可编辑)、IP 地址和仪器类型

大容器设置 - 可以取消选中某些不准备使用的试剂站 - 参阅下面的禁用大容量试剂容器

停止使用
停止使用已选操作仪 - 参阅下面的**停止使用操作仪**

维护完成
在预防性维护后, 点击即可重置天数和玻片计数 - 参阅 **12 清洗和维护 (BOND-III 和 BOND-MAX)** 中的**预防性维护**

保存
必须保存配置的设置, 以便启用新连接的操作仪。
为了保存某台操作仪的配置的设置, 您必须首先确保其所有玻片染色装置均处于未锁定状态。

图 97: 硬件设置屏幕中的操作仪页签

左边窗格中操作仪图像旁边的图标可显示操作仪的各种状态：

图标	含义	图标	含义
	操作仪未连接。		操作仪正在进行维护操作。 如果已连接操作仪与 BOND 系统不兼容，也会显示此图标。
	操作仪正在初始化。		操作仪还未接收到大容量试剂配置。点击 保存 发送配置。
	操作仪当前正在维修。		操作仪已接收到大容量试剂配置。

禁用大容量试剂容器

不使用 BOND 进行抗原修复和/或脱蜡操作的实验室可以在软件中禁用相关的容器，并从仪器中取出这些容器。这样就不必对这些容器及其中的试剂进行维护，且由于通向容器的液流管无需灌注，因而可加快仪器的初始化速度。禁用大容器的方法是，在**大容量设置**窗格中取消选中它们，然后点击**保存**。当出现提示信息时，重启操作仪使更改生效。您可以取出禁用的容器，也可将其留置在仪器中。


停止使用操作仪

如果不再需要某台操作仪，可以停用它，将其从**操作仪**页签上删除。先确认操作仪已关闭，然后在**操作仪**页签中选中它，再点击**停止使用**。如果操作仪仍在仪器组中，被停用时它将自动从仪器组中删除。

若要重新启用操作仪，可再次连接它的网线。

10.6.2 仪器组

仪器组是从单一的临床客户端控制的多台操作仪 (和玻片标签打印机) 的组合 – 参阅 [3.1 系统构架](#)。即便对于所有操作仪都由 BOND 控制器控制的单座安装, 也可创建仪器组。仪器组的创建和编辑在 [仪器组](#) 页签中进行。

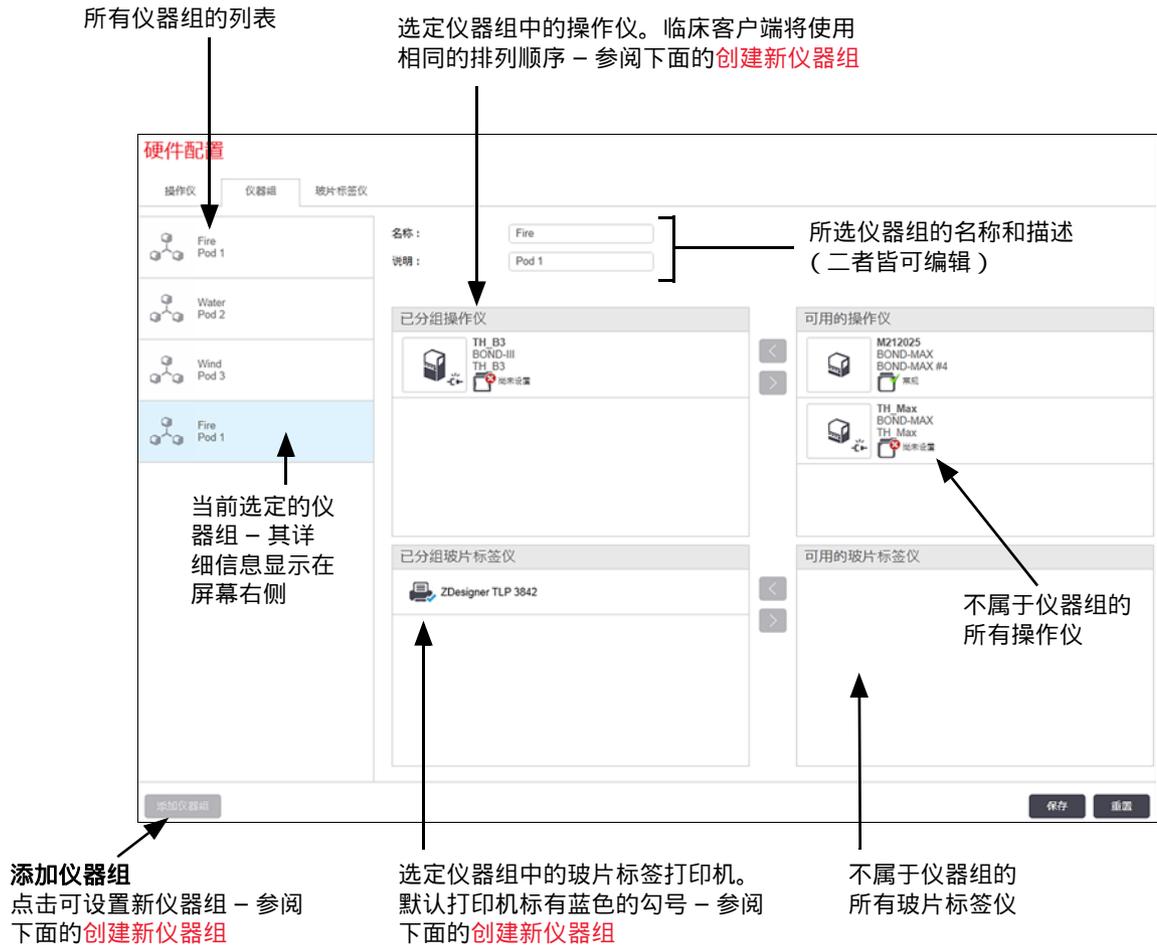

删除

右键点击空仪器组, 然后点击 [删除](#) 即可删除该仪器组

图 98: 硬件配置屏幕中的仪器组页签

若要将操作仪列入某个仪器组, 可在 [操作仪](#) 页签中进行设置 (见上面的 [操作仪](#))。若要将玻片标签仪列入仪器组, 则在 [玻片标签仪](#) 页签中对其进行设置 (参阅下面的 [玻片标签仪](#))。

创建新仪器组

1. 点击**添加仪器组**。
2. 输入一个唯一的仪器组名称，描述字段可选填。
3. 在**可用的操作仪**窗格（右上方）中选择操作仪，然后单击左箭头按钮  将其添加到**已分组操作仪**窗格（左上方）中。

如果要添加多台仪器，则按照您希望在临床客户端显示的页签顺序添加。例如，如果先选择仪器 A，然后选择仪器 B，那么在连接至仪器组的客户端的窗格中和**系统状态**页签中，A 将显示在 B 的上方。若要重新排列操作仪顺序，用右箭头按钮  将其删除，然后按正确顺序重新添加。

4. 从**可用的玻片标签仪**窗格（右下方）中选择一台或多台玻片标签打印机，添加到**已分组玻片标签仪**窗格（左下方）中。

如果添加多台打印机，这些打印机都可选择用于打印玻片。可右键点击打印机并点击**设为默认打印机**，将其设为默认打印机。默认打印机带有蓝色的勾号。
5. 点击**保存**。

若想删除仪器组，先删除组中的全部操作仪和打印机，然后右键点击左侧窗格中的仪器组，再点击**删除**。

10.6.3 玻片标签仪

用于 BOND 系统的玻片标签仪必须在管理客户端**硬件配置**屏幕的**玻片标签仪**页签中进行定位、识别和激活，这样才能将它们列入仪器组中（参阅上面的**仪器组**）。

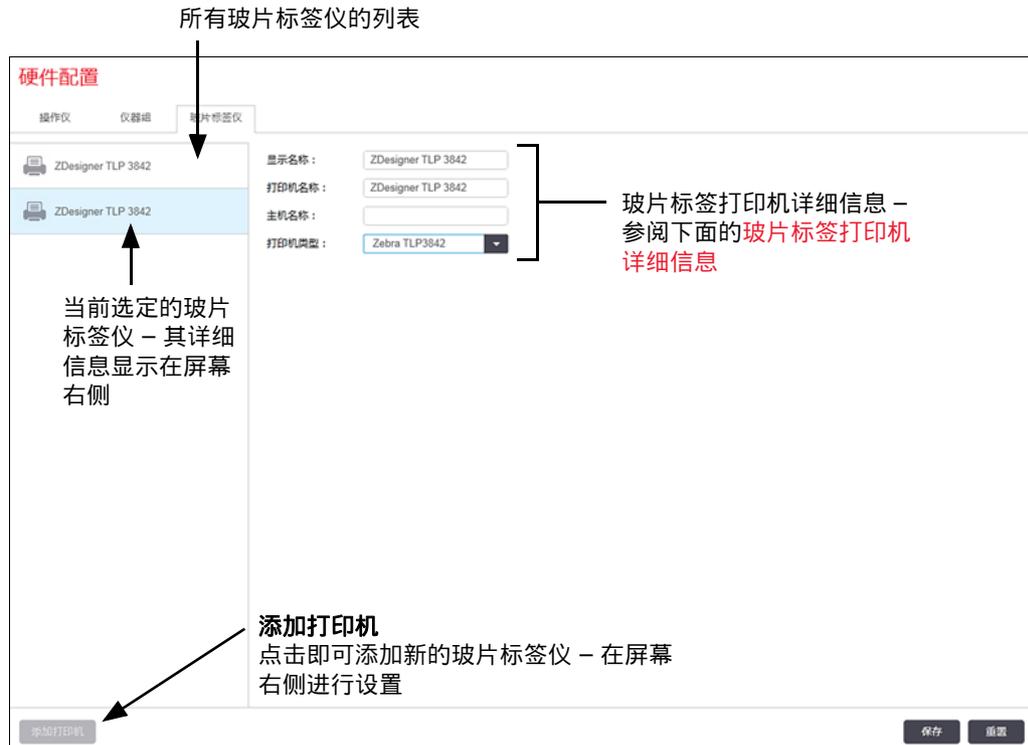


图 99: 硬件设置屏幕中的玻片标签仪页签

若要使新连接的玻片标签仪能被列入仪器组，点击**添加打印机**，然后在屏幕右侧输入打印机详细信息。

- i** 并非所有安装都有仪器组。如果存在没有仪器组的情况，则默认打印机就是列表中的第一台打印机。
- i** 如果更换了玻片标签仪，您无需添加新标签仪 - 可以将原标签仪的详细信息替换为新标签仪的详细信息。

如要从列表中移除标签仪，右键单击它并选择**删除**。

玻片标签打印机详细信息

BOND 每台玻片标签打印机要求输入以下详细信息：

- **显示名称：**将显示在 BOND 软件中的标签仪名称
- **打印机名称：**Windows 使用的打印机名称

i BOND-ADVANCE 安装中的打印机名称实际上就是显示在 Windows **打印机和传真**对话框中的打印机的**共享名称**。

- **主机名称：**除非是 **Zebra** 打印机（例如，**ZDesigner TLP 3842**，此时输入玻片标签仪所连接的终端的**计算机名称**），否则在 BOND-ADVANCE 安装中保留空白。

i 可在 Windows **系统** 对话框内查看**计算机名称**（参阅图 100）。

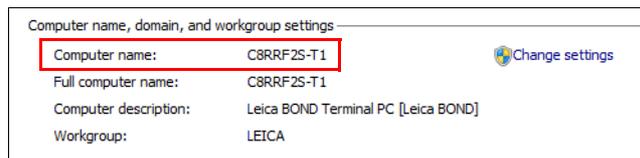


图 100: Windows 系统对话框中的计算机名称

- **打印机类型：**打印机型号（例如，**ZDesigner TLP 3842**）

打印测试标签

检查打印图像是否对齐：



1. 在管理客户端打开**标签**屏幕。
2. 在左边的模板中选择一个标签，然后单击**打印**。

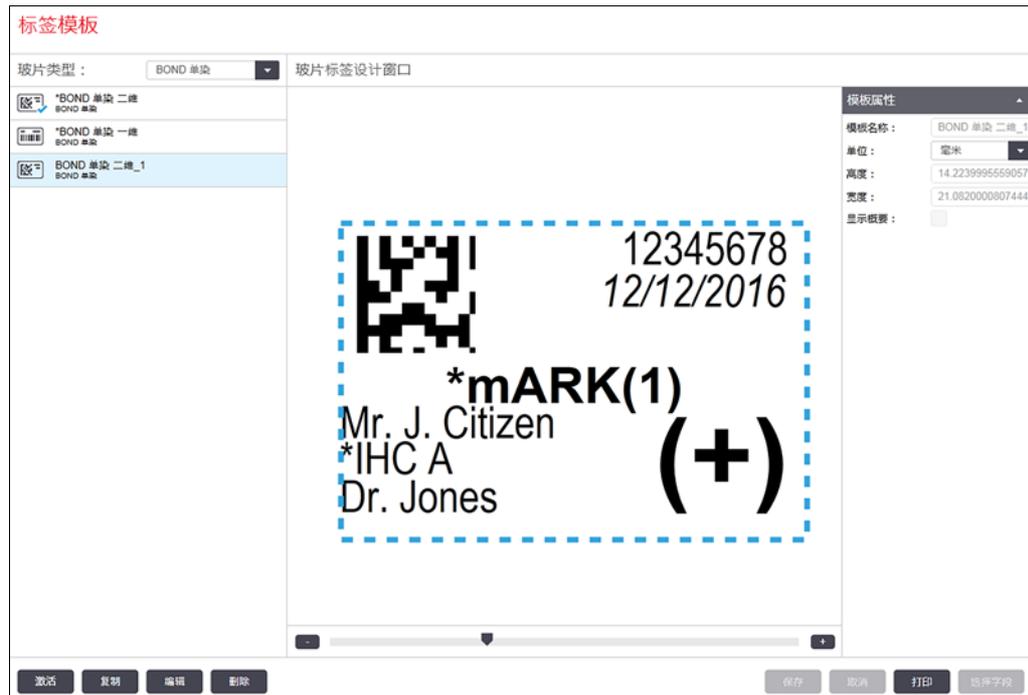


图 101: 打印一个测试标签

3. 在**选择打印机**对话框中选择相关的打印机，然后单击**打印**。
4. 重复步骤 3 三至五次，确保所有的字符都能清晰准确地被打印在标签上。
5. 如果标签上的图像位置不正确，请参阅[调整 Zebra 打印机校准](#)或[调整 Cognitive 打印机校准](#)。

调整 Zebra 打印机校准

- i** 以下程序适用于两种类型的 Zebra 打印机：TLP 3842 或 GX430t。两者的一些差异会在相关设置中进行描述。
- i** 对于 BOND-ADVANCE 安装，在 BOND-ADVANCE 终端执行以下程序。
 1. 在 Windows 任务栏中点击**开始按钮**，然后选择**设备和打印机**。
 2. 右键单击打印机图标（例如，**ZDesigner TLP 3842**），然后选择**打印机属性**。
系统会显示如图 102 所示的“打印机属性”对话框。



图 102：打印机属性

3. 选择**高级**页签。



图 103: 打印机属性 – 高级页签

4. 单击打印默认值...按钮。

系统会显示如图 104 所示的“打印默认值”对话框。

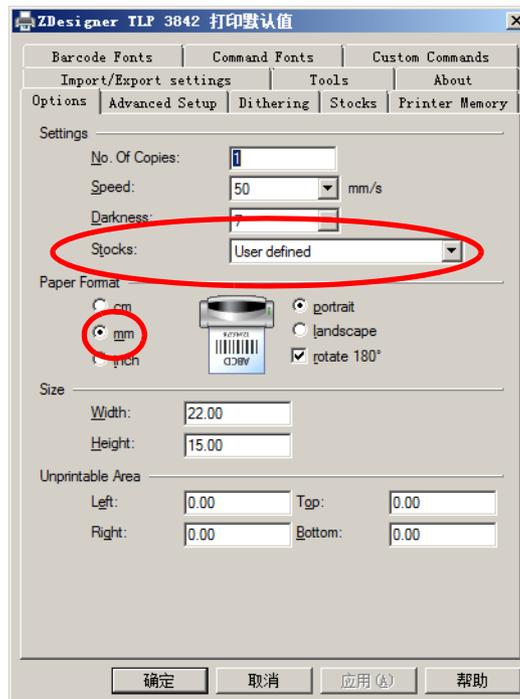


图 104: 打印默认值

- i** 本文件所述的打印机设置以毫米为单位，因此，请将纸张格式设置为毫米。
- 从备用标签下拉列表中选择“BOND 玻片标签”。
 - 选择**备用标签**页签。

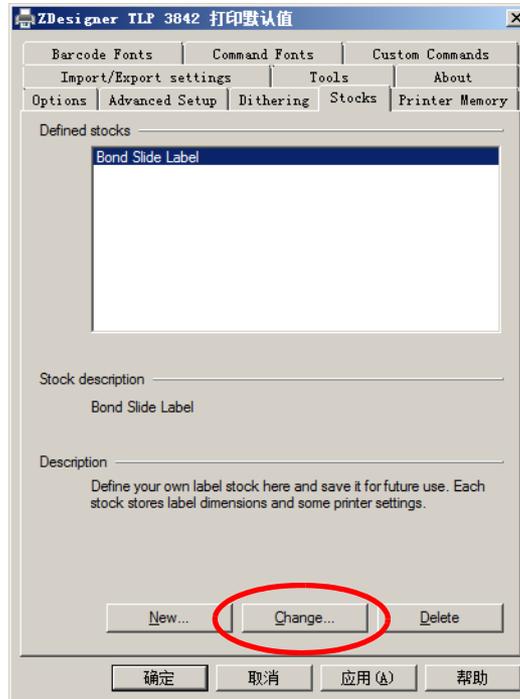


图 105: 打印默认值 – 备用标签页签

- 点击**更改...**按钮。

系统将显示如图 106 所示的**定义备用标签**窗口。

在更改设置之前，建议将打印机恢复至下表所示的默认设置，并打印一些测试标签。

	TLP 3842	GX430t
标签宽度	24.00 毫米	40.00 毫米
标签高度	15.50 毫米	15.00 毫米
非打印区 – 左侧	0.00 毫米	4.50 毫米
非打印区 – 右侧	1.50 毫米	0.00 毫米

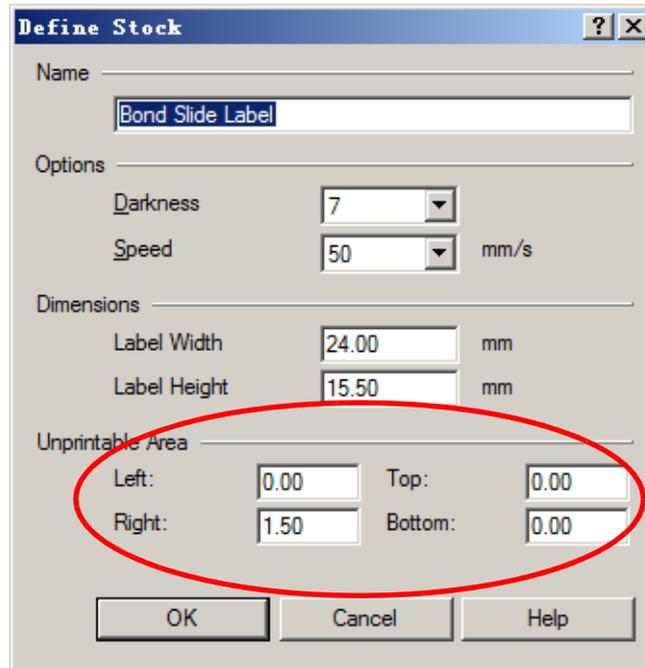


图 106: 定义备用标签对话框

- 如果图像的左侧边缘超出标签，则稍稍降低非打印区条目下的右侧的数值，例如，从 1.50 毫米降低至 1.00 毫米。
 - 如果图像的右侧边缘超出标签，则稍稍增高非打印区条目下的右侧的数值，例如，从 1.50 毫米增高至 2.00 毫米。
8. 点击**确定**。
 9. 重复标签的打印和调整程序直至打印的标签符合要求（没有打印内容超出边缘的情况）。



单击**确定**后，可能会出现这样一条报错信息：**Stock name already used by system form database**，如果出现这种情况，请更改如所示的图 107 定义备用标签对话框中的名称，然后单击**确定**。

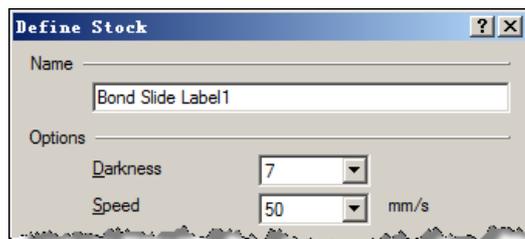


图 107: 重命名备用标签

调整 Cognitive 打印机校准

i 在 BOND-ADVANCE 安装中，以 BONDDashboard 用户名登录 BOND-ADVANCE 控制器。如果看板当前正显示，则按下 **Alt+F4** 键进行关闭。

1. 在 Windows 任务栏中点击**开始按钮**，然后选择**设备和打印机**。
2. 右键单击打印机图标（例如，**Cognitive Terminal 1**），然后选择**打印机属性**。



图 108: 选择打印机属性

i 不要选择**打印参数**，虽然对话框很相似，但设置更新不正确。系统会显示如图 109 所示的 **Cognitive Printer Properties** 对话框。



图 109: Cognitive Printer Properties

3. 选择**高级**页签。

系统会显示如图 110 所示的高级页签。



图 110: 高级页签

4. 点击打印默认值...按钮。

系统会显示如图 111 所示的“打印默认值”对话框。

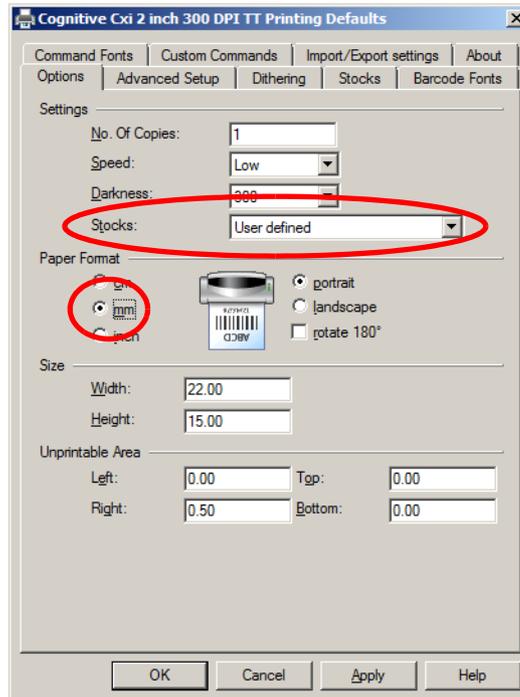


图 111: 打印默认值对话框

- i** 本文件所述的打印机设置以毫米为单位，因此，请将纸张格式设置为毫米。
- 从备用标签下拉列表中选择“BOND 玻片标签”。
 - 选择**备用标签**页签。

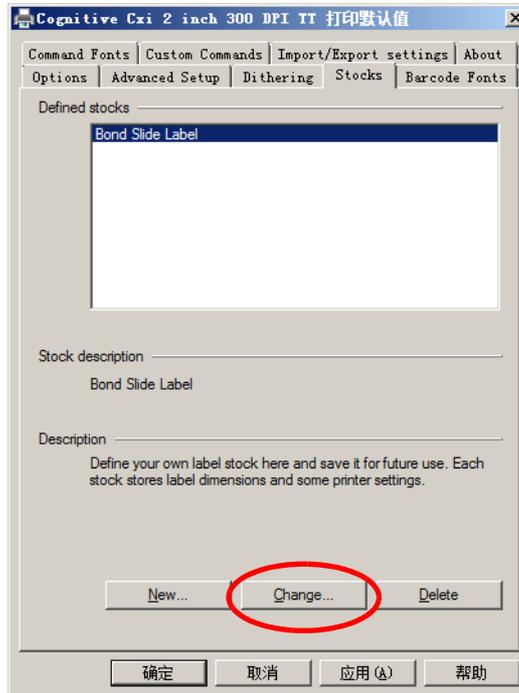


图 112: 打印默认值 – 备用标签页签

- 点击**更改...** 按钮。
系统会显示如图 113 所示的**定义备用标签**对话框。

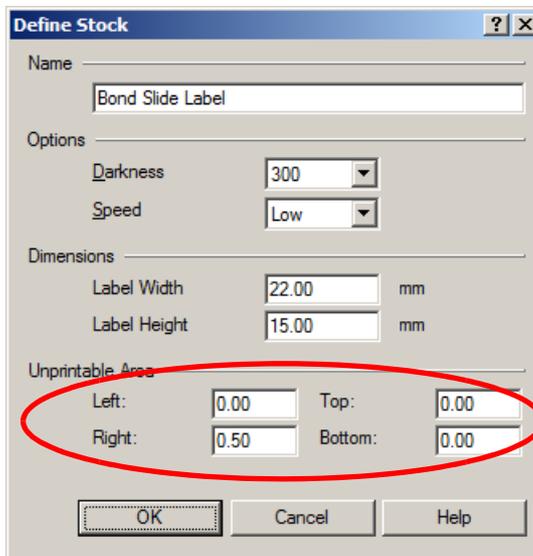


图 113: 定义备用标签对话框

- 如果图像的左侧边缘超出标签，则稍稍降低非打印区条目下的右侧的数值，例如，从 0.50 毫米降低至 0.30 毫米。
- 如果图像的右侧边缘超出标签，则稍稍增高非打印区条目下的右侧的数值，例如，从 0.50 毫米增高至 0.70 毫米。
- 如果图像的顶部或底部超出标签，请参阅在 [Cognitive Cxi 打印机上调整标签的垂直位置](#)。

8. 点击**确定**。



单击**确定**后，可能会出现这样一条报错信息：**Stock name already used by system form database**，如果出现这种情况，请更改如所示的图 114 定义备用标签对话框中的名称，然后单击**确定**。



图 114: 重命名备用标签

9. 打印一张标签以检查设置的结果。重复该程序直至标签符合要求（没有打印内容超出边缘的情况）。

在 **Cognitive Cxi** 打印机上调整标签的垂直位置

如果标签的位置太高或太低，在如图 115 所示的打印默认值设置对话框中选择**高级设置**页签。

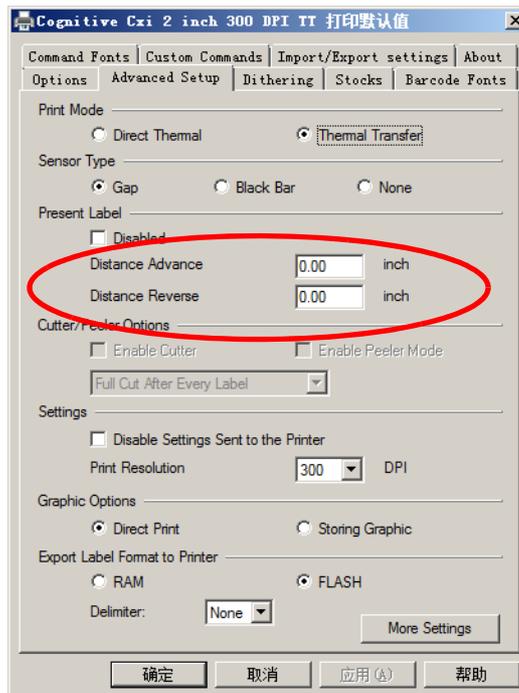


图 115: 高级设置页签

- 如果图像顶部超出边缘，则稍稍增高**当前标签**条目下**前进距离**的值，例如，从 0.00 毫米增加至 1.00 毫米。
- 如果图像底部超出边缘，则稍稍增高**当前标签**条目下**后退距离**的值，例如，从 0.00 毫米增高至 1.00 毫米。

 这些调整仅能用于一个设置。如果**前进距离**中已有一个数值，而图像底部超出边缘，则降低**前进距离**的数值，而不要增高**后退距离**的数值。保持一个数值为零，然后用另一个数值来调整标签位置。

10. 点击**确定**。

11. 打印一张标签以检查设置的结果。重复该程序直至标签符合要求（没有打印内容超出边缘的情况）。

11

实验室信息系统（LIS）集成组件（在 BOND 控制器上）

可选的 BOND 实验室信息系统 (LIS) 集成组件 (LIS-ip) 能将 BOND 系统连接至任何兼容的实验室信息系统 (LIS)。LIS-ip 将病例和玻片信息从实验室信息系统 (LIS) 传送给 BOND 系统，BOND 系统则通过 LIS-ip 将操作信息返回给实验室信息系统 (LIS)。

LIS-ip 可设置性很高，能与多种不同类型的实验室信息系统 (LIS) 和实验室工作流程配合操作。LIS-ip 经设置后可提供实验室信息系统 (LIS) 和 BOND 系统之间的无缝集成，使得实验室信息系统 (LIS) 玻片能被自动识别，从而免除了为玻片重贴标签的需要。参阅 [11.8 工作流程](#) 对可用工作流程的概述。

Leica Biosystems 可安排针对各种安装的综合性培训。

有关 BOND LIS-ip 信息，请参阅以下章节：

- 与 LIS-ip 操作有关的术语
参阅 [11.1 实验室信息系统（LIS）术语](#)
- 软件附加功能的详细说明
参阅 [11.2 软件的附加性能](#)
- 实验室信息系统（LIS）连接与设置概述
参阅 [11.3 实验室信息系统（LIS）连接与初始化](#)
- 实验室信息系统（LIS）错误指示及校正说明
参阅 [11.4 实验室信息系统（LIS）通知](#)
- 病例及玻片数据参照表
参阅 [11.5 病例及玻片数据要求](#)
- 对 BOND LIS-ip 能报告给实验室信息系统（LIS）的玻片状态数据的描述
参阅 [11.6 将玻片数据发送回实验室信息系统（LIS）](#)
- 玻片标签要求参考说明
参阅 [11.7 玻片标签](#)
- 典型的实验室信息系统（LIS）操作概述
参阅 [11.8 工作流程](#)。

11.1 实验室信息系统 (LIS) 术语

要说明实验室信息系统 (LIS) 的功能性并区分普通的 BOND 元件和实验室信息系统 (LIS) 元件, 需要用到许多新术语。这些术语的说明见下表。

- LIS – 实验室信息系统。即管理实验室工作信息的软件。
- LIS-ip – BOND 实验室信息系统 (LIS) 集成组件。可选的附加组件, 使 BOND 系统能够同实验室信息系统 (LIS) 联合操作。
- LIS 玻片 - 由实验室信息系统 (LIS) 创建并发送给 BOND 系统处理的玻片。
- LIS 病例 - 由实验室信息系统 (LIS) 创建并发送至 BOND 系统的病例。
- 自动 ID 玻片标签 – 能被 BOND 系统自动识别的玻片标签。这些标签可以是 BOND 打印的, 也可以是实验室信息系统 (LIS) 打印的, 只要其使用的是可识别的条形码格式。参阅 [11.3 实验室信息系统 \(LIS\) 连接与初始化](#)。
- 辅助 ID 玻片标签 – 不能被 BOND 自动识别的任何玻片标签。
- LIS 玻片标签 – 由连接至实验室信息系统 (LIS) 的打印机打印的标签。实验室信息系统 (LIS) 玻片标签显示实验室信息系统 (LIS) 条形码以及在实验室信息系统 (LIS) 中为标签设置的任何其他信息。
- BOND-LIS 玻片标签 – 玻片在实验室信息系统 (LIS) 中创建, 但其标签在连接至 BOND 的打印机上打印的玻片标签。BOND-LIS 标签采用 BOND 实验室信息系统 (LIS) 玻片标签设置, 该设置可在 BOND 中编辑。
- 登记号 – 常用的实验室信息系统 (LIS) 术语, 指用于识别某个特定病例的数字或其他 ID。登记号相当于 BOND 的“病例 ID”。
- 患者数据 – 构成 BOND 系统中的“病例”的患者详细信息。
- 人口统计学数据 – 指患者数据或病例数据的常用实验室信息系统 (LIS) 术语。
- LIS 条形码 – 由实验室信息系统 (LIS) 指定的能专一性识别各实验室信息系统 (LIS) 玻片的条形码。

11.2 软件的附加性能

兼容实验室信息系统 (LIS) 的 BOND 系统具有标准版本所不具备的额外的软件性能。BOND LIS-ip 系统保留了标准 BOND 软件的所有特性和功能。

参阅:

- [11.2.1 实验室信息系统 \(LIS\) 状态图标](#)
- [11.2.2 实验室信息系统 \(LIS\) 病例](#)
- [11.2.3 实验室信息系统 \(LIS\) 玻片](#)
- [11.2.4 通用标记名称](#)
- [11.2.5 优先玻片](#)
- [11.2.6 实验室信息系统 \(LIS\) 玻片数据字段](#)
- [11.7 玻片标签](#)

11.2.1 实验室信息系统 (LIS) 状态图标



图 116: BOND 软件屏幕右上角的实验室信息系统 (LIS) 状态图标

BOND 具备 LIS-ip 的软件含有实验室信息系统 (LIS) 状态图标, 该图标位于标准功能栏的最右端, 它显示以下信息:

- 实验室信息系统 (LIS) 连接状态 (参阅 [11.3 实验室信息系统 \(LIS\) 连接与初始化](#))
- 实验室信息系统 (LIS) 错误指示 (参阅 [11.4 实验室信息系统 \(LIS\) 通知](#))

11.2.2 实验室信息系统 (LIS) 病例

实验室信息系统 (LIS) 病例是在实验室信息系统 (LIS) 中创建后发送至 BOND 的病例。反之, BOND 病例是在 BOND 中创建的病例。

- 实验室信息系统 (LIS) 病例与 BOND 病例具有相同的属性字段, 但当病例被发送至 BOND 后, 其中的信息即无法编辑。
- BOND 系统自动为每一个实验室信息系统 (LIS) 病例分配一个唯一的病例号。
- 实验室信息系统 (LIS) 登记号或病例 ID 在 BOND 中即为病例 ID。
如果该病例 ID 与原有的 BOND 病例的病例 ID 相同, 则新的实验室信息系统 (LIS) 病例会被拒绝。您必须在实验室信息系统 (LIS) 中更改病例 ID。
- 如果新实验室信息系统 (LIS) 病例的病例 ID 和患者姓名与早已列在**玻片设置**屏幕上的某个实验室信息系统 (LIS) 病例相同, 则原有病例会被自动使用, 而“新”病例中的玻片会被添加到现有病例中。如果病例 ID 相同但患者姓名不同, 则新病例会被拒绝。
- 如果实验室信息系统 (LIS) 病例的病例 ID 和患者姓名与 BOND 中已过期或删除的实验室信息系统 (LIS) 病例相同, 那么, 或者原有病例被恢复, 或者新病例被拒绝, 具体取决于您在管理客户端实验室信息系统 (LIS) 屏幕中的设置 (参阅 [10.2 实验室信息系统 \(LIS\) 中的重复病例 ID](#))。
- 用 BOND 软件添加到实验室信息系统 (LIS) 病例的玻片被创建为 BOND 玻片。
- 实验室信息系统 (LIS) 病例与 BOND 病例具有相同的默认制备程序和分配容量, 这些内容在管理客户端进行设置 (参阅 [10.5.2 病例与玻片设置](#))。

11.2.3 实验室信息系统 (LIS) 玻片

实验室信息系统 (LIS) 玻片是在实验室信息系统 (LIS) 中创建后发送至 BOND 的玻片。反之, BOND 玻片是在 BOND 中创建的玻片, 无论是 BOND 病例还是实验室信息系统 (LIS) 病例。

实验室信息系统 (LIS) 玻片在玻片列表中可通过其标签颜色加以识别: 实验室信息系统 (LIS) 玻片有灰色标签。

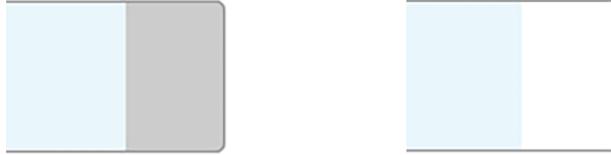


图 117: 实验室信息系统 (LIS) 玻片 (左) 和常规单染 BOND 玻片 (右)

以下几点适用于实验室信息系统 (LIS) 玻片:

- 由实验室信息系统 (LIS) 打印的标签通常含有一个条形码。只要此条形码采用 BOND 支持的六种格式之一, 且 BOND 经设置后能读取该格式, BOND 就能在玻片被载入时识别它。参阅 [11.3 实验室信息系统 \(LIS\) 连接与初始化](#)。
- 用 BOND 打印的实验室信息系统 (LIS) 玻片标签采用 BOND 实验室信息系统 (LIS) 玻片标签设置。参阅 [10.3 标签](#)。
- 实验室信息系统 (LIS) 玻片可包括附加的实验室信息系统 (LIS) 特异字段。参阅 [11.2.6 实验室信息系统 \(LIS\) 玻片数据字段](#)。
- 由实验室信息系统 (LIS) 创建的玻片属性不能用 BOND 软件编辑。
- 当使用 BOND 软件复制实验室信息系统 (LIS) 玻片时, 复制的玻片被创建为 BOND 玻片并使用 BOND 玻片标签设置, 所有实验室信息系统 (LIS) 特异字段都被移除, 且所有字段皆可编辑。

11.2.4 通用标记名称

通用标记名称 (用于一抗和探针) 可以将实验室信息系统 (LIS) 指定的标记与 BOND 系统中登记的标记关联起来。当实验室信息系统 (LIS) 为某项检测指定了一种标记时, BOND 系统就会在该项检测中使用有同一通用标记名称的试剂。如果没有对应于实验室信息系统 (LIS) 标记名称的通用名, 则 BOND 系统将拒绝实验室信息系统 (LIS) 指定的检测。

通用标记名称是在 [编辑试剂属性](#) 对话框中用 [通用名字段](#) 指定的 (参阅 [8.2 试剂设置屏幕](#))。该字段仅在安装了 LIS-ip 时才显示。

每个通用名都必须是唯一的。通用名可随时在 BOND 试剂之间互换, 而已创建的玻片不会受影响。

11.2.5 优先玻片

实验室信息系统 (LIS) 可以指定需要紧急处理的优先玻片。包含优先玻片的病例在**玻片设置**屏幕上带有红色条。

病例 ID	患者姓名	医生姓名	玻片数
LS0012 - 45216	Shady, Albert	Joseph	1
20130416-ISHRefine	Benjamin Hightower	Kevin Pannell	10
20130416-IHC	Fannie Hurley	Arthur Josey	10

图 118: 玻片设置屏幕上用红色突出显示的有优先玻片的病例

i 目前, 实验室信息系统 (LIS) 优先病例最初被添加在列表底部, 仅在随后的临床客户端屏幕会话中才显示在列表顶部。

优先玻片标有红色字母“P”。



图 119: 显示在玻片设置屏幕上的优先实验室信息系统 (LIS) 玻片

11.2.6 实验室信息系统 (LIS) 玻片数据字段

除了标准玻片属性以外, BOND LIS-ip 还有七个可设置的数据字段, 通过对它们进行设置, 可以显示从实验室信息系统 (LIS) 选取的信息。其基本连接由 Leica Biosystems 的服务代表在安装期间建立, 但在实际使用中, 用户可以选择是否显示这些字段, 并可设置各个字段的名称 – 参阅 10.2 实验室信息系统 (LIS) 中的[实验室信息系统 \(LIS\) 玻片数据字段](#)。

这些字段显示在**玻片属性**对话框中一个专用的 **LIS** 页签上, 也可以打印在玻片标签上 (参阅 [10.3 标签](#))。它们仅用于报告, 对仪器操作没有影响。

11.3 实验室信息系统 (LIS) 连接与初始化

每个 BOND LIS-ip 组件必须由 Leica Biosystems 的授权代表安装, 安装人员会按照每个实验室的要求对操作进行定制。

BOND 系统可被设置为读取以下六种条形码格式:

一维条形码	二维条形码
Code 128 	QR 码 
Code 39 	Aztec 码 
Interleaved 2 of 5 交叉二五条码  1234567890	Data Matrix 码 

当安装了实验室信息系统 (LIS) 组件后, 一个实验室信息系统 (LIS) 图标将出现在 BOND 软件屏幕的右上角, 以显示连接状态 (图 120)



图 120: 实验室信息系统 (LIS) 未连接 (左) 和已连接 (右)

11.4 实验室信息系统 (LIS) 通知

BOND 通过显示 BOND 软件屏幕右上角的实验室信息系统 (LIS) 状态图标来指示实验室信息系统 (LIS) 连接或数据错误 (参阅 11.2.1 实验室信息系统 (LIS) 状态图标)。如果存在未解决的实验室信息系统 (LIS) 通知, 则标有未解决的通知数量的一个计数器会显示出来。当发生新的通知事件时, 计数器会短暂闪烁。



图 121: 实验室信息系统 (LIS) 状态图标

若要查找通知的详细信息, 右键单击状态图标, 选择**显示 LIS 报告**以打开 **LIS 服务事件**对话框。该对话框显示错误信息和任何未发送成功的玻片, 并列出错原因。典型的实验室信息系统 (LIS) 错误包括丢失数据、数据冲突 (例如, 同一登记号被用于不同病例)、或通用标记未在 BOND 系统中登记等情况 (参阅 11.2.4 通用标记名称)。

ID	日期	事件号	详细信息	信息	
1...	2017/1/24 14:33	7012	病例 ID LS0012-45210 患者 ID PID120 医生 ID Dr Jones 标记 ID GFAP 标记2 ID 组织类型 test 信息 ID 002.1 条形码 88820	无法添加实验室信息系统 (LIS) 玻片 - 条形码已被使用	确认
1...	2017/1/24 14:34	7007	病例 ID LS0012-45210 患者 ID PID120 医生 ID Dr Jones 标记 ID GFAP 标记2 ID 组织类型 tesst 信息 ID 002.1 条形码 88820	无法映射组织类型	确认
1...	2017/1/24 14:35	7006	病例 ID LS0012-45210 患者 ID PID120 医生 ID Dr Jones 标记 ID GFAP	标记不存在	确认

关闭

图 122: LIS 服务事件对话框

根据实验室信息系统 (LIS) 设置, 可以对错误进行更正并重新提交病例或玻片。当实验室信息系统 (LIS) 不能重新发送信息时, 可以用 BOND 软件直接创建病例或玻片。

阅读完每条错误信息后, 点击相关的“**确认**”按钮将该条通知从对话框中删除。

当对话框中的所有错误信息均被清除后, 通知计数器会从屏幕上消失。

i 如有需要, 您仍可在实验室信息系统 (LIS) 服务日志中查看这些信息, 方法是先点击管理客户端屏幕右上方的 Leica Biosystems 标志, 以显示关于 **BOND** 对话框, 然后点击**服务日志**, 并在**序列号**下拉列表中选择 ***LIS***。也可以设定一个时间范围, 然后点击**生成**即可生成实验室信息系统 (LIS) 服务日志。

11.5 病例及玻片数据要求

BOND 从实验室信息系统 (LIS) 导入病例和玻片时所需的数据在以下章节中提供 (参阅 [11.5.1 病例数据](#) 和 [11.5.2 玻片数据](#))。

 实验室信息系统 (LIS) 病例和玻片中的数据不能在 BOND 中更改, 但玻片注释除外。

11.5.1 病例数据

必选字段

BOND 字段名称	描述	常用实验室信息系统 (LIS) 术语
• 病例 ID	• 标识病例的数字或名称	<ul style="list-style-type: none"> • 登记号 • 序号

可选字段

BOND 字段名称	描述	常用实验室信息系统 (LIS) 术语
• 患者姓名	• 患者的姓名	<ul style="list-style-type: none"> • 患者姓名 • 实验室指定 ID (labAssId)
• 医生	• 送检医师	<ul style="list-style-type: none"> • 医生姓名和 / 或 ID • 主治医师 • 开单医生

11.5.2 玻片数据

必选字段

BOND 字段名称	描述	常用实验室信息系统 (LIS) 术语	注释
<ul style="list-style-type: none"> 标记 	<ul style="list-style-type: none"> 一抗 (IHC) 或探针 (ISH) 	<ul style="list-style-type: none"> 一抗 (IHC) 探针 (ISH) 标记 (任一) 染色 	<ul style="list-style-type: none"> 通用名可以关联实验室信息系统 (LIS) 指定的标记和 BOND 系统中登记的标记。必须为每个将在实验室信息系统 (LIS) 中指定的标记指定一个通用名。参阅 11.2.4 通用标记名称。 每个标记都有默认染色程序和预处理程序, 需要时可在 BOND 中更改。

可选字段

BOND 字段名称	描述	常用实验室信息系统 (LIS) 术语	注释
<ul style="list-style-type: none"> [LIS 条形码] <p>注: 用户在 BOND 中看不到此条形码 BOND</p>	<ul style="list-style-type: none"> 给予每张实验室信息系统 (LIS) 玻片的唯一 ID 条形码 (已删除玻片的 ID 不能再次使用) 	<ul style="list-style-type: none"> 条形码 	<ul style="list-style-type: none"> 必须提供完整的 ID 条形码以便 BOND 识别玻片。这在使用实验室信息系统 (LIS) 工作流程 1 时是必需的 (参阅 11.8 工作流程)。
<ul style="list-style-type: none"> 组织类型 	<ul style="list-style-type: none"> 检测或对照组织 (阳性或阴性) 	<ul style="list-style-type: none"> 检测类型 	<ul style="list-style-type: none"> 如果 LIS 未提供该信息, 则默认为“检测”。参阅 6.2.1 对照组织。
<ul style="list-style-type: none"> 注释 	<ul style="list-style-type: none"> 与玻片有关的注释或指示 	<ul style="list-style-type: none"> 注释 	<ul style="list-style-type: none"> 如果实验室信息系统 (LIS) 发送了一个针对实验室信息系统 (LIS) 玻片的更新, 则所有新的玻片注释将被添加到已有的玻片注释内。

11.6 将玻片数据发送回实验室信息系统 (LIS)

BOND LIS-ip 能将玻片状态报告给实验室信息系统 (LIS)。BOND LIS-ip 可报告的信息如下：

- 玻片已创建 – 已在 BOND 软件中创建了指定玻片
- 玻片已打印 – 已为指定玻片打印了标签
- 玻片正在处理 – 指定玻片正在进行染色处理
- 玻片已处理 – 指定玻片已完成染色处理 (有或没有错误)
- 玻片已删除 – 指定玻片已从 BOND 系统中删除。

11.7 玻片标签

每个实体玻片都需要有一个识别标签，以便同正确的病例和检测信息相匹配。在最便捷的工作流程中，实验室信息系统 (LIS) 玻片的标签由实验室信息系统 (LIS) 打印 (“LIS 玻片标签”)，且这些标签可在 BOND 中被识别。不过，可以如此操作的前提是：

1. 实验室信息系统 (LIS) 将每个玻片的唯一条形码提供给 BOND，并且
2. 实验室信息系统 (LIS) 打印机使用 BOND 支持的六种条形码格式之一。

如果您的实验室信息系统 (LIS) 达不到这些要求，BOND 可以创建自己的实验室信息系统 (LIS) 玻片标签 - “BOND-LIS 玻片标签”。在这种情况下，可以选择对 BOND 进行设置，使其仅处理已由 BOND 打印标签的实验室信息系统 (LIS) 玻片。该设置在管理客户端的 **LIS** 屏幕中进行 – 参阅 [10.2 实验室信息系统 \(LIS\)](#)。

另外，也可使用来自第三方标签仪打印的标签或手写标签。这些标签需要在 BOND 上进行人工识别，然后才能处理 (参阅 5.1.5 在机玻片识别中的[在机手动玻片识别](#))。

11.8 工作流程

尽管每台 LIS-ip 设备都经过具体的定制，根据主要的 LIS-ip 选项对 BOND LIS-ip 工作流程作一些基本的说明仍是有帮助的。下表给出了四种工作流程。也可使用其他工作流程。针对各种安装可提供现场综合培训。

工作流程	来自实验室信息系统 (LIS) 的数据	输入的数据 BOND	标签打印于	识别方式
1.	病例和玻片数据 (利用实验室信息系统 (LIS) 条形码)	无	实验室信息系统 (LIS)	自动
2.	病例及玻片数据	无	BOND	自动
3.		其他玻片	BOND	自动
4.		无	外来	辅助

工作流程 1 是最方便的，因为它提供了实验室信息系统 (LIS) 和 BOND 系统间的无缝集成。BOND 能自动识别实验室信息系统 (LIS) 玻片，并且能够立即开始操作而无需重贴玻片标签或输入额外的信息。

12

清洗和维护（BOND-III 和 BOND-MAX）



在执行清洗或维护任务时，应确保将操作仪关闭（进行抽吸探针清洗或大用量液流自控装置清洗时除外）。



免疫组织化学和原位杂交中使用的某些试剂具有危害性。继续操作前应确保您已接受过足够的有关此操作的培训：

- a) 穿戴好乳胶或丁腈手套、防护眼镜及其他合适的防护服，然后再接触试剂或清洗仪器。
- b) 使用和处理试剂及浓缩物时应遵从所有相关的实验室科室操作程序和政府法规。



操作仪有加热器和受热表面，如果附近放有易燃物，可能有引燃危险：

不要将易燃物放在加热器上或其附近。

不要将易燃物放在操作仪的任何发热表面上。

重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。



避免接触玻片染色装置及其周围区域。这些部位可能非常热，会导致严重烫伤。操作停止后应等待二十分钟时间让玻片染色装置及其周围区域冷却。



仅能用手清洁所有的可移除组件。为避免损坏，不要用自动碗碟机清洗任何组件；不要用溶剂、强效或磨蚀性清洁液或者粗糙或磨砂类织物清洁任何零部件。

本章提供清洁和维护的步骤说明。在临床客户端中有一个用于维护系统中多台操作仪的维护屏幕。点击主窗口左侧的操作仪页签即可显示该仪器的**系统状态**屏幕，然后点击**维护**页签。更多信息可参阅 [5.3 维护屏幕](#)。每次使用 BOND 系统时，应注意是否有泄漏、磨损或损坏的部位。如果本章中有关于修理或更换磨损或故障部件的说明，应按这些说明操作。否则，请联系客户支持部门。

设备使用期限为7年。本产品使用期限根据企业上市后使用情况数据确定的。在使用过程中，用户应当按照产品说明书的要求对产品进行维护、保养或维修后，经确认仍能保持基本安全和有效性的产品，可以正常使用。请遵循本章中的维护和清洁说明，以使染色机处理器保持良好工作状态。这将有助于确保质量处理，并避免不必要的维修。

预防性维护

除了本章中列出的常规维护任务（由用户执行）以外，BOND 操作仪还应由 Leica Biosystems 服务代表定期进行检修。

BOND 每台操作仪每年一次或每处理 15600 张玻片（以时间在先者为准），就会通知您安排一次预防性维护。



玻片计数可在管理客户端程序的操作仪页签中用**维护完成**按钮进行重置（[10.6.1 操作仪](#)）。

本章有以下章节：

- [12.1 清洁和维护时间表](#)
- [12.2 大容器](#)
- [12.3 Covertile](#)
- [12.4 玻片染色装置](#)
- [12.5 重启操作仪](#)
- [12.6 抽吸探针](#)
- [12.7 洗涤区和混合站](#)
- [12.8 防护罩、门和盖](#)
- [12.9 ID 扫图仪](#)
- [12.10 承滴盘](#)
- [12.11 玻片架](#)
- [12.12 大用量液流自控装置探针（仅 BOND-III）](#)
- [12.13 注射器](#)
- [12.14 电源保险丝](#)

12.1 清洁和维护时间表

i 如果每台仪器每周染色的玻片数大约为 300 片，请使用下述时间表。如果处理的玻片超过这一数量，请联系客户支持部门获取定制的维护时间表。

任务	节
每日 – 日常工作开始时	
检查确认大容量废液容器装量未超过半满*	12.2
检查确认大容量试剂容器至少达到半满，并且装有正确的试剂*	12.2
每日 – 日常工作结束时	
清洗 Covertile	12.3
每周	
清洁玻片染色装置*	12.4
检查 Covertile 固定夹	12.4
重启操作仪	12.5
擦拭主自控装置抽吸探针	12.6
检查洗涤区和混合站，必要时进行清洁或更换	12.7
清洁仪器防护罩、门（如装有）和盖	12.8
清洁 ID 扫图仪	12.9
清洁手持式条形码扫描仪	13.1
每月	
清洁所有承滴盘*	12.10
更换混合站	12.7
清洁大容量试剂容器	12.2
清洁大容量废液容器	12.2
清洁玻片架	12.11
清洁大用量液流自控装置探针（BOND-III）	12.12
清洁玻片标签仪	13.2
检查注射器	12.13
当出现提示时	
清洁主自控装置抽吸探针	12.6.1
更换主自控装置抽吸探针	12.6.2
更换注射器	12.13

* 必要时增加这些任务的执行频率。

12.1.1 清洁与维护核查表

在下一页中，该维护时间表被重新调整为可打印出来用作检查表的表格形式。表中提供了记录 BOND Wash、抗原修复液 1 (ER1)、抗原修复液 2 (ER2) 和脱蜡溶液批号的区域。其余的空格供任务完成时在其中打勾或签上姓名首字母。

清洁和维护时间表

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
每日							
检查大容量试剂容器	<input type="checkbox"/>						
BONDWash 批号							
抗原修复液1 (ER1) 批号							
抗原修复液2 (ER2) 批号							
脱蜡溶液批号							
检查废液容器	<input type="checkbox"/>						
清洗 Covertile	<input type="checkbox"/>						
每周							
清洁玻片染色装置*	<input type="checkbox"/>						
检查 Covertile 固定夹	<input type="checkbox"/>						
重启操作仪	<input type="checkbox"/>						
擦拭抽吸探针	<input type="checkbox"/>						
检查洗涤区和混合站	<input type="checkbox"/>						
清洁仪器防护罩、门 (如装有) 和盖	<input type="checkbox"/>						
清洁 ID 扫图仪	<input type="checkbox"/>						
检查手持式扫描仪	<input type="checkbox"/>						
每月							
清洁承滴盘*	<input type="checkbox"/>						
更换混合站	<input type="checkbox"/>						
清洁大容量试剂容器	<input type="checkbox"/>						
清洁大容量废液容器	<input type="checkbox"/>						
清洁玻片架	<input type="checkbox"/>						
清洁大用量液流自控装置探针 (仅 Bond-III)	<input type="checkbox"/>						
清洁玻片标签仪	<input type="checkbox"/>						
检查注射器	<input type="checkbox"/>						
当出现提示时							
清洗抽吸探针	<input type="checkbox"/>						
更换抽吸探针							
更换注射器	<input type="checkbox"/>						

*必要时增加清洁频率。

周：自 _____ 至 _____

月份： _____

对于 **BOND-MAX**:

- 如果外部废液容器上只有一个容器盖，在拧开容器盖之前先断开电缆和液流线路。
- 如果大容器是不透明的，将大容器底端从原位置上抬起以便估计溶液量 – 不必将容器从仪器中取出。

12.2 大容器

	<p>免疫组织化学和原位杂交中使用的某些试剂具有危害性。继续操作前应确保您已接受过足够的有关此操作的培训：</p> <p>a) 穿戴好乳胶或丁腈手套、防护眼镜及其他合适的防护服，然后再接触试剂或清洗仪器。</p> <p>b) 使用和处理试剂及浓缩物时应遵从所有相关的实验室科室操作程序和政府法规。</p>
	<p>BOND 操作仪中使用的某些试剂是易燃物质：</p> <p>不要将明火或引火源放置在操作仪附近。</p> <p>重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。</p>

(至少) 每天检查大容器液位，并每月清洁大容器。参阅以下详细说明：

- [12.2.1 检查容器液位](#)
- [12.2.2 续灌或清空大容器](#)
- [12.2.3 清洁大容器](#)
- [12.2.4 外部废液容器 \(仅 BOND-MAX\)](#)

12.2.1 检查容器液位

每天开始工作时检查大容器液位。开始夜间运行或超时运行之前也应进行检查。处理量大的实验室可能需要每天进行两次大容器检查。

对于 BOND-III 和当前型号的 BOND-MAX 操作仪 (以及所有的 BOND-MAX 外部废液容器)，液位可以通过容器壁观察到。至于 BOND-MAX 型号中的不透明容器，可以将容器底端从原位置上抬起来估计溶液量，而不必将容器从仪器中取出，否则在放回容器时将触发液流系统灌注。

系统状态屏幕上的图标可以指示 BOND-III 的大容器液位，也用于通知 BOND-MAX 的高废液液位或低试剂液位。这些图标仅用来确认液位和/或查看通知 – 不可用它们来代替每日的实物检查。

i BOND-III 操作仪配备有大容器照明系统 (参阅 [大容器照明系统 \(BOND-III\)](#))。

出现以下情况时应灌装或清空容器：

- 废液容器超过半满时应清空；
- 试剂容器不到半满时应续灌。

参阅下面的 [续灌或清空大容器](#)。

	<p>每天工作开始时检查大容器液位，酌情清空或灌装 (必要时增加检查次数 – 参阅前文说明)。否则可能导致运行暂停，从而影响染色。</p>
---	---

12.2.2 续灌或清空大容器

检查大容器液位时，应清空装量超过半满的废液容器，灌装装量不到半满的试剂容器。灌装或清空大容器后切记擦掉溅出的液滴。将容器放回仪器之前需清洁容器外部和容器盖。

参阅下文分别列出的清空和重新灌装说明。如果需要在运行期间清空或灌装容器，可参阅[运行期间](#)章节提供的操作说明。

- [重新灌装大容量试剂 – BOND-III](#)
- [清空有害废液 – BOND-III](#)
- [清空标准废液 – BOND-III](#)
- [清空有害废液或重新灌装大容量试剂 – BOND-MAX](#)
- [运行期间](#)

参阅 [12.2.4 外部废液容器 \(仅 BOND-MAX\)](#) 中关于清空 BOND-MAX 外部容器的说明。

	确保将重新灌装或清空的容器放回其在操作仪中原来的位置。否则可能会污染试剂，从而影响染色。
	不要改换大容量试剂容器中的试剂类型。否则可能造成污染并影响染色。
	不要用强力将大容器放回，因为这可能会损坏容器和液位传感器。

重新灌装大容量试剂 – BOND-III

 BOND-III 大容量试剂容器可以直接在仪器中灌装，不必将它们从大容器槽中取出。

1. 拧开大容量试剂容器的容器盖，灌装容器。
2. 容器灌满后，将盖子盖上并拧紧。

	如果使用漏斗向 BOND-III 仪器的容器中添加试剂，请确保漏斗清洁。否则可能会污染试剂，影响染色质量。
---	---

清空有害废液 – BOND-III

1. 确保操作仪不处于操作状态。(不过,如果在运行期间出现废液容器已满的通知,可按照下述说明清空容器 – 另参阅下面的[运行期间](#)。)
2. 将容器从大容器槽中拉出。
3. 打开容器盖,并按照您所在科室的规定步骤处理废液。
4. 将盖子盖上并拧紧。
5. 将容器放回仪器内。轻轻推入,直到您感觉容器的接口与容器槽后部的接口对齐,然后平稳地推送容器,直到接口完全啮合,以确保连接无泄漏。

清空标准废液 – BOND-III

由于有两个标准废液容器,您可随时(包括染色操作期间)取出一个已装满的容器(系统状态屏幕中的容器图标显示其已装满)(参阅 5.1.3 试剂状态中的[大容器状态](#))。但是,切不可在仪器操作期间将两个大废液容器同时取出,并且如果系统状态屏幕没有显示某个容器已装满,我们建议您等到操作结束,然后再将其取出。当可以安全地取出一个大废液容器时,应按照上述步骤 (2) 中关于清空有害废液的说明进行操作。



图 123: 将废液容器放回其原先所在位置。

清空有害废液或重新灌装大容量试剂 – BOND-MAX

1. 确保操作仪不处于操作状态。(不过,如果在运行期间出现废液容器已满的通知,可按照下述说明清空容器 – 另参阅下面的[运行期间](#)。)

2. 将容器从大容器槽中拉出。

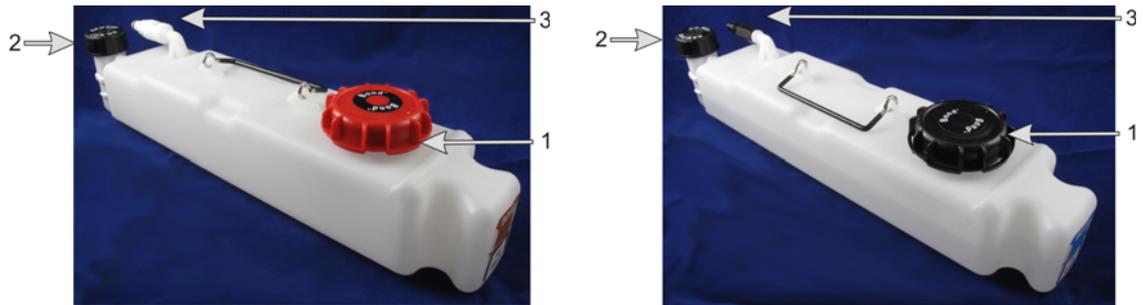


图 124: BOND-MAX 有害废液容器 (左图) 和大容量试剂容器 (右图), 其中显示:
(1) 灌装 / 清空口盖; (2) 液位传感器盖; 以及 (3) 接口

3. 灌装或清空容器:

- 对于废液, 打开灌装/清空口盖 (图 124 中的 1), 按照您所在科室的规定步骤处理废液。
- 对于大容量试剂, 将容器放在一个水平平面上, 打开灌装/清空口盖 (图 124 中的 1), 灌装至液面恰好低于用于拧上盖子的颈部的底边。



不要取下大容器上的液位传感器盖, 否则可能会被损坏。仅可通过灌装/清空口盖来清空和重新灌装大容器。

4. 将盖子盖上并拧紧。

5. 将容器放回仪器内。轻轻推入, 直到您感觉容器的接口与容器槽后部的接口对齐, 然后平稳地推送容器, 直到接口完全啮合, 以确保连接无泄漏。

运行期间

如果对大容器进行了每日检查 (加上夜间运行和超时运行之前的额外检查, 以及大处理量实验室更频繁的常规检查), 染色操作期间废液容器应绝不会被装满, 且试剂容器应绝不会被用空。但是, 如果运行期间发生任何一种情况, 您必须清空或灌装相关的容器。参阅下述说明以确保正确的操作步骤。

废液容器已满 – BOND-MAX

如果废液容器在运行中几乎装满, 系统状态屏幕中相关容器的图标上将显示一个通知符号 。

立即清空容器。在您的科室检查所有标准安全预防措施和废液处理步骤。快速行动, 您即有机会避免运行中断, 或减少其中断的时长。运行中断会影响染色。

如果在您清空或重新灌装容器时运行暂停, 或者您继续操作直到操作仪自动暂停, 该容器的图标上将显示一个警报  (闪动) 或警告符号 。尽快将已清空或已装满的容器放回, 同时注意上文的说明和预防措施。

生成一份运行事件报告, 以查看暂停对运行造成的影响。

试剂容器已空 – BOND-MAX

如果大容量试剂容器即将用空，系统状态屏幕中相关容器的图标上将显示一个通知符号 。

1. 打开程序状态屏幕，查看操作仪中每一批运行的当前步骤和其后的步骤。
2. 如果某些运行正在使用或即将使用快要用空的大容量试剂，则等待使用该试剂的步骤结束。
3. 待使用该大容量试剂的步骤一结束，立即取出容器，重新灌装，然后尽快放回（同时应遵守所有的标准安全预防措施）。

为了节省时间，您可以不必将容器灌装至通常的最高液位。



如果在染色操作期间某个 BOND-MAX 大容器需要灌装，切记先查看程序状态屏幕，确认该容器不在使用中或不会被即刻用到。否则，正在处理的玻片可能会受到不利影响。灌装后尽快将容器放回仪器。

若要避免出现这一情况，应每天检查大容器液位（必要时增加检查频率 – 参阅 [12.2.1 检查容器液位](#)）。

12.2.3 清洁大容器

以下清洁步骤应每月执行。

ER1、ER2、BOND 洗涤液和去离子水容器

1. 清空 ER1、ER2、BOND 洗涤液和去离子水大容量试剂容器。
2. 用强效工业洗涤剂清洗容器，然后用去离子水彻底冲洗。
3. 待容器干燥后，重新灌装新鲜试剂并将容器放回仪器。

脱蜡溶液和乙醇容器

1. 清空脱蜡溶液和乙醇大容量试剂容器。按照您所在科室的规定步骤处理大容量试剂容器中的脱蜡溶液和乙醇。
2. 向每个容器中倒入少量新鲜试剂，晃动容器使试剂接触容器壁以去除污染物。完成后清空容器。按照您所在科室的规定步骤处理废液。
注：切不可将水或洗涤剂倒入乙醇或脱蜡液容器内。
3. 用新鲜试剂重新灌装大容器，然后放回仪器。

大废液容器

1. 清空所有容器中的废液。按照您所在科室的规定步骤处理废液。
2. 用 0.5% (w/v) 漂白剂或强效工业洗涤剂清洁废液容器，然后用去离子水彻底冲洗。
3. 将废液容器放回仪器。

12.2.4 外部废液容器 (仅 BOND-MAX)

每天工作开始时清空 BOND-MAX 9L 外部标准废液容器，并在夜间运行和超时运行之前检查液位。若已半满或超过半满则清空；使用容器标签上的白色水平线来指示半满液位 - 参阅图 125。



图 125: BOND-MAX9L 外部标准废液容器

每月清洗该容器，同清洗其他大容器相同 (参阅上面的[清洁大容器](#))。

1. 确认操作仪不处于操作状态。(不过，如果在运行期间出现废液容器已满的通知，可按照下文的说明清空该容器 - 另参阅上面的[运行期间](#)。)

2. 如果容器具有如图 126 所示的接口 (注意: 有的传感器接口是黑色的, 而不是如图所示的银色):



图 126: 外部废液容器连接: 左边为液体接口, 右边为液位传感器接口

- (i) 用拇指提起传感器接口上的红色制动销 (1), 将接口从传感器封盖上拉开。
- (ii) 按下液体接口上的金属按钮 (2), 将接口从液体入口封盖上拉开。
3. 取下灌装/清空口盖并清空容器。不要取下接口封盖。按照您所在科室的规定步骤处理废液。
4. 将灌装/清空口盖盖回并拧紧, 放回操作仪内。
5. 将液体接口按回到封盖连接处, 直至连接到位。
6. 重新连接传感器接口, 将接口向下推至封盖连接处的底部。



外部废液容器装满后会很沉重。
在清空外部废液容器时, 要采用正确的搬动方法。



在清空容器之前, 切记先断开传感器和液体接口, 以免受损。

12.3 Covertile

每次使用 Covertile 后应清洗 (可使用 Leica Biosystems Covertile Cleaning Rack)。只要未出现损坏或重度变色,且清洁方法正确,Covertile 可重复使用达 25 次。若 Covertile 已损坏或染色质量下降,则应将之丢弃。

清除二氨基联苯胺 (DAB) 残留 (可选)

1. 在新配制的 0.5% W/V 次氯酸钠去离子水溶液中浸泡至少 30 分钟。
2. 取出,在新配制的去离子水中浸洗 10 次。
3. 完成一次标准清洁 (见下文)。

标准清洁 (必需)

1. 在 100% IMS (工业用甲醇变性酒精)、乙醇或试剂级酒精中浸泡至少 10 分钟。
2. 搅动 30 秒并取出。
3. 干燥:
 - 用无绒布擦干,或者
 - 晾干。
4. 仔细检查 Covertile 上是否有碎屑、裂纹或变形。若有任何受损则将其丢弃。

12.4 玻片染色装置

	<p>操作仪有加热器和受热表面，如果附近放有易燃物，可能有引燃危险：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不要将易燃物放在加热器上面或附近。 • 不要将易燃物放在操作仪的任何发热表面上。 • 重新灌装或清空大容器后，确保所有的容器盖已盖严。
	<p>避免接触玻片染色装置及其周围区域。这些部位可能非常热，会导致严重烫伤。操作停止后应等待二十分钟时间让玻片染色装置及其周围区域冷却。</p>
	<p>仅可用手清洁指定的组件。为避免损坏，不要用自动洗碗碟机清洗任何组件。不要用溶剂、强效或磨蚀性清洁液或者粗糙或磨砂类织物清洁任何零部件。</p>
	<p>确保大用量液流自控装置 (BOND-III) 位于仪器后部的原本位置，而不是位于玻片染色装置上，然后再清洁或移除盖板。</p>
	<p>不要用棉签或其他头部带有棉球的类似擦拭工具清洁洗涤区的槽孔内部或玻片染色装置的芯柱，因为棉头可能脱落而引起堵塞。</p>

标准清洁

每周清洁玻片染色装置，或者在有可见积垢时增加清洁次数。

使用以 70% 酒精湿润（用量尽可能少）的无绒布。对于难以去除的沉淀物，可使用 BOND Wash Solution（用量尽可能少）清洁，然后用去离子水冲洗。

对于 BOND-III，需擦拭其大用量液流自控装置导轨（图 128 中的 3）。

翻开盖板（见下述下面的**移除盖板**），清洁以下部件：

- 加热器片
- 排液口和芯柱
- 加热器片之间的区域
- 加热器片周围的承滴盘

务必经常检查确认排液口（及其边缘的小芯柱）处没有异物，也没有划痕或其他损坏。如果这些部位或者玻片染色装置的任何其他部件受损，请联系客户支持部门。



图 127: 打开盖板的玻片染色装置, 可见 Covertile 固定夹 (1)、排液口和芯柱 (2)、加热器片 (3) 和承滴盘 (4)

盖板打开后, 检查板下面的 Covertile 固定夹, 确认其弹簧底部可自由移动。如果固定夹弹簧被压下后不能弹回, 请联系客户支持部门进行更换。

移除盖板

1. 确保操作仪已空闲并关闭电源。
2. 打开盖板, 方法是向下压盖板并将两端的蓝色紧固钮 (图 128 和图 129 中的 1) 逆时针转动九十度, 将盖板顺着铰链向后翻开 (面向仪器时, 盖板的右侧将被掀开)。



图 128: BOND-III 盖板, 可见紧固钮 (1)、铰链 (2) 和大用量液流自控装置导轨 (3)

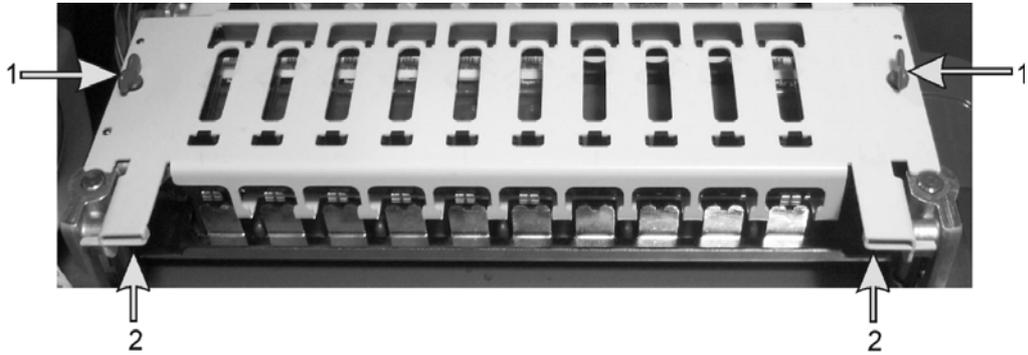


图 129: BOND-MAX盖板, 可见紧固钮 (1) 和铰链 (2)

3. 要完全取下盖板 (日常清洁时不需要), 拉开盖板两端装有弹簧的枢轴紧固件 (图 128 和图 129 中的 2), 然后将盖板从玻片染色装置上提起。

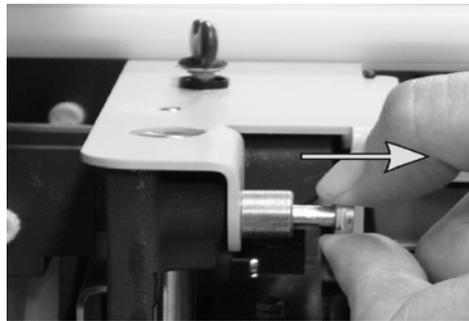


图 130: 松开盖板的枢轴紧固件

重新放置盖板

注: BOND-III 玻片染色装置的盖板都有编号, 应确保将正确的盖板安放在正确的玻片染色装置上 (面向仪器时, 左边的玻片染色装置编号为 1)。

1. 确定玻片染色装置内的支点, 将盖板放在打开位置, 然后将其中一个枢轴紧固件置入玻片染色装置的支点内。
2. 拉动另一个枢轴紧固件, 将盖板的末端放入, 然后放开该紧固件。
3. 合上盖板, 检查盖板两端的孔是否已与定位销正确接合。
4. 按住盖板并顺时针转动紧固钮。顺时针转动四分之一圈后即应能牢固地夹紧。

12.4.1 手动解锁玻片染色装置

每个玻片染色装置都可手动解除锁定，例如在出现电源故障时取出玻片。



玻片染色装置中包含的移动部件会导致严重伤害。在尝试手动解锁玻片染色装置之前：关闭操作仪的电源开关，关闭主电源，并将主电源插头从墙上断开。

- BOND-III
- BOND-MAX

BOND-III



注射器泵组件 (BOND-III) 非常重，在松开时会向前倒下。只有已接受过潜在危险警告和充分培训的操作人员才可执行此项操作。

手动解锁 BOND-III 的玻片染色装置：

1. 切断主电源并移去电源线。
2. 用提供的 3 毫米内六角扳手拧下固定注射器组件护板的四个六角螺丝。取下护板，可以很轻松地操作释放销和操作仪手柄。
3. 找到注射器泵 1 和 4 旁边的两个释放销。



图 131：释放销的位置以及敞开待处理的装置

4. 往身体方向拉动两个释放销，直至其发出卡哒声并使组件降低。在组件向前移动时应注意不要拉扯或挤压到注射器头部的液流管。
5. 注射器泵组件将被充分打开以允许对玻片染色装置进行操作。

6. 找到玻片染色装置底下的手动释放旋钮。



图 132: 手动释放旋钮

7. 按图 132 中所示方向转动旋钮。随着旋钮的转动，Covertile 会移至玻片上方，且整个染色装置和玻片架也会向上移动。
8. 继续转动释放旋钮，直至感觉到阻力。此时应能将玻片架从装置中取出。
9. 按照您的科室程序保存玻片。
10. 将注射器泵组件轻轻推回，注意不要拉扯或挤压到注射器头部的液流管。
11. 确保组件两边的两个释放销卡回到原来的锁定位置。



确保注射器组件 (BOND-III) 已完全关闭，然后再启动运行或初始化操作仪，否则会导致注射器在操作期间被损坏。

12. 重新装配注射器组件护板，并使用四个六角螺丝固定。

仪器重新通电前应当检查**程序状态** (参阅 [5.2 程序状态屏幕](#))。

操作仪重新通电后，将进行初始化，检测组件的状态并进行必要的操作，以使其做好使用准备。

初始化之后，玻片染色装置将处于解锁状态，程序状态屏幕上也将不显示任何步骤。BOND-III 中的染色处理有可能可完成，否则可手动完成剩余步骤。

BOND-MAX

要手动解锁 BOND-MAX 的玻片染色装置，请按以下步骤操作：

1. 切断主电源并移去电源线。
2. 打开大容器槽门，移除大容器。
3. 将大容器槽上方的玻片架滑出。
4. 找到玻片染色装置底下的手动释放旋钮（参阅图 132）。
5. 按图 132 中所示方向转动旋钮。随着旋钮的转动，Covertile 会移至玻片上方，且整个染色装置和玻片架也会向上移动。
6. 继续转动释放旋钮，直至感觉到阻力。此时即可将玻片架从装置中取出。
7. 按照您的科室程序保存玻片。
8. 必要时，清洁上层和下层承滴盘，然后将上层承滴盘重新插入大容器槽 – 将承滴盘呈 45 度弯曲的一端朝前，弯角朝上。
9. 重新放入大容器。
10. 关闭大容器槽门。

仪器重新通电前应当检查**程序状态**（参阅 5.2 程序状态屏幕）。

操作仪重新通电后，将进行初始化，检测组件的状态并进行必要的操作，以使其做好使用准备。

初始化之后，玻片染色装置将处于解锁状态，程序状态屏幕上也将不显示任何步骤。BOND-MAX 中的染色处理有可能可完成，否则可手动完成剩余步骤。

12.5 重启操作仪

每周应对各台操作仪进行一次关闭重启操作。这一点很重要，因为它可以使操作仪执行一次系统自我诊断检查。

单座 BOND 控制器不必定期关机和重启。但是，如果 BOND 软件运行明显减慢，您需要通过 Windows 的“开始”菜单重启控制器。

不过，如果具有 BOND-ADVANCE 系统，可参阅 [16.1 重启 BOND-ADVANCE 系统](#)。

操作仪

对于操作仪，先确认其中没有装载的、计划运行的或正在运行的玻片，然后关闭仪器右侧的电源开关，等待 30 秒钟后再开启。一经启动后，BOND 即灌注液流系统并进行一系列系统检测（参阅 [2.2.2 操作仪初始化](#)）。

注：您可以不关闭操作仪电源而进行液流系统的部分灌注（参阅下述下面的[清洗液流系统](#)）。

清洗液流系统

按下**维护**屏幕中的**清洗液流系统**按钮可灌注大容器的液流管路（这是操作仪启动时初始化运行的一部分）。如果您怀疑液流输送系统中有堵塞或气泡，应执行该日常维护。

1. 确保操作仪已空闲，其中没有已装载的、计划运行或正在运行的玻片。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其**系统状态**屏幕。
3. 点击**维护**页签，然后点击**清洗液流系统**按钮。
4. 在提示确认时点击**是**。

液流系统即被灌注，所需时间为数分钟。

12.6 抽吸探针

作为正常操作的一部分，抽吸探针会在每次接触试剂前在洗涤区内自动进行清洗。但是，每周还应使用 BOND Aspirating Probe Cleaning System 进行额外的擦拭和清洗。清洁系统的试剂针对 BOND 进行了优化，而 BOND 软件会使用最佳清洁效果的清洁程序。当探针到了需要清洁和更换的时间时，BOND 会向用户发出警示。



在操作仪开关打开期间不要移动主自控装置，否则自控装置可能无法对准，从而导致染色不佳。

如果自控装置已经被移动：关闭仪器电源，等待 30 秒后再重新启动。

参阅：

- [12.6.1 清洁抽吸探针](#)
- [12.6.2 更换抽吸探针](#)

12.6.1 清洁抽吸探针

清洁抽吸探针之前切记要关闭操作仪，并注意不要弯曲探针。每周用蘸有 70% 乙醇溶液的无绒布或酒精棉片擦拭抽吸探针外表。检查连接到抽吸探针上的管路，确保管路无扭结、管内没有异物。管路应保持清洁。

BOND 每处理 300 张玻片后，便会通知您用 BOND Aspirating Probe Cleaning System 清洁探针（参阅下面的**运行抽吸探针清洁**）。成功运行了清洁或更换了探针后，计数将自动重置。



收到 BOND Aspirating Probe Cleaning System 后，应当用 BOND 对其进行登记，方法与登记检测系统相同（参阅 **8.3.3 登记试剂和试剂系统**）。软件将记录清洗系统的使用情况，使每个系统可用于 15 次清洗。

i 为了保持清洗系统中试剂的效果，应仅在被使用时才将其放入操作仪中。当操作仪中装有任何其他试剂或试剂系统时，不可清洗抽吸探针。而且，当操作仪中装有清洗系统时，玻片处理无法被启动。

运行抽吸探针清洁

按下述说明用 BOND Aspirating Probe Cleaning System 清洁抽吸探针。

运行该清洗程序约需 20 分钟。

1. 确保操作仪已空闲，其中没有已装载的、计划运行或正在运行的玻片。
2. 从操作仪中取出全部试剂或试剂系统架。
3. 将 BOND Aspirating Probe Cleaning System 插入操作仪的试剂架。
4. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其**系统状态**屏幕。
5. 点击**维护**页签，然后点击**清洗抽吸探针**按钮。
6. 出现提示时点击**是**开始清洗操作。
清洗程序开始运行，通过操作仪页签上的清洗图标来进行提示。
7. 等待直至出现清洗已结束的通知。
8. 从试剂架上取出 BOND Aspirating Probe Cleaning System。
9. 点击**清洗完成**对话框中的**确定**，继续正常操作。

12.6.2 更换抽吸探针

BOND 每处理 7800 张玻片后，将通知您更换抽吸探针。参阅 **5.1.2 硬件状态**。

如果您希望由 Leica Biosystems 现场维护工程师来更换抽吸探针，请联系客户支持部门。或者您也可根据以下描述自行更换抽吸探针。



更换抽吸探针不需要工具。

移除抽吸探针

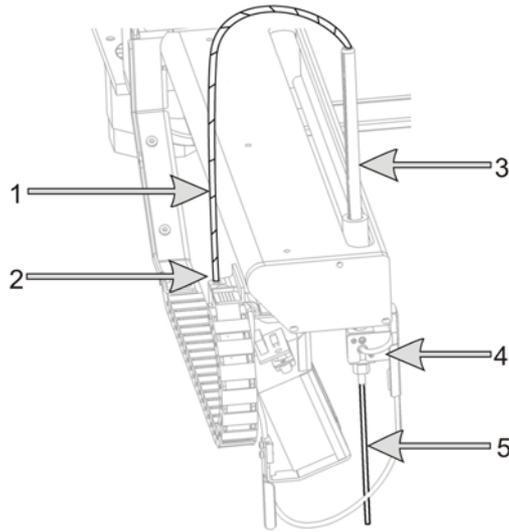


图 133: 抽吸探针组件:
1) 抽吸探针管路; 2) 接头; 3) 抽吸探针支架;
4) 绝缘装置, 背面带有指旋螺丝 5) 抽吸探针

请按如下操作移除抽吸探针组件:

1. 确保操作仪已空闲, 其中没有已装载的、计划运行或正在运行的玻片。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签, 以显示其**系统状态**屏幕。
3. 点击**维护**页签, 然后点击**更换抽吸探针**按钮。
4. 仔细阅读**更换抽吸探针**对话框中的说明, 然后点击**确定**继续。
5. 操作仪开始为更换抽吸探针而预备液流系统。

当液流系统预备完成 (这可能需要一些时间) 后, 操作仪与软件断开连接, 且通过**状态屏幕**页签上的  进行提示。

6. 关闭操作仪开关并打开仪器盖。
7. 用纸巾擦拭探针针头以擦干液体或液滴。
8. 完全松开绝缘装置背面的指旋螺丝 (该螺丝无法取下)。见下页的图片。



如果不完全拧开指旋螺丝, 可能会损坏抽吸探针上的聚四氟乙烯涂层。

9. 握住从绝缘装置下方露出的针头, 轻轻向上推以确认探针已松动。

不要直接从抽吸探针架 (图 133 中的 3) 的上方抽拉管路, 因为这样可能会把管路从针头上拔出。

10. 当探针松动后, 经由抽吸探针架向上轻拉针管, 将探针组件取出。
11. 将抽吸探针管路接头 (图 133 中的 2) 从自控臂左边的“链条”上拧下来。

安装新的抽吸探针

抽吸探针的安装是一项十分关键的操作。探针安装若不正确，会影响仪器的染色质量。如果对执行此项操作有任何顾虑，请联系客户支持部门。

按照如下操作安装新的抽吸探针组件，注意不要损坏聚四氟乙烯针头：

1. 确认抽吸探针架已完全抬起。
2. 小心地将新抽吸探针从保护性包装容器中取出。
3. 将抽吸探针从抽吸探针架顶端插入，直至探针的针头从绝缘装置中露出，然后停止。

如果探针进入不顺畅，检查确认指旋螺丝是否已松开，然后重新放置探针，直至其滑入。不应使用强力。

4. 一只手握住抽吸探针支架，另一只手握住抽吸探针针头。缓慢、平稳地向下拉动探针，直至其停止。在探针上端（见右图），探针的聚四氟乙烯涂层部分和绝缘装置组块底部的管子之间应当能看到约 **2 毫米** 的不锈钢部分。
5. 在固定好抽吸探针的同时，拧紧绝缘装置（图 133 中的 4）背面的指旋螺丝，拧至手指拧不动为止。

不要拧得过紧，因为这会损坏抽吸探针。

仔细检查抽吸探针是否能够转动或上下移动。抽吸探针不应能够移动。

从正面和侧面观察探针，确保其垂直于各个水平面。如果探针不垂直，松开指旋螺丝，再次检查其是否安放正确。如果探针仍然不垂直，即呈弯曲状，则应当换一支新探针。

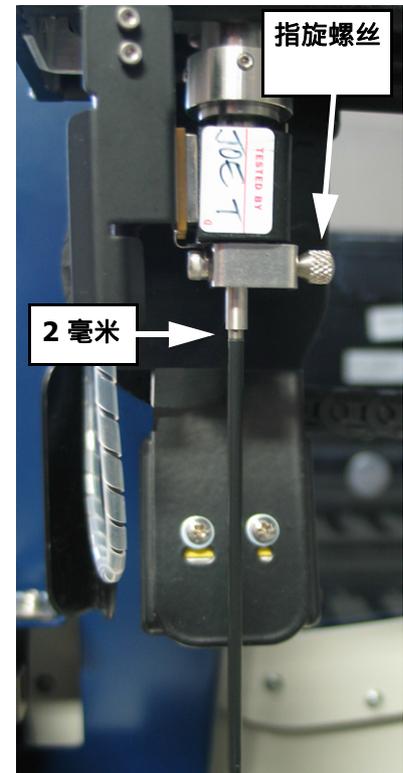


图 134：抽吸探针调整

6. 将抽吸探针的管路接头（图 133 中的 2）拧到“链条”组块上，用手拧紧即可，不要拧得过紧。
7. 确认抽吸探针架完全抬起，然后开启操作仪。操作仪启动时将灌注系统 – 请检查连接处和探针针头，以确保系统灌注时没有液体泄漏。
8. 抽吸探针更换完毕后，点击确认对话框中的**是**。如果不确定新的抽吸探针安装是否正确，则点击**否**，并联系客户支持部门。
9. 要确认新的抽吸探针安装是否正确，可运行检测组织或对照组织以明确是否能实现恰当染色。

12.7 洗涤区和混合站

混合站有 6 个用于混合试剂的孔。混合站正好可以放入洗涤区。

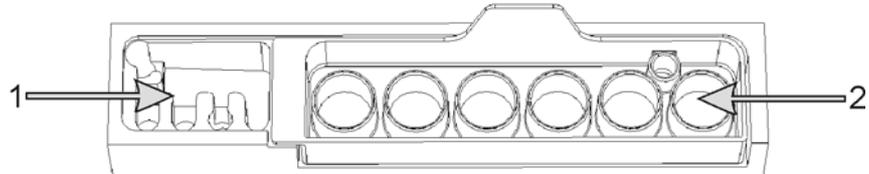


图 135：洗涤区俯视图：洗涤区域 (1) 和混合站 (2)



免疫组织化学和原位杂交中使用的某些试剂具有危害性。继续操作前应确保您已接受过足够的安全培训。

定期检查混合站是否有变色及其一般状况，必要时更换。每月应更换混合站，这是正常维护项目之一。在取出混合站之前一定要确保所有的运行都已完成。

要取出混合站，可握住混合站背部的凸耳，将其提出来。

清洗混合站

在每月更换日之前，只要没有损坏或严重变色，并且清洗适当，混合站可以重复使用。

1. 如需清洗，在新配制的 0.5% W/V 次氯酸钠去离子水溶液中浸泡至少 30 分钟。
2. 取出，在新配制的去离子水中浸洗 10 次。
3. 在试剂级酒精中浸泡至少 10 分钟。
4. 搅动 30 秒并取出。
5. 晾干。

清洁洗涤区

每周用无绒布清洁洗涤区。



不要用棉签或其他头部带有棉球的类似擦拭工具清洁洗涤区的槽孔内部 – 棉头一旦脱落，会堵塞槽孔。

12.8 防护罩、门和盖

每周用掸帚或抹布清洁操作仪的防护罩、门（如装有）和盖。

不要使用任何清洁剂；必要时可用无绒布蘸水除去防护罩、门和盖上的浮尘，以防止灰尘聚积。

如果防护罩、门或盖变形或损坏，请联系客户支持部门进行更换。

12.9 ID 扫图仪

主自控臂上的 ID 扫图仪窗口需保持清洁，以确保玻片能被正确识别。每周（或者当扫图仪多次未能正确扫描 ID 时）用无绒布蘸 70% 酒精溶液清洁窗口。

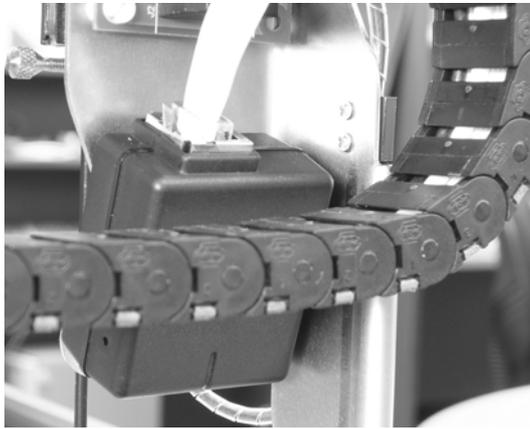


图 136: ID 扫图仪

另请参阅 [12.9.1 重新初始化 ID 扫图仪](#)。

12.9.1 重新初始化 ID 扫图仪

如果操作仪的 ID 扫图仪工作不正常，您的维护部门可要求对其进行重新初始化。

按以下说明对操作仪的 ID 扫图仪进行重新初始化。

1. 确保操作仪已开启，并且没有正在处理的运行，也没有锁定任何玻片架。
2. 打开操作仪盖。

3. 将初始化图像 (图 137) 放到 ID 扫图仪下方。



图 137: 初始化图像

4. 将一个回形针 (或类似物) 插入扫图仪侧面的小孔内 (图 139), 然后按压回形针, 直至感觉到它激活了内部按钮为止。

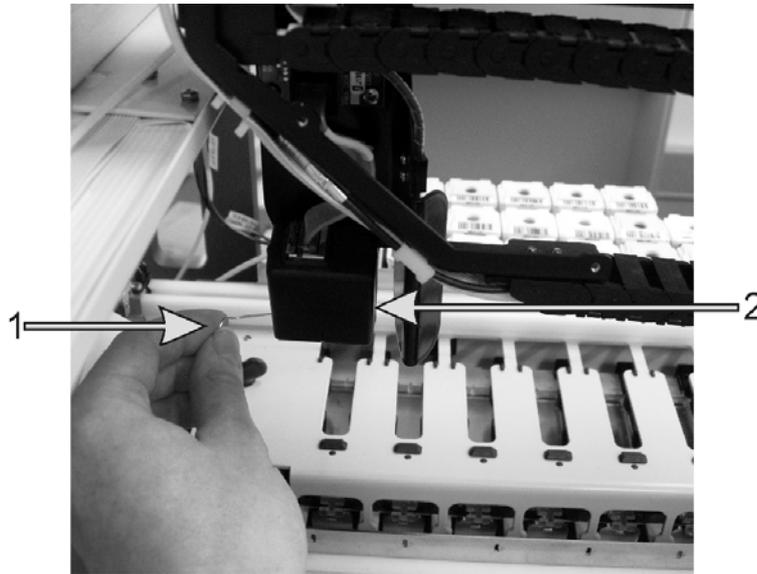


图 138: 用回形针 (1) 重新初始化 ID 扫图仪 (2)

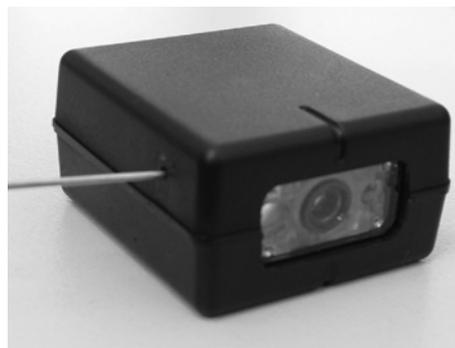


图 139: 重新初始化 ID 扫图仪

5. 此时，系统将尝试使用该图像进行初始化。
仔细观察图像，确保绿色校准光线位于中心，如图 140 所示。



图 140：图像校准

6. 如果操作成功，您将听到两声嘟声，表示 ID 扫图仪重新初始化获得成功。
7. 如果没有听到嘟声，或听到一个更长或更短连续嘟声，则说明初始化不成功。重新放置初始化图像并重试。

12.10 承滴盘

每月清洁承滴盘，或者在发现有溅出的试剂或废液时增加清洁频率。如果承滴盘中明显有过多洒出的液滴或盐类积垢，请联系客户支持部门。

- [12.10.1 BOND-III 大容器承滴盘](#)
- [12.10.2 BOND-III 仪器承滴盘](#)
- [12.10.3 BOND-MAX 大容器承滴盘](#)

12.10.1 BOND-III 大容器承滴盘

BOND-III 有两个大容器承滴盘，分别位于仪器上层和下层的大容器下面。

清洁 BOND-III 大容器承滴盘的步骤如下：

1. 确保操作仪未处于运行状态。
2. 取出所有的大容器。
3. 取下保护各个大容器上的重量传感器的黑色护盖（参阅图 141），用浸有 70% 酒精溶液的抹布或纱布擦拭每个护盖。



图 141：BOND-III 大容器承滴盘及重量传感器护盖

4. 用 70% 酒精溶液擦拭承滴盘。避免触碰暴露在外的金属质的重量传感器。
5. 用纸巾将承滴盘擦干。
6. 擦净所有大容器并放回正确位置。

12.10.2 BOND-III 仪器承滴盘

BOND-III 还有第三个承滴盘，位于仪器底部，如下面的图 142 所示。



图 142: BOND-III 仪器承滴盘

按下述步骤取放仪器承滴盘：

1. 找到仪器底部的承滴盘（参阅图 142）并将其拉出，用双手托住承滴盘，并防止液体洒出。
2. 清空承滴盘内容物，并按照您所在实验室的规定步骤处理废液。
注：此承滴盘后部的角落中有一条导槽，用于倾倒液体并防止洒出。
3. 用 70% 乙醇溶液清洗承滴盘，然后放回正确位置。

12.10.3 BOND-MAX 大容器承滴盘

BOND-MAX 有单个承滴盘，位于大容器槽中的大容器下方。

按下述步骤取放大容器承滴盘：

1. 确保操作仪未处于操作状态，然后取出所有大容器。
2. 取出承滴盘，用浸有 70% 乙醇溶液的抹布或纱布擦拭。
3. 用纸巾擦干并放回正确位置（仪器前部的弯曲边）。
4. 擦净所有大容器并放回正确位置。

12.11 玻片架

每月用温肥皂水清洗玻片架并用自来水冲净。确保玻片架已干燥后再使用。更换已变形或损坏的玻片架。

12.12 大用量液流自控装置探针 (仅 BOND-III)

大用量液流自控装置上的探针需每月用蘸有 70% 乙醇溶液的无绒布或酒精棉片进行清洁。

清洁的同时检查探针是否受损，必要时更换探针。

- 12.12.1 清洁大用量液流自控装置探针
- 12.12.2 更换大用量液流自控装置探针

12.12.1 清洁大用量液流自控装置探针

按月清洁大用量液流自控装置分配探针，注意不要弯曲探针。



大用量液流自控装置可沿着玻片染色装置移动以允许用户进行清洁。只有已接受过潜在危险警告和充分培训的操作人员才可执行此项操作。

1. 确保操作仪已空闲，其中没有已装载的、计划运行或正在运行的玻片。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其系统状态屏幕。
3. 点击**维护**页签，然后点击**清洗大用量液流自控装置探针**按钮。
4. 仔细阅读**清洗大用量液流自控装置探针**对话框中的说明，锁定所有玻片架，然后点击**确定**继续。

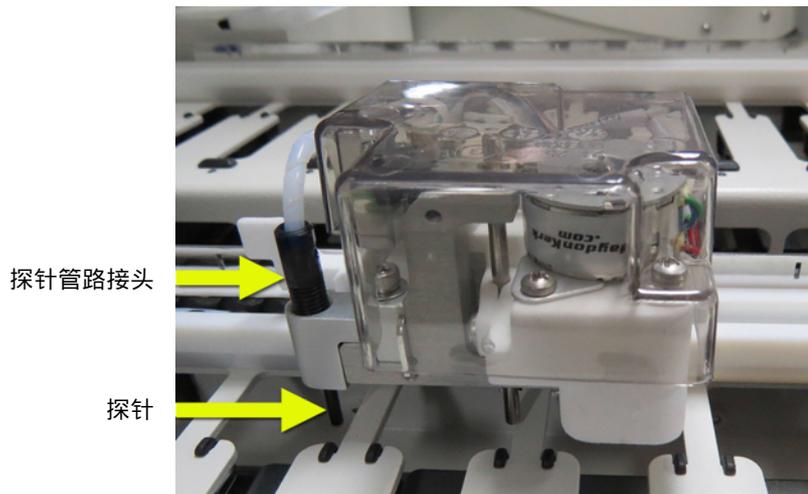


图 143: 用 70% 乙醇溶液擦拭所有三个大用量液流自控装置探针 (箭头所示为探针)

5. 当全部三个大用量液流自控装置都已移至仪器前部时，关闭仪器。
6. 用蘸有 70% 酒精溶液的软布或酒精棉片轻轻地擦拭探针。
特别注意不要将探针推出位。
7. 在对话框中，选择已成功清洁过的大用量液流自控装置，然后点击**完成**。或者，如果您没有清洁任何自控装置，则点击**部件未清洗**按钮。
8. 重启操作仪。初始化时，大用量液流自控装置将返回位于仪器后部的原本位置。

12.12.2 更换大用量液流自控装置探针

如果您希望由 Leica Biosystems 的现场维护工程师来更换大用量液流自控装置探针，请联系客户支持部门。或者您也可根据以下描述自行更换大用量液流自控装置探针。

1. 确保操作仪已空闲，其中没有已装载的、计划运行或正在运行的玻片。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其**系统状态**屏幕。
3. 点击**维护**页签，然后点击**更换大用量液流自控装置探针**按钮。
4. 仔细阅读**更换大用量液流自控装置探针**对话框中的说明，锁定所有玻片架，然后点击**确定**继续。
所有三个大用量液流自控装置都移至仪器前部的**位置 10**。
5. 关闭操作仪。
6. 旋开要更换探针的探针管路接头，将探针向上推出大用量液流自控装置（参阅**图 143**）。
7. 将一支新探针放入支架中，将探针管路接头放回，用手拧紧。
8. 视需要重复操作以更换其他探针。
9. 打开操作仪。初始化中，大用量液流自控装置将返回位于仪器后部的**原本位置**。
10. 初始化完成后将出现对话框。选择您已成功更换的大用量液流自控装置探针，然后点击**完成**。或者，如果您没能成功更换任何探针，则点击部件**未更换**按钮。
11. 要检查新的大用量液流自控装置探针安装是否正确，可运行检测组织或对照组织以明确是否能实现恰当染色。

12.13 注射器

BOND每过六个月或每处理 7800 张玻片后，就会通知您更换注射器（BOND-MAX：单个；BOND-III：多个），以时间在先者为准（参阅 5.1.2 硬件状态）。



每周一次在初始化期间或者在进行液流系统清洗时目视检查注射器，特别是注射器顶部和柱塞下方，看是否有泄漏（参阅 12.5 重启操作仪）。另外还要检查其附属管路和连接处。若有泄漏则更换。

如果您希望由 Leica Biosystems 的现场维护工程师来更换注射器，请联系客户支持部门。或者您也可根据以下描述自行更换注射器。



必须穿戴防护服和手套。

- 12.13.1 更换 BOND-III 注射器
- 12.13.2 更换 BOND-MAX 9 孔注射器

12.13.1 更换 BOND-III 注射器

应同时更换全部注射器，除非在更换后不久发现个别注射器有故障，方可更换单个注射器。

1. 确保操作仪已空闲（没有已装载或计划运行的玻片）。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其系统状态屏幕。
3. 点击**维护**页签，然后点击**更换注射器**按钮。
4. 阅读说明，然后点击**是**。

操作仪会清除所有注射器中的液体，并将它们准备好以便更换（这可能需要 10 分钟之久）。等待

操作仪断开连接 ，然后将其关闭。不要关闭控制器（或 BOND-ADVANCE 系统的终端）。



继续操作前确保操作仪已关闭。

5. 用提供的 3 毫米内六角扳手拧下固定注射器组件护板的四个六角螺丝，取下护板。
6. 松开每个注射器夹的指旋螺丝，将夹具放低。

7. 使用提供的 2.5 毫米内六角扳手卸下柱塞底部的柱塞止动螺钉。

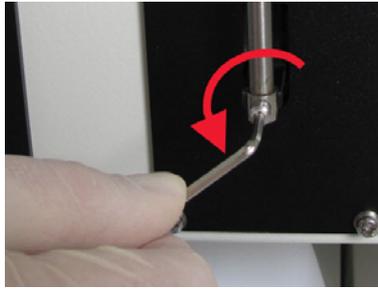


图 144: 用内六角扳手拧开柱塞止动螺钉

有些型号用指旋螺丝代替六角螺丝。

8. 将注射器筒从阀上拧下，从仪器中移除注射器和夹具。
9. 将新注射器穿过夹具放好。
10. 将注射器和夹具放入仪器 – 将注射器旋拧到阀中。
11. 放回柱塞止动螺钉并拧紧。
12. 将夹具提至注射器顶部，然后拧紧指旋螺丝。
13. 重新装配注射器组件护板，并使用四个六角螺丝固定。
14. 在对话框中选择您已成功更换的注射器，然后点击**完成**。或者，如果您没能成功地更换任何注射器，点击**部件未更换按钮**。
15. 重启操作仪。
16. 在操作仪初始化期间检查是否有泄漏，特别是注射器顶部和柱塞下方。若有泄漏，应报告客户支持部门。
17. 要检查新的注射器安装是否正确，可运行检测组织或对照组织以明确是否能实现恰当染色。

12.13.2 更换 BOND-MAX 9 孔注射器

1. 确保操作仪已空闲（没有已装载或计划运行的玻片）。
2. 在临床客户端选择该操作仪的页签，以显示其**系统状态**屏幕。
3. 点击**维护**页签，然后点击**更换注射器**按钮。
4. 阅读说明，然后点击**是**。

操作仪会清除注射器中的液体，并将其准备好以便更换。等待操作仪断开连接 ，然后将其关闭。不要关闭控制器（或 BOND-ADVANCE 系统的终端）。



继续操作前确保操作仪已关闭。

5. 松开注射器夹具指旋螺丝，将夹具放低。
6. 用内六角扳手卸下柱塞底部的柱塞止动螺钉。

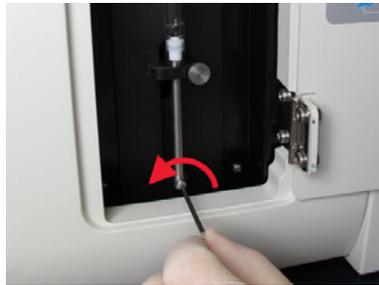


图 145：用内六角扳手拧开柱塞止动螺钉

有些型号用指旋螺丝代替内六角扳手。

7. 将注射器筒从阀上拧下，从仪器中移除注射器和夹具。
8. 将新注射器穿过夹具放好。
9. 将注射器和夹具放入仪器 – 将注射器旋拧到阀中。
10. 放回柱塞止动螺钉并拧紧。
11. 将夹具提至注射器顶部，然后拧紧指旋螺丝。
12. 在对话框中点击**是**，确认您已成功地更换了注射器。
13. 重启操作仪。
14. 在操作仪初始化期间检查是否有泄漏，特别是注射器顶部和柱塞下方。若有泄漏，应报告客户支持部门。
15. 要检查新的注射器安装是否正确，可运行检测组织或对照组织以明确是否能实现恰当染色。

12.14 电源保险丝

所有 BOND 仪器都有两个主电源保险丝和两个加热器电源保险丝，保险丝额定值根据主电源而有所不同。保险丝位于后部防护罩内（参阅 [2.2.13 后部防护罩](#)）。

BOND-III 使用下列保险丝：

保险丝	描述	100-240 伏交流电源
F1	加热器电源	3AG T8A 250V UL
F2	系统电源	3AG T8A 250V UL
F3	交流电源（零线）	3AG T15A 250V UL
F4	交流电源（火线）	3AG T15A 250V UL

BOND-MAX 操作仪使用两种不同电源中的一种。这可以通过后部防护罩中的风扇数量加以识别 – 新型号的电源有两个风扇，而使用较旧型号电源的仪器只有一个风扇。可用于更换的保险丝规格也印刷在后部防护罩上。

使用新电源的 BOND-MAX 操作仪（后部防护罩中有两个风扇）：

保险丝	描述	100-240 伏交流电源
F1	交流电源（火线）	3AG T15A 250V UL
F2	交流电源（零线）	3AG T15A 250V UL
F3	24 伏加热器电源	3AG T8A 250V UL
F4	24 伏直流电源	3AG T8A 250V UL

使用旧电源的 BOND-MAX 操作仪（后部防护罩中有一个风扇）：

保险丝	描述	100-120 伏交流电源	200-240 伏交流电源
F1	交流电源（火线）	3AG T15A 250V UL	3AG T8A 250V UL
F2	交流电源（零线）	3AG T15A 250V UL	3AG T8A 250V UL
F3	24 伏直流电加热器电源	3AG T8A 250V UL	3AG T5A 250V UL
F4	24 伏直流电源	3AG T8A 250V UL	3AG T5A 250V UL



不要绕过保险丝或使其短路。

更换保险丝之前应关闭仪器，断开电源线的连接。仅使用标准零件更换保险丝。若保险丝反复熔断，请联系客户支持部门。

要更换保险丝，请按如下步骤操作：

1. 关闭操作仪。
2. 关闭主电源供应，并从墙壁插座上断开主电源。
3. 旋开保险丝盖。
4. 拉出保险丝盖并更换保险丝。确保更换的保险丝规格正确无误。
5. 合上保险丝盖，顺时针旋转以将保险丝固定在位。不要拧得过紧。

13

清洗和维护（其他）

13.1 手持式条形码扫描仪

13.1.1 Symbol 条形码扫描仪

i 本说明仅适用于早期型号的 Symbol 条形码扫描仪。如果您使用的是新型号的霍尼韦尔 (Honeywell) 条形码扫描仪，请参阅 [13.1.2 霍尼韦尔条形码扫描仪](#)。

每周清洁手持式扫描仪：

- 不要让有磨蚀作用的物质接触窗口
- 不要在窗口上直接喷洒水或其他清洁液
- 不要取下扫描仪的橡胶鼻。

清洁扫描仪方法：

1. 首先，断开扫描仪与控制器或终端的连接。
2. 用湿润的无绒布清除污垢微粒。
3. 用无绒布蘸 70% 酒精溶液擦拭窗口。



激光危险。

手持式条形码扫描仪包含激光装置，可能会导致严重的眼部损伤。
扫描仪打开时不要注视扫描窗口。

设置 Symbol 条形码扫描仪

若要重新初始化 Symbol 条形码扫描仪 (USB)，可以将本页以高质量的方式打印在纸张上，然后按照顺序扫描下列条形码：



扫描 1：设置所有默认设置



扫描 2：启用 Code 128



扫描 3：扫描选项



扫描 4：<数据><后缀>



扫描 5：输入

图 146：Symbol 扫描仪配置的条形码扫描顺序

设置蜂鸣器音量

设置 Symbol 条形码扫描仪的蜂鸣器音量时，可以将本页以高质量的方式打印在纸张上，然后扫描对应于所需音量水平的下述条形码。



低音量



中音量



高音量

图 147: Symbol 扫描仪蜂鸣器音量条形码

13.1.2 霍尼韦尔条形码扫描仪

i 本说明仅适用于新型号的霍尼韦尔 (Honeywell) 条形码扫描仪。如果您使用的是早期型号的 Symbol 条形码扫描仪，请参阅 [13.1.1 Symbol 条形码扫描仪](#)。

每周清洁手持式扫描仪：

- 不要让有磨蚀作用的物质接触窗口
- 不要在窗口上直接喷洒水或其他清洁液

清洁扫描仪方法：

1. 首先，断开扫描仪与控制器或终端的连接。
2. 用湿润的无绒布清除污垢微粒。
3. 用无绒布蘸 70% 酒精溶液清洗窗口。

如果手持式条形码扫描仪工作不正常，您的维护部门可要求对其重新初始化。您也可以调节扫描仪上的蜂鸣器音量。

配置霍尼韦尔条形码扫描仪

若要重新初始化霍尼韦尔条形码扫描仪（USB），可以将本页以高质量的方式打印在纸张上，然后按照下列顺序扫描条形码：



扫描 1： 删除自定义默认设置



扫描 2： 激活默认设置



扫描 3： 霍尼韦尔条形码扫描仪配置

图 148：扫描仪设置条形码

设置蜂鸣器音量

设置霍尼韦尔条形码扫描仪的蜂鸣器音量时，可以将本页以高质量的方式打印在纸张上，然后扫描对应于所需音量水平的下述条形码。



低音量



中音量



高音量



关闭蜂鸣器

图 149: 霍尼韦尔扫描仪蜂鸣器音量条形码

设置免提使用

当扫描仪放置在其支架上时通常是免提使用的，不需要在读取条形码时按下触发器。

设置霍尼韦尔条形码扫描仪免提使用“开”或“关”时，可以将本页以高质量的方式打印在纸张上，然后扫描对应于所需功能的下述条形码。



免提使用“开”



免提使用“关”

图 150：霍尼韦尔扫描仪免提使用条形码

13.2 玻片标签仪

玻片标签仪附带有使用手册。请参阅这些手册中关于清洁、装载标签和打印纸带的说明。应每月进行清洁。

14

使用 BOND 试剂

本章将综合论述使用 BOND 系统进行组织染色的技术和临床注意事项。

- 14.1 程序原理
- 14.2 标本制备
- 14.3 质量控制
- 14.4 染色的解释
- 14.5 一般局限性
- 14.6 标签上的符号说明
- 14.7 参考文献

14.1 程序原理

本节将对免疫组化（IHC）和原位杂交（ISH）进行一般性介绍，并描述 BOND 检测系统和诊疗内容。

- 14.1.1 BOND 检测系统
- 14.1.2 诊疗系统

免疫组织化学（IHC）

免疫组织化学技术应用于检测细胞或组织中的特异性抗原至少已有 50 年了。1941 年首次报道的方法使用了荧光标记¹，此后又采用了酶标记物，如过氧化物酶²。如今，免疫组织化学已同常规的苏木精伊红石蜡染色法一起用于增进细胞的识别，并成为识别正常细胞和异常细胞的一种辅助手段。当单独使用传统方法无法给出确切的诊断时，免疫组织化学方法就成了外科病理学的“诊断标准”^{3,4}。然而，尽管这一方法几乎被普遍采用，人们对于其可重复性仍持有保留意见⁵。

自动化的 BOND 系统中的试剂利用免疫组织化学技术显示组织切片中的抗原。简要地说，就是特异性一抗结合到组织切片上，然后 BOND 检测系统试剂再使复合物显现。

- ❗ 诊断性“标记”指的是用于检测组织样本中特定抗体或 DNA/RNA 结合位点的试剂。这里的标记指免疫组化（IHC）中的一抗或原位杂交（ISH）中的探针（参阅下文）。

原位杂交 (ISH)

分子生物学技术极大地促进了我们对疾病的认识。原位杂交结合了分子生物学和组织学，从而使细胞中的 DNA 或 RNA 显现出来。自 1969 年首次采用核酸检测法以来，原位杂交操作程序的改进已经使之成为临床病理学和临床研究的一个日益宝贵的工具。

原位杂交利用了 DNA 或 RNA 中的核苷酸碱基的互补结合。带有标记的核酸探针特异性地结合到已固定的组织或细胞标本中与其互补的碱基序列上。通过使用该标记物的抗体，然后使用 BOND 聚合物检测试剂，即可使探针显现。BOND 自动化系统和试剂为繁琐的人工技术提供了一种可靠而有效的替代方法。

14.1.1 BOND 检测系统

Leica Biosystems 提供一系列专为 BOND 开发的检测系统。其中最主要的就是 BOND Polymer Refine Detection™ 系统，该系统可在不使用链霉亲和素和生物素的情况下提供轮廓清晰鲜明的高强度染色。

以下各节中列出了可提供的 BOND 检测系统。

- BOND Polymer Refine Detection
- BOND Polymer Refine Red Detection
- BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

BOND Polymer Refine Detection

BOND 聚合物 DAB 型系统的产品名是 BOND Polymer Refine Detection，能实现轮廓鲜明的高强度染色，从而清晰显现结合到靶抗原上的抗体或结合到核酸上的探针。该系统不使用链霉亲和素和生物素，因而消除了内源性生物素导致的非特异性染色。内源性生物素普遍存在于某些组织中，如胃肠道、肾脏、肝脏和乳腺癌组织。BOND 聚合物检测系统的灵敏度高于标记链霉亲和素-生物素系统，可产生更高的一抗稀释度，染色处理时间更快。

这些检测系统使用的步骤为：

1. 用过氧化氢孵育。
2. 应用特异性一抗（在免疫组化（IHC）操作中）或探针以及酶联一抗（原位杂交（ISH）操作）。
3. 用酶联二抗（结合后的一抗）孵育。
4. 用聚合物试剂孵育，该试剂由聚合的辣根过氧化物酶（HRP）三抗结合体组成。
5. 用 DAB 对复合物进行显色。
6. 苏木精复染可对细胞核进行检测。

按照 BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection Systems (Bond 标记链霉亲和素-生物素检测系统) 的说明进行孵育、洗涤以及结果分析。

如果需要更高的染色强度，可选择以下方法用于所有的 BOND 聚合物检测系统：

- (i) 增加一抗或者探针和/或检测系统成分的孵育时间。
- (ii) 使用 BOND DAB Enhancer (Bond DAB 增强剂) 步骤。注意：单独使用增强剂不能将染色强度提高至 Intense R 检测系统所产生的强度。
- (iii) 仅对免疫组化 (IHC) 而言，可以提高一抗的浓度。

BOND Polymer Refine Red Detection

可提供一种红色检测系统: BOND Polymer Refine Red Detection™。它与上述 DAB 型聚合物检测系统具有相同的优点，但使用快红显色剂代替 DAB 用于显色。该系统适用于组织色素会被误为 DAB 的组织，如皮肤组织。

BOND Polymer Refine Red Detection 系统是一种高灵敏的 Compact Polymer™ (紧密聚合物) 系统，可与碱性磷酸酶结合产生鲜艳的紫红色免疫染色以及苏木精复染 (包括蓝化)。

- i** 快红显色剂在正常实验室条件下处于化学不稳定状态。因此，应严格遵循 BOND Polymer Refine Red Detection 系统的说明以保持显色剂的效用。确保将对照组织置于与患者组织相同的玻片上，以对系统内的任何退化作出快速检测。
- i** 建议将 Leica CV Ultra Mounting Media (封片剂) 与 BOND Polymer Refine Red Detection 系统配合使用。其他封片剂可能无法保留最初获得的染色强度。

BOND Polymer Refine Red Detection 系统的使用步骤如下：

1. 应用特异性一抗。
2. 用结合后的一抗进行孵育。
3. 用聚合物试剂孵育，该试剂由聚合的碱性磷酸酶 (AP) 三抗结合体组成。
4. 用底物显色剂和快红借助红色沉淀物对复合物进行显色。
5. 苏木精复染可对细胞核进行检测。

按照 BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection Systems 的使用说明进行孵育、洗涤以及结果分析。

BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

此类别只有一种检测系统：BOND Intense R Detection。

此种 DAB 型检测系统的操作如下：

1. 用过氧化氢孵育，以抑制内源性过氧化物酶的活性。
2. 应用特异性一抗。
3. 采用用户自备的能够识别其一抗的生物素二抗结合体进行抗体定位。
4. 加入链霉亲和素-酶结合体，与二抗上的生物素结合。
5. 用底物显色剂（3,3'-二氨基联苯，又称 DAB）对复合物进行显色，该底物显色剂的酶产物为棕色沉淀。
6. 苏木精复染可对细胞核进行检测。

BOND 系统在每一步都会以精确的时间孵育切片，然后洗涤切片以去除未结合的物质。用光学显微镜对结果进行分析，并辅助病理过程的鉴别诊断，其与特定抗原可能有关，也可能无关。

14.1.2 诊疗系统

由于癌的异源性和癌细胞中固有的基因组不稳定性，患者对于广谱抗癌药物的反应常常不太理想。这些药物常具有严重的副作用，降低患者的生活质量，还可能使患者面临严重的不良药物反应（ADR）的风险。相比之下，许多新出现的癌症疗法着重于特异性生物标记，这些靶向疗法的出现对于以病理学为基础的诊断检测产生了意义重大的影响。这一特殊类别的诊断检测被称为“诊疗”，其检测有助于鉴别那些最有可能从特殊疗法中受益的患者。

诊疗 = 治疗 + 诊断

每台设备都是一个完整的系统，用于测定靶蛋白或靶基因的存在，从而确定靶向疗法治疗的适合性。Leica 诊疗分析是作为一个整体优化系统而提供的，包含即用型抗体或探针、检测试剂、对照试剂，某些情况下还有对照玻片，以便为诊断结果提供完全的质量保证。这些设备以免疫组化（IHC）或原位杂交（ISH）方法学为基础，并经过相应地区法规机构的批准，用于鉴别那些有可能适合治疗的患者。

-  完整的使用说明随各个诊疗系统一同提供。请按照这些说明设置诊疗的运行。由于诊疗检测的性质，必须严格遵从这些说明以免检测无效，这一点极为重要。

14.2 标本制备

这一节介绍需染色的组织的制备。

- [14.2.1 所需材料](#)
- [14.2.2 组织制备](#)
- [14.2.3 脱蜡和烤片](#)
- [14.2.4 抗原修复](#)

14.2.1 所需材料

使用 BOND 系统进行免疫组织化学染色和原位杂交染色需要以下材料。

常用材料

- 固定剂 – 建议使用10%中性福尔马林缓冲溶液
- 石蜡
- 组织处理装置或包埋装置
- 阳性和阴性对照组织（参阅 [14.3 质量控制](#)）
- 切片机
- 带电荷显微镜玻片（例如 Leica BOND Plus Slides）
- 干燥箱
- 酒精（试剂级*）
- BOND Dewax Solution（脱蜡溶液）
- 去离子水
- BOND Enzyme Pretreatment Kit（酶预处理试剂盒）
- BOND Slide Labels and Printer Ribbon（玻片标签和打印机纸带）
- BOND Universal Covertiles
- 洗涤溶液（用 BOND Wash Solution 10X Concentrate 制备）
- 合适的 BOND 试剂系统
- 固定介质，树脂或水性媒介
- 盖玻片



* 试剂级酒精组成：乙醇，超过或等于 90%（w/w）；异丙醇，不超过 5%（w/w）；甲醇，不超过 5%（w/w）。

用于免疫组化（IHC）的材料

免疫组化（IHC）除以上列出的材料外，免疫组化（IHC）检测还需要以下材料：

- 特异性一抗阴性对照试剂（参阅 14.3 质量控制）
- BOND Epitope Retrieval Solution 1（抗原修复溶液 1）
- BOND Epitope Retrieval Solution 2（抗原修复溶液 2）
- BOND 即用型一抗，或者装在 7 mL 或 30 mL 的 BOND 开放容器中、用 BOND Primary Antibody Diluent 稀释的一抗
- 固定介质，树脂或水性媒介
- 滴定试剂盒，可选（参阅下面的 Titration Kit（滴定试剂盒））

用于原位杂交（ISH）的材料

原位杂交（ISH）除以上列出的常用材料外，原位杂交（ISH）检测还需要以下材料：

- ISH 探针
- 抗荧光素抗体
- 特异性 ISH 阳性和阴性对照探针（参阅 14.3 质量控制）

Titration Kit（滴定试剂盒）

免疫组化（IHC） BOND Titration Kit（Bond 滴定试剂盒）由 10 个空容器和 50 个插管（6 mL）组成，用于优化 BOND 系统使用的一抗的浓度。可以制备少量体积的各种浓度的一抗并置于插管内。每个容器可用于盛装总量为 40 mL 的试剂。

可使用两倍连续稀释法对浓缩抗体进行滴定。下面的方法描述如何为 150 μ L 单一分配制备连续稀释液。每个滴定容器插管中会剩余一些稀释抗体。BOND 系统会测量剩余量并根据需要将其用于进一步优化程序。

1. 将三根插管做好相应的抗体稀释液标记。
2. 在第一根插管内制备 1 mL 的原始稀释液。
3. 分配 500 μ L 的 BOND 一抗抗体稀释剂给插管 2 和插管 3。
4. 从原始稀释液内移取 500 μ L 溶液至插管 2 内，并轻轻混匀。
5. 从插管 2 内移取 500 μ L 溶液至插管 3 内，并轻轻混匀。

14.2.2 组织制备

我们建议在使用 BOND 系统进行免疫组化和原位杂交染色时，用体积为组织体积的 15 倍至 20 倍的 10% 中性福尔马林缓冲溶液来固定组织。固定可以在室温（15–25 °C）下进行。

对于 HER2 检测，请参阅美国临床肿瘤学会 / 美国病理学家学会（CAP）的组织制备建议¹⁰ 或者参考您所在地的指南和法规。

为方便组织切割和防止损坏切片机刀片，在处理组织之前应对骨组织进行脱钙^{11,12}。

1988 年的《美国临床实验室改进法案》（Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA）在“42 CFR 493.1259(b)”条款中规定，“实验室必须自检验之日起将染色玻片至少保存十年，并自检验之日起将标本组织块至少保存两年。”¹³ 请参考您所在地的地方法规要求。

将切成 3–5 μm 厚的组织切片采集到带电荷玻璃玻片上（有些特殊类型的组织可能要求不同的切片厚度）。将已充分沥干液体的载玻片在 60°C（±5°C）的烘箱中放置 10–30 分钟，或在 37°C 下放置过夜，以使组织干燥。也可将玻片放在 BOND-III 和 BOND-MAX 操作仪中烘干。烤片之前，玻片必须充分晾干。关于标本制备的详细内容，请参阅参考文献 13、14 和 15。

将玻片标签粘贴到标本和对照玻片上，方法如 **4 快速入门** 所述。脱蜡、再水化和抗原修复皆在 BOND 系统中完全自动进行。

14.2.3 脱蜡和烤片

用于免疫组织化学分析的石蜡包埋组织切片必须首先进行脱蜡和再水化处理。脱蜡需使用 BOND Dewax Solution，然后对切片进行再水化处理。BOND 系统包括脱蜡程序，可自动进行此操作。

在脱蜡之前，BOND 还可烘干组织，从而使其更好地粘着在玻片上。BOND Bake 和 Dewax 程序可自动进行烤片和脱蜡操作。



请注意：组织在被放入 BOND 操作仪中进行烤片和脱蜡之前，必须晾干以除去所有水分。

14.2.4 抗原修复

用福尔马林固定组织会引起组织中的醛基和氨基团交联，这些键的形成所产生的遮蔽效应可导致不同程度的抗原性损失。福尔马林还可形成亚甲基桥，它能改变抗原决定簇的总体立体形状。有些抗原决定簇对福尔马林敏感，在用福尔马林固定后其免疫反应性降低，而其他抗原决定簇则对福尔马林有耐受性。

核酸被蛋白质包裹着，因此，为了使探针可以接近目标序列，必须对组织进行透化。

可使用热抗原修复（HIER）、酶预处理或两种方法结合进行抗原修复^{7,8}。热抗原修复（HIER）是免疫组化（IHC）中使用最广泛的抗原修复方法。热抗原修复（HIER）的机制还未完全被了解。有种假设认为，将组织切片在抗原修复溶液中加热至高温可以使在福尔马林固定中形成的交联键水解，导致抗原决定簇的结构被重新修改，从而使其被免疫组化方法染色。热抗原修复（HIER）的重要因素包括温度、时间和修复溶液的 pH 值。Bond 系统有两种不同的抗原修复溶液可供使用：柠檬酸基缓冲液和 EDTA 基缓冲液。

酶预处理使用蛋白水解酶破坏肽键，从而暴露抗原决定簇 / 目标核酸序列。酶浓度和孵育时间与标本的固定时间成比例，并应当相应地进行优化调整。酶预处理仅适用于某些抗原决定簇，但在 ISH 操作规程中经常要用到。

14.3 质量控制

用户实验室中采用的组织处理步骤和技术方法不同，可以产生差别显著的染色结果，因而除了以下措施外，还必须实施常规的机构内部质量控制。请参阅当地指南和法规。可能对您有帮助的还有“CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition”（CLIA 规范手册：临床实验室基本指南第二版）²²和“Proposed NCCLS guidelines for IHC”（NCCLS 建议的 IHC¹⁴ 指南）。

i 对照应为按照和患者标本同样的处理方法尽快进行固定、处理和包埋的新鲜的尸检 / 活检 / 手术标本。这样的对照将作为从组织制备到染色的所有分析步骤的核对标准。

i 我们强烈建议将对应的对照组织放在与患者组织相同的玻片上。参阅 6.2 使用对照中的进一步说明。

参阅：

- 14.3.1 检测验证
- 14.3.2 对照组织
- 14.3.3 免疫组化（IHC）阴性对照试剂
- 14.3.4 原位杂交（ISH）对照试剂
- 14.3.5 质量控制的益处

14.3.1 检测验证

在诊断过程中首次使用抗体、探针或染色系统之前，要对抗体 / 探针的特异性进行验证，方法是采用一系列具有已知表达，代表已知的阳性和阴性组织的实验室自备组织对该抗体 / 探针进行检验。请参考前文概述的方法以及“免疫组织化学 CAP 认证程序 14”和 / 或“NCCLS（美国临床实验室标准化委员会）IHC 指南”¹⁴ 中的质量控制建议，或者参考您当地的法规和指南。对每一批新抗体，或在检测参数改变时，均需重复这些质量控制步骤。单独对单个试剂实施质量控制是没有意义的，因为在使用检测系统进行诊断之前，必须对匹配试剂以及定义的检测操作规程进行统一测试。请参阅各个一抗包装中的说明书中关于适合用于检测验证的组织的内容。

除上述的检测验证步骤以外，我们建议每月对阳性对照组织进行一次染色，并将其与上个月染色的相同对照组织进行比较。对按月染色的对照进行比较可以监控检测的稳定性、敏感性、特异性和可重复性。

BOND 诊疗系统包括所有适用的对照试剂，还可包括进行此种检测所必需的系统对照玻片。必须严格按照使用说明书中的指示使用所提供的对照。在使用说明书有指示时，应使用实验室自备的对照组织（非提供的对照）。实验室自有的操作步骤尚未予以验证，因此不应采用，否则将使诊断结果无效。

所有质量控制要求均应符合地方、州和 / 或联邦法规或鉴定的要求。

14.3.2 对照组织

阳性对照组织

- 可指示正确制备的组织 and 恰当的染色技术。
- 每次染色操作中的各组测试均应包括一个阳性对照组织。
- 弱阳性染色组织比强阳性染色组织更适用于最佳质量控制以及检测低水平的试剂降解¹⁴。
- 使用包括表现强、中和弱抗原密度 / 核酸表达的多对照组织玻片可提供广泛的对照。
- 如果阳性对照组织未能表现出阳性染色，检测标本的结果应被视为无效。
- 我们强烈建议您在运行 Bond 系统时始终在标本组织的同一玻片上加上对照组织，以保证最优的质量控制。

阴性对照组织

- 在检查阳性对照组织后检查阴性对照组织，以检验免疫组化（IHC）中一抗标记靶抗原的特异性或原位杂交（ISH）中探针标记靶核酸的特异性，并提供特异性背景染色（假阳性染色）的指征。
- 多数组织切片中存在的不同细胞类型的种类常提供阴性对照部位，但用户应对此加以检验。
- 如果阴性对照组织中出现特异性染色，该患者标本的结果应被视为无效。

14.3.3 免疫组化（IHC）阴性对照试剂

用免疫组化（IHC）阴性对照试剂代替一抗用于各个患者标本切片，以评价非特异性染色并更好地解释特异性染色。

- 推荐的理想对照试剂：
 - (i) 对于单克隆抗体，使用同型抗体，该抗体从组织培养物上清液中取得并且获取方式和一抗相同，但不显示与人类组织的特异反应性。
用同一种稀释剂（BOND 一抗稀释剂）将该抗体稀释至与一抗具有相同的免疫球蛋白或蛋白浓度。
如果处理后胎牛血清保留在净抗体中，那么与同一稀释剂中的稀释一抗具有相同蛋白浓度的胎牛血清也适用。
 - (ii) 对于多克隆抗体，使用从同一动物获得的正常或未免疫血清的免疫球蛋白组分（或酌情使用全血清），用同一种稀释剂（BOND 一抗稀释剂）稀释至与一抗相同的蛋白浓度。
- BOND Primary Antibody Diluent（BOND 一抗稀释剂）可单独用作上述阴性试剂对照的不太理想的替代品。
- 阴性试剂对照的孵育时间应与一抗的孵育时间相一致。
- 对于给定的一抗，所用的各种修复方法（包括无修复）均使用单独的阴性试剂对照玻片。

- 当在连续切片上使用含若干抗体的模板时，某张玻片的阴性染色区可作为其他抗体的阴性 / 非特异性结合背景对照。
- 为了将内源酶活性或酶的非特异性结合与特异性免疫反应性区分开，分别用底物显色剂或酶复合物和底物显色剂专门对额外的患者组织进行染色。
- BOND 系统包括一种默认的阴性免疫组化（IHC）对照试剂，称为“*Negative（*阴性）”，该试剂可被选为任何 IHC 程序的标记物。分配的试剂为 BOND Wash（参阅 10.5.2 病例与玻片设置）。

14.3.4 原位杂交（ISH）对照试剂

阳性对照试剂

原位杂交 原位杂交使用 Positive Control Probe（阳性对照探针）。

（ISH）

- 替代探针用于各个患者标本的切片，以提供关于组织中核酸的保存以及核酸对探针的可接近性的信息。
- Positive Probe Control（阳性探针对照）的程序应与测试探针的程序一致。
- 如果 Positive Control Probe 未能表现阳性染色，那么检测标本的结果应被视为无效。

阴性对照试剂

原位杂交 原位杂交使用 Negative Control Probe（阴性对照探针）。

（ISH）

- Negative Control Probe 的程序应与测试探针的程序相同。
- 替代探针用于各个患者标本切片，以评估非特异性染色，并更好地解释特异性染色。
- 阴性试剂对照的孵育时间应与探针的孵育时间相一致。
- 对于给定的探针，所用的每种修复方法（包括无修复）均使用单独的阴性试剂对照玻片。
- 为了将内源酶活性或酶的非特异性结合与特异性免疫反应性区分开，分别用底物显色剂或酶复合物和底物显色剂专门对额外的患者组织进行染色。

14.3.5 质量控制的益处

下表概括了质量控制的益处。

组织： 同处理患者标本一样进行固定和处理	带有检测系统试剂的 特异性抗体 / 探针	阳性对照试剂 加上与特异性抗体 / 探针所用试剂相同的检测系统试剂	阴性对照试剂 [原位杂交 (ISH)] 或非特异性抗体或缓冲液 [免疫组化 (IHC)] 加上与特异性抗体 / 探针所用试剂相同的检测系统试剂
阳性对照组织： 含有待检测的靶抗原 / 核酸序列的组织或细胞 (可能位于患者组织中)。理想的对照组织是对抗体 / 核酸降解的敏感度最高的弱阳性染色组织。	控制分析的所有程序。 验证用于染色的试剂和程序。		检测非特异性背景染色
阴性对照组织： 预计为阴性的组织或细胞 (可能位于患者组织或阳性对照组织中)	检测抗体与细胞 / 细胞成分的非预期交叉反应性 [免疫组化 (IHC)] 检测探针与其他核酸序列或细胞 / 细胞成分的非预期交叉杂交 [原位杂交 (ISH)]		检测非特异性背景染色
患者组织	检测特异性染色	评价核酸保存 / 组织固定和 / 或修复 [原位杂交 (ISH)]	检测非特异性背景染色

14.4 染色的解释

在解释结果之前，必须由合格的病理医师对对照进行评价并确定染色产物是否合格，该病理医师应具备免疫组织化学/原位杂交操作方面的经验。

抗原检测的特异性和敏感性取决于使用的特异性一抗。为了确保染色合乎要求，可以对 BOND 系统的各个特异性抗体进行优化，改变孵育时间和/或特异性抗体的浓度。未能优化特异性抗体可能导致抗原检测达不到最佳效果。

参阅：

- [14.4.1 阳性对照组织](#)
- [14.4.2 阴性对照组织](#)
- [14.4.3 患者组织](#)

14.4.1 阳性对照组织

首先检查阳性对照组织，以确定所有试剂均能正常工作。

当使用 DAB 染色检测系统时，靶细胞中棕色（3,3'-二氨基联苯胺，DAB）反应产物的存在表明反应为阳性。当使用 BOND Polymer Red Detection System 时，如果靶细胞存在红色反应产物，表明反应为阳性。如果阳性对照组织未能表现阳性染色，则检测标本的结果应被视为无效。

14.4.2 阴性对照组织

在检查阳性对照组织之后检查阴性对照组织，以检验一抗 / 探针标记靶抗原 / 核酸的特异性。

如果阴性对照组织中不存在特异性染色，就证明抗体 / 探针与细胞 / 细胞成分之间无交叉反应。

如果阴性外部对照组织中出现了特异性染色（假阳性染色），则检测结果应被视为无效。如果存在非特异性染色，通常为弥漫性外观。福尔马林过度固定的组织切片中也可观察到结缔组织的散在染色。使用完整细胞解释染色结果。坏死细胞或变性细胞通常为非特异性染色。

14.4.3 患者组织

最后检查使用一抗 / 探针染色的患者标本。

在阴性试剂对照出现非特异性背景染色的情况下，应该对阳性染色强度进行评估。如同任何免疫组织化学或原位杂交检测一样，阴性结果表示没有检测到抗原/核酸，而并非说明被检细胞/组织中不存在抗原/核酸。

如果有必要的话，使用抗体模板确定假阴性反应。

14.5 一般局限性

- 免疫组织化学和原位杂交是多步诊断方法，需要以下方面的专门培训：选择合适的试剂；组织的选择、固定和处理；玻片的制备；以及染色结果的解释。
 - 组织染色取决于染色前的组织处理和加工。如果固定、冷冻、解冻、洗涤、干燥、加热和切片操作不正确或者组织被其他组织或液体污染，可能会产生人为假象、抗体被限制或假阴性结果。结果不一致可能由固定和包埋方法的差异所致，或者由组织内固有的不规则性引起¹⁸。
 - 过度复染或不完全复染可能不利于对结果进行正确的解释。
 - 任何染色或无染色的临床解释均应由形态学研究（使用恰当的对照）加以补充，并应由合格的病理医师根据患者的临床病史及其他诊断检测进行评价。
 - 取自感染乙型肝炎病毒和体内有乙型肝炎表面抗原（HbsAg）的患者的组织用辣根过氧化物酶染色时，可能呈现非特异性染色¹⁹。
 - 分化不良肿瘤中的非预期阴性反应可能是由于抗原表达缺失或明显降低，或归因于抗原编码基因的缺失或变异。肿瘤中的非预期阳性染色可能归因于通常不在形态类似正常细胞中表达的抗原发生表达，或归因于肿瘤中抗原持续或捕获，该抗原具有与另一个细胞谱系相关的形态学和免疫组织化学特征（异向分化）。肿瘤的组织病理学分类不是一门精确的科学，一些关于非预期染色的文献报告可能具有争议性。
 - 试剂在以前未检测过的组织中可能表现出意外反应。由于肿瘤或其他病理组织中的抗原表达 / 靶核酸存在生物变异性，发生意外反应的可能性甚至在已检测组织中也不能完全排除。要报告任何意外反应，请与当地经销商或 Leica Biosystems 的区域办事处联系。
- 免疫组化 (IHC)
- 由于存在自身抗体或天然抗体，阻断步骤中所用的来源于同一动物、作为二次抗血清的正常或未免疫血清可能引起假阴性或假阳性结果。
- 免疫组化 (IHC)
- 免疫组化 (IHC) 中可能观察到假阳性结果是由蛋白质或底物反应产物的非免疫结合所引起，另外，根据所采用的免疫染色类型，也可能由下列因素引起：假过氧化物酶活性（红细胞）、内源性过氧化物酶活性（细胞色素 C），或者内源性生物素（例如肝脏、乳房、大脑、肾脏）¹⁶。
- 免疫组化 (IHC)
- 免疫组化 (IHC) 中的假阴性情况可由多种因素引起，这些因素包括肿瘤“去分化”期间的真性抗原减少、缺失或结构改变，或固定或处理过程中的人为改变。正如任何免疫组织化学检测一样，阴性结果表明未检测到抗原，而不是检测组织中不存在抗原。
- 原位杂交 (ISH)
- 原位杂交 (ISH) 中观察到的假阳性结果可能是由探针与其他核酸序列的交叉反应，或者探针或检测试剂与组织或组织成分的非特异性结合所引起¹⁸。检测中应包括阴性组织和对照试剂，以帮助鉴别假阳性染色。
- 原位杂交 (ISH)
- DNA 和 RNA 易因核酸酶的活性而降解^{8,19}，因此，必须使用患者组织测试 Positive Control Probe（阳性对照探针），同时用特异性探针和患者组织来检测核酸降解。固定剂的选择可影响核酸的保存，为此，建议使用以 10% 中性福尔马林缓冲溶液固定的组织¹⁹。如同任何原位杂交检测一样，阴性结果表明未检测到核酸，而并非被检测组织中不存在核酸。

14.6 标签上的符号说明



体外诊断医疗器械



序列号（唯一包装标识符）



目录编号




CE 合格标志



易碎品，小心轻放



请参考使用说明



生产商



批号



勿重复使用



注意。请参阅随附文件。



欧共体授权代表



温度限制



在此日期前使用（有效期）

14.7 参考文献

1. Coons AH et al. Immunological properties of an antibody containing a fluorescent group. *Proc Soc Exp Biol Med* 1941; 47:200-202.
2. Nakane PK and Pierce GB Jr. Enzyme labeled antibodies: Preparations and applications for the localizations of antigens. *J Histochem Cytochem* 1967; 14:929-931.
3. Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, and Brigati J. Special report: Quality control in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1989; 92:836.
4. Nadji M and Morales AR. *Immunoperoxidase techniques: a practical approach to tumor diagnosis*. ASCP Press, Chicago. 1986.
5. True LD ed. *Atlas of Diagnostic Immunohistopathology*. Lippincott, Philadelphia. 1990.
6. Gall JG, Pardue ML. Formation of RNA-DNA hybrid molecules in cytological preparation. *Proceedings of the National Academy of the Sciences of the United States of America*. 1969;63:378-383.
7. Shi S-R, Gu J, and Taylor CR. *Antigen Retrieval Techniques: Immunohistochemistry and Molecular Morphology*. Eaton Publishing, Natick. 2000.
8. Miller RT, Swanson PE, and Wick MR. Fixation and epitope retrieval in diagnostic immunohistochemistry: a concise review with practical considerations. *Appl Immunohistochem Mol Morphol*. 2000 Sep;8(3):228-35.
9. Bancroft JD and Stevens A. *Theory and Practice of Histological Techniques*. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
10. Wolff et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. *Arch Pathol Lab Med* 2007; 131:18-43.
11. Kiernan JA. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice*. New York: Pergamon Press. 1981.
12. Sheehan DC. and Hrapchak BB. *Theory and Practice of Histotechnology*. St. Louis: C.V. Mosby Co. 1980.
13. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
14. O'Leary TJ, Edmonds P, Floyd AD, Mesa-Tejada R, Robinowitz M, Takes PA, Taylor CR. Quality assurance for immunocytochemistry; Proposed guideline. MM4-P. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Wayne, PA. 1997;1-46.
15. Battifora H. Diagnostic uses of antibodies to keratins: a review and immunohistochemical comparison of seven monoclonal and three polyclonal antibodies. *Progress in Surg Path* 6:1-15. eds. Fenoglio-Preiser C, Wolff CM, Rilke F. Field & Wood, Inc., Philadelphia.
16. College of American Pathologists (CAP) Certification Program for Immunohistochemistry. Northfield IL. <http://www.cap.org>
17. Wilkinson DG. The theory and practice of in situ hybridisation. In: Wilkinson DG. (ed.) *In Situ Hybridization A practical approach*. 2nd Edition. New York: Oxford University Press, 1998, pp.18-20.
18. Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase, part I: the techniques and pitfalls. *Lab Med* 1983; 14:767.
19. Omata M, Liew CT, Ashcavai M, and Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: a possible source of error in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1980;73:626.
20. Wilkinson DG. *In situ hybridization: A practical approach*. 2nd Edition. Oxford University Press, Oxford. 1998.
21. Weiss LM, Chen Y. Effects of different fixatives on detection of nucleic acids from paraffin-embedded tissues by in situ hybridization using oligonucleotide probes. *The Journal of Histochemistry and Cytochemistry*. 1991;39(9):1237-1242.
22. Pontius CA, Murphy KA, Novis DA and Hansen AJ. *CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory*. 2nd Edition. Washington G-2 Reports, New York. 2003.

15

系统管理（在 BOND 控制器上）

15.1 BOND 系统管理器

15.1.1 概述

BOND 系统管理器是一个应用程序，它能方便您查看 BOND 系统使用的主要软件服务的当前状态，允许您停止和启动个别服务（如 Print Spooler），或停止和启动所有服务。



不要停止任何服务，因为 BOND 系统将无法正常操作。
不过，在系统故障排除过程中，客户支持部门可能会要求您停止一项或多项服务，然后重新启动。

若要打开 BOND 系统管理器，在 Windows 通知区域找到 Leica BOND 系统管理器图标 ，然后单击该图标。

i 该图标可能会被隐藏；如果是这种情况，点击微小的向上箭头即可看到它。

如果发生 BOND 系统错误，将显示一条通知信息。您可以单击该信息隐藏它。

若要隐藏 BOND 系统管理器窗口，再次单击 Windows 通知区域中的图标。



15.1.2 BOND 系统管理器窗口



图 151: BOND 系统管理器窗口

i 如果存在 BOND 系统错误，BOND 系统管理器图标  就会更新，显示所发生的错误的类型：

-  一项或多项服务已停止 ( 也会显示在 BOND 系统管理器屏幕的左上角)
-  无法连接至 BOND ( 也将显示在 BOND 系统管理器屏幕的左上角)

在 BOND-ADVANCE 安装中，这最有可能意味着如下状况：

- (i) 控制器已被关闭；或
 - (ii) 终端网络已被断开；或
 - (iii) 终端网络交换机已关闭。
-  BOND 系统管理器不可用 ( 也将显示在 BOND 系统管理器屏幕的左上角)

15.1.3 停止服务

若要停止某个单项服务，点击该服务名称最右端的红色停止按钮。若要停止所有报务，点击服务列表下方的**全部停止**按钮。

将弹出一个对话框，询问是否确定停止服务。点击**是**继续，或点击**否**取消。



图 152: 要求确认对话框

- 有些服务 (PostgreSQL - PostgreSQL Server 和 World Wide Web Publishing Service) 不可被停止，因为 BOND 系统管理器依靠它们发挥功能。这些服务的停止按钮因此被禁用。

15.1.4 启动服务

- 在大多数情况下，当某项服务被停止时，BOND 将在几分钟内自动重启该服务。

如果 BOND 系统没有按预期操作，而您发现有一项或多项服务被停止了，您可以用 BOND 系统管理器启动被停止的服务。

若要启动一项服务，点击该服务名称最右边的绿色启动按钮。若要启动所有服务，点击服务列表下方的**全部启动**按钮。



图 153: 显示三角形警告标志的 BOND 系统管理器 (Print Spooler 服务停止)

15.2 硬盘冗余

所有的 BOND 控制器和终端机都包含硬盘冗余，以便在硬盘出现故障时保护 BOND 系统。该保护系统持续监控系统硬盘，Windows 通知区域中的一个图标可显示当前状态。

图标	说明
	<p>正常 – 硬盘工作正常。</p>
	<p>警告 – 系统硬盘出现问题。联系客户支持部门。</p>
	<p>错误 – 硬盘出现故障。联系客户支持部门。</p>
	<p>忙碌 – 当硬盘正在接受校验时（例如在意外关机后）会出现此图标。校验期间控制器或终端可能运行缓慢，校验通常需 2 到 3 小时才能完成，在此期间 BOND 系统可能无法使用。</p> <p>检验后，该图标应返回其“正常”状态，硬盘正常操作也将恢复。但是，如果图标显示“警告”或“错误”状态，请联系客户支持部门。</p>
	<p>服务未运行 – 用于监控硬盘保护的软件服务没有运行。控制器或终端机刚刚启动时，该图标会显示这一状态。如果数分钟之后图标仍不指示正常状态，联系客户支持部门。</p>

16

BOND-ADVANCE 操作

16.1 重启 BOND-ADVANCE 系统

- i** 仅在下述情况下才能执行这一步骤：
- Leica Biosystems 客户支持部门指示您如此操作；或者
 - 您要为计划中的停电做准备。

使用下述方法来重启整个 BOND 系统：

1. 确保所有仪器均闲置（即没有已锁定的玻片架）。
2. 关闭**所有**操作仪的电源。
3. 关闭**所有**终端的电源（点击**开始** > **关闭**）。
4. 短暂按下电源按钮以关闭辅助控制器（如有）的电源（见下文示例）。
5. 短暂按下电源按钮以关闭主控制器的电源（参阅图 154）。

- i** 电源按钮可位于控制器前部防护罩后面，防护罩可以取下，但也可能会被锁定。若遇到这种情况，您必须先从指定的钥匙保管员那里获取钥匙。

关闭电源的同时需观察看板屏幕，因为如果关闭程序停止在 Windows 登录屏幕阶段，则可能需要再次按下电源按钮。如果出现这种情况，等待至少90秒钟，然后再次短暂按下电源按钮。

- i** 当您再次按下电源按钮后，控制器将开始关闭。**不得**持续按住按钮超过 2 秒钟，否则可导致“硬”重置，且会立即关闭控制器。控制器关闭电源大约需要 45 秒钟之久（电源按钮指示灯熄灭）。

6. 等待 2 分钟，然后重新开启主控制器电源。

如果出现“电源关闭事件追踪器”窗口，选择**取消**或按下 **<Esc>** 键将其关闭。

7. 等待 30 秒，然后开启辅助控制器（如有）电源。
8. 控制器完全重启后，开启所有终端电源。
9. 开启所有操作仪电源。
10. 登录各终端。



图 154: 电源按钮在控制器前面板上的位置（面板防护罩已取下）

16.2 切换至辅助控制器

i 以下说明仅适用于包含一台辅助（后备）控制器的 BOND-ADVANCE 系统。仅在下述情况下您才能执行这一操作：

- Leica Biosystems 客户支持部门指示您如此操作；或者
- 主控制器不工作。

此后辅助控制器将以独立模式单机操作，您的系统也将不再具有冗余后备性能。不过，在完成这一操作后，BOND 系统会继续正常操作。

i 在切换过程中，最后 5 分钟的操作数据可能会丢失。此外，在切换过程中发送的实验室信息系统（LIS）信息也可能会丢失。因此，切换成功后，应检查是否有缺失的玻片。如果有，可通过实验室信息系统（LIS）重新发送玻片数据，或者在 BOND 中手动创建缺失的玻片。

1. 关闭所有 BOND-ADVANCE 终端上的所有临床客户端和管理客户端实例。
2. 断开主控制器上标有 **T1** 或 **T2** 的端口上的终端网线，然后将该网线重新连接到辅助控制器上的相同端口上。参阅图 155。

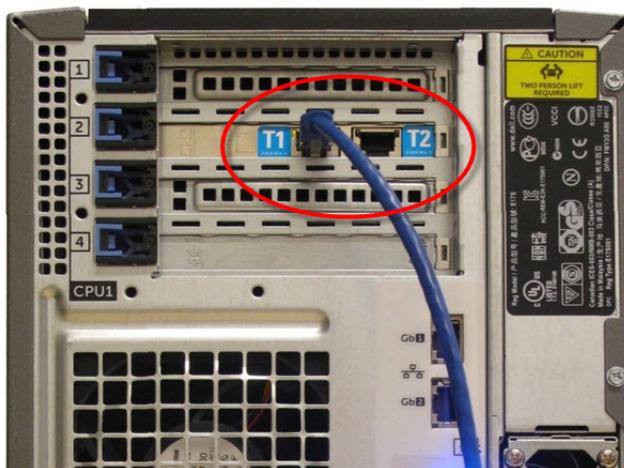


图 155: 控制器终端端口

3. 断开主控制器上标有 **I1** 或 **I2** 的端口上的仪器网线，然后将该网线重新连接到辅助控制器的相同端口上。参阅图 156。

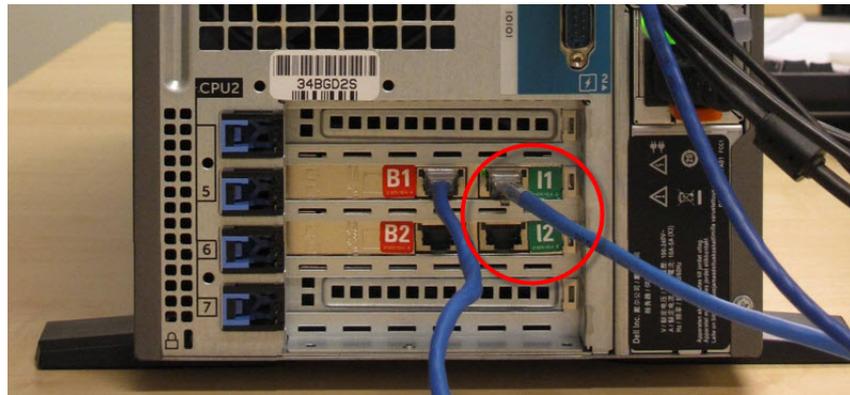


图 156: 控制器仪器端口

4. 断开主控制器的 **B1** 或 **B2** 端口上的桥接网线。参阅图 157。

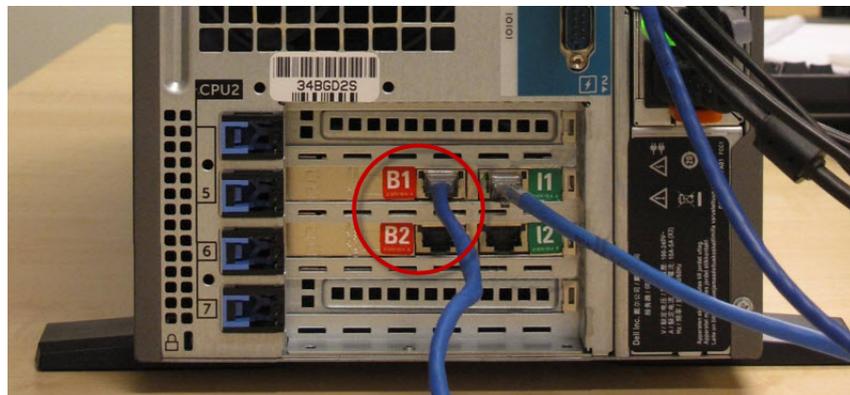


图 157: 控制器桥接端口

5. 如果主控制器的 **Gb(1) 或 Gb(2)** 端口上有网线（用于可选的 BOND RemoteCare 连接），将该网线断开并重新连接到辅助控制器的相同端口上。参阅图 158。

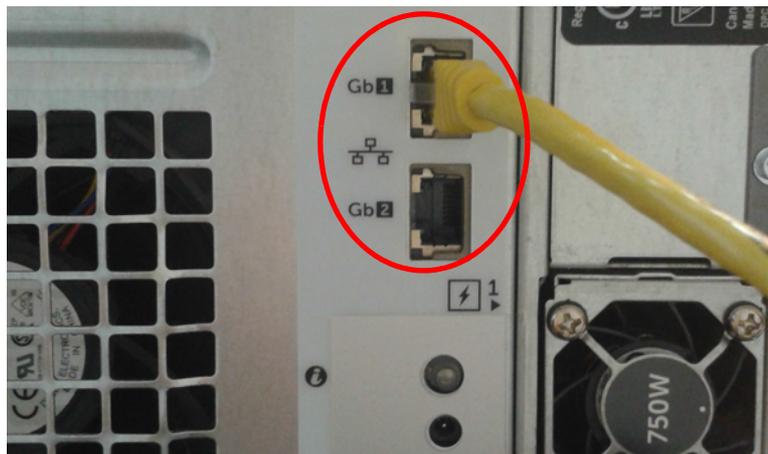


图 158：用于 BOND RemoteCare 的以太网端口

BOND-ADVANCE 系统在检测到您已将网线连接至辅助控制器后，会在所有终端上显示一个确认对话框。参阅图 159。

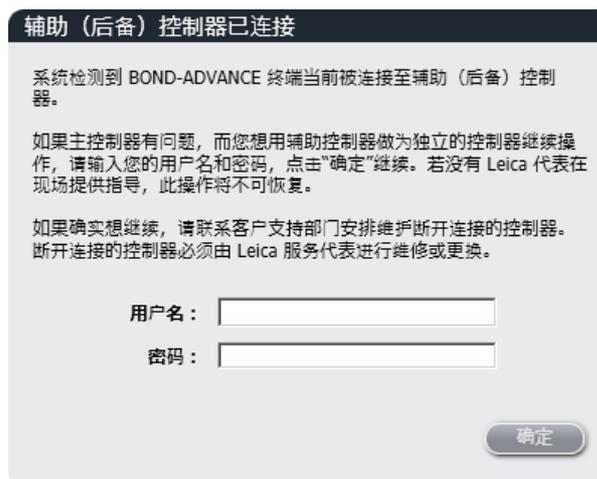


图 159：对话框 – 辅助（后备）控制器已连接

- i** 若没有 Leica Biosystems 代表提供现场支持，该切换不可恢复。
6. 确认您想要继续进行切换：
 - (i) 在提供的字段中输入您的用户名和密码。
 - (ii) 点击**确定**以示确认。
- i** 如果另一用户在您之前选择继续切换，上图所示的对话框将消失。

7. 确认切换后，关闭主控制器电源。
8. 等到系统提示已成功切换至单机后（参阅图 160），重启临床客户端，并按常规登录到系统。



图 160：对话框 – 已成功切换至单机

9. 立即打开管理客户端程序，进行手动数据库备份。参阅 10.5.1 实验室设置。

切换至辅助控制器的操作完成后，所有的玻片和仪器的状态应会自动更新，以显示最近的系统状态。但是，如果某些染色运行是在仪器与控制器断开连接期间完成的，则其运行状态将仍然显示为**进行中**。在这种情况下，您必须解锁受影响的玻片架，以便更新玻片染色装置的状态。

-  联系客户支持部门以安排对断开连接的控制器进行维护。Leica Biosystems 服务代表必须维修或更换断开连接的控制器。

17

更换玻片标签打印机

17.1 在单座系统中更换 Cognitive Cxi 打印机

使用以下程序用新的 Cognitive 打印机更换旧的 Cognitive 打印机。

1. 关闭旧打印机侧面的电源开关。
2. 从旧打印机后部断开 USB 电缆与电源电缆。
3. 将 USB 电缆与电源电缆连接至新打印机。
4. 开启新打印机侧面的电源开关。
BOND 控制器屏幕会在桌面通知区域（右下方）显示一条信息提示发现了打印机。
5. 导航至：**Windows 开始** > **设备和打印机**并找到新添加的打印机。
6. 右键单击该打印机并选择**属性**，然后复制打印机名称。
7. 根据 [10.6.3 玻片标签仪](#)中的描述打开管理客户端、**硬件配置**屏幕、**玻片标签仪**页签。选择您替代的原打印机。
8. 复制名称（覆盖已有名称）至**打印机名称**字段，名称即变更，如“Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT（副本 1）”。
9. 点击**保存**。
10. 打印一张测试标签以确认打印机操作正常。

17.2 在 BOND-ADVANCE 系统中更换 Cognitive Cxi 打印机

在将新打印机连接至 BOND-ADVANCE 系统之前，必须将新打印机的静态 IP 地址设置成与旧打印机具有相同的数值。

打印机的 IP 地址从 192.168.5.101 开始。每台打印机只有最后一个数字不同。例如，第二台打印机的 IP 地址为 192.168.5.102。

以下程序解释了如何查找旧打印机的静态 IP 地址以及如何在新打印机中设置该数值。

Cognitive 打印机前面板

图 161 显示了 Cognitive Cxi 打印机上的键区和液晶显示屏。

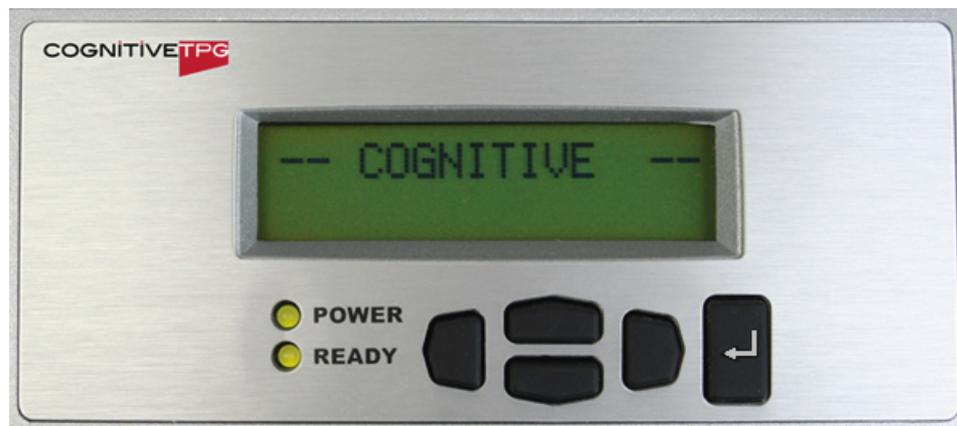


图 161: Cognitive 打印机的液晶显示屏和键区

读取旧打印机的 IP 地址

在旧打印机上执行以下程序以查看新打印机需使用的 IP 地址：

i 如果因某些原因无法使用旧打印机上的显示屏，可在控制器上使用程序[查找打印机 IP 地址](#)查找 IP 地址。

1. 按下 。
屏幕会显示 **Main Menu: Language Menu**。
2. 按下  以显示 **打印机设置** 选项。
3. 按下  以显示 **Printer Setup: Comm. Menu**。
4. 按下  以显示 **Comm. Menu: Timeout**。
5. 按下  两次，以显示 **Ethernet**。
6. 按下 。
屏幕会显示 **Ethernet - DHCP**。
7. 按下 。
屏幕会显示 **DHCP Off**。（如果显示 **DHCP On**，则按下  以更改数值。）
8. 按下 。
屏幕会显示信息：**Value has been set**。
9. 按下  以显示 **Set Static IP**。
10. 按下  以显示当前设置。
11. 记录静态 IP 地址。
12. 关闭该打印机的电源开关，并将该打印机从主电源上断开，以及断开它的网络连接。

设置打印机 IP 地址

执行以下程序以设置新打印机的正确静态 IP 地址。



在执行以下程序之前，请先不要将新打印机连接至 BOND 网络。

1. 将新打印机连接至主电源，在打印机侧面开启电源开关。
2. 按下 。

屏幕会显示 **Main Menu: Language Menu.**
3. 按下  以显示 **打印机设置** 选项。
4. 按下  以显示 **Printer Setup: Comm. Menu.**
5. 按下  以显示 **Comm. Menu: Timeout.**
6. 按下  两次，以显示 **Ethernet.**
7. 按下 。

屏幕会显示 **Ethernet - DHCP**
8. 按下 。

屏幕会显示 **DHCP Off.**（如果显示 **DHCP On**，则按下  以更改数值。）
9. 按下 。

屏幕会显示信息：**Value has been set.**
10. 按下  以显示 **Set Static IP.**
11. 按下  以显示当前设置。
12. 输入您从旧打印机上记录下的 IP 地址。使用左右按钮以将光标向左右移动，并使用上下按钮更改数值。
13. 按下 。

屏幕会显示信息：**Value has been set.**
14. 按下  数次以返回至主 -- **COGNITIVE** -- 屏幕。
15. 将打印机侧面的电源开关切换至“关”的位置，然后重新将其切换至“开”的位置。
16. 将以太网线连接至新打印机，以使其连接至 BOND 网络。



图 162: 以太网接头

17. 打开管理客户端并打印一张测试标签。

查找打印机 IP 地址

如果无法在旧打印机上读取 IP 地址，则使用以下程序来确定新打印机的 IP 地址。

1. 以用户名 BONDDashboard 登录至 BOND-ADVANCE 控制器。
2. 按下 Windows 标志键  + M 以最小化看板屏幕。
3. 在 Windows 任务栏中点击**开始**按钮，然后选择**设备和打印机**。
4. 右键点击相关的 Cognitive 打印机图标并从如图 163 所示的弹出菜单中选择**打印机属性**。

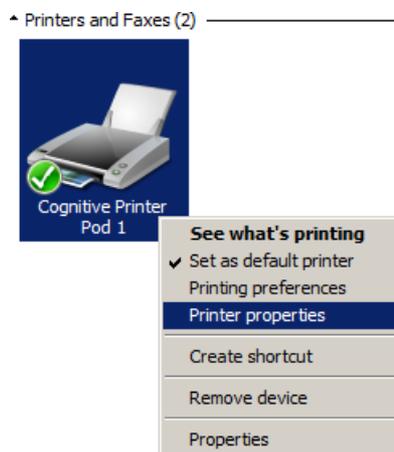


图 163: 选择打印机属性

系统会显示**属性**对话框。

5. 选择**端口**页签。

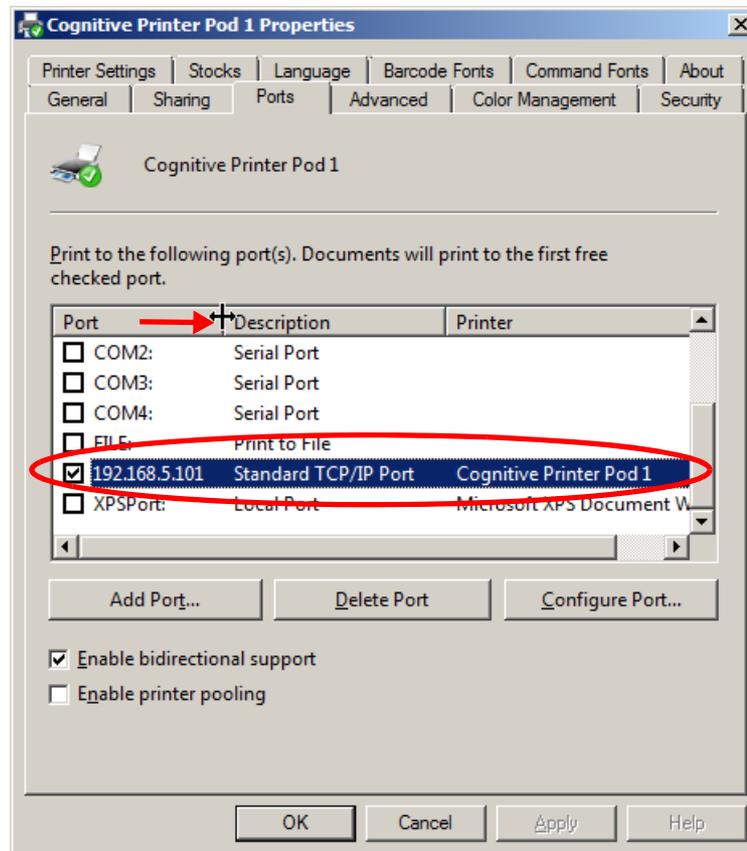


图 164: 打印机属性 – 端口页签

6. 记下端口栏内所选打印机的 IP 地址。（您可通过拖动栏边框来增宽端口栏。）
7. 点击取消关闭该对话框。
8. 关闭设备和打印机窗口。
9. 按下 **Alt+Tab** 以显示 BOND 看板。
10. 使用步骤 6 中记下的 IP 地址来执行设置打印机 IP 地址中的程序。

17.3 在单座系统中用 Cognitive Cxi 打印机更换 Zebra 打印机

使用以下程序用 Cognitive Cxi 打印机更换 Zebra TLP 3842 或 GX430t 打印机。

i 如果 Zebra 打印机是通过“并行”电缆连接的，您可将其从 BOND 控制器上断开。您需要一个 USB 电缆将 Cognitive 打印机连接至 BOND 控制器。

1. 关闭 Zebra 打印机侧面的电源开关。
2. 从打印机后部断开并行或 USB 电缆以及电源电缆。
3. 将 Zebra 打印机电源从主电源上断开。
4. 将 Cognitive 打印机电源连接至主电源。
5. 断开 Cognitive 打印机的 USB 电缆和电源电缆。

6. 开启打印机后部的电源开关。

BOND 控制器屏幕会在桌面通知区域（右下方）显示一条信息提示发现了打印机。

7. 在 Windows 任务栏中点击**开始按钮**，然后选择**设备和打印机**。

8. 确认该打印机显示为“Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT”。

9. 登录至 BOND 管理客户端。

10. 打开硬件屏幕，选择玻片标签仪页签。

11. 点击**添加打印机**（屏幕左下方）。

12. 在屏幕的右侧模板中输入：

- **显示名称**：使用打印机名称：Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
- **打印机名称**：输入同一名称
- **主机名称**：此字段留空。
- **打印机类型**：选择打印机型号：Cognitive Cxi

13. 点击**保存**。

14. 右键单击列表中的 Zebra 打印机。

15. 从弹出选项中选择**删除**。

16. 系统会显示信息：“确定删除该打印机？”

17. 点击**是**。

18

RemoteCare

18.1 概述

RemoteCare 是一项可选服务，能让 Leica Biosystems 的服务人员通过互联网与 BOND 连接，从而为用户提供协助，进行讲解和排除故障。

-  Leica Biosystems 重视患者数据的隐私性并遵守所有的隐私规定。连接后的控制器或终端与 Leica Biosystems 之间传输的全部数据都会被加密以确保安全传输。
-  在所有情况下，都必须有一位您科室的授权用户来允许 Leica Biosystems 代表进行远程访问。

18.2 RemoteCare 操作程序

如果 Leica Biosystems 代表在服务电话访问中提出此要求，请按照以下步骤来允许远程访问。请注意，对于 BOND-ADVANCE 仪器，您只能通过终端机而非控制器进行连接。

1. 如果您希望服务代表连接的控制器（单座）或终端机（BOND-ADVANCE）正处于关闭状态，请将其开启。
2. 确认控制器或终端机的**资产标识**。

-  确认资产标识的正确方法是，右键单击 Windows 通知区域中的 RemoteCare 图标 ，然后单击**配置**。

资产标识即显示在弹出的**设置**对话框中。

当 Leica Biosystems 代表尝试连接至控制器或终端时，将显示**允许远程访问**对话框：

“一名 Leica Biosystems 代表正在请求远程访问。如果您同意该请求而且有权允许远程访问，请输入您的 BOND 软件登录详细信息。”

3. 您必须首先选中“是否同意？”复选框，然后输入您的 BOND 用户名和密码。
4. 点击**接受**按钮。

延迟片刻（Leica Biosystems 代表建立远程访问连接所需的时间）之后，会显示一个新对话框：**远程访问已被允许**，接着显示下一个对话框：**远程会话正在进行中**。

服务代表此时已连接并且可以控制 BOND 系统。

您可以随时点击该对话框中的**取消**按钮使服务代表断开连接。

这时新对话框将显示：**远程会话已结束**。点击**确定**。

5. 在服务代表控制该台控制器或终端期间，您应守在仪器旁边。

如果服务代表需要重启控制器或终端，您必须在重启之后再次登录。

如果您需要在会话期间离开控制器或终端机，应通知服务代表并结束远程会话。若还需要其他工作，应安排在稍后再次连接。

18.3 RemoteCare 状态和版本

若要检查 RemoteCare 的状态，可查看 Windows 通知区域中的 RemoteCare 图标：

图标	说明
	正常 – RemoteCare 运行正常。
	警告 – RemoteCare 出现问题。这可能表示 RemoteCare 服务未运行，或者代理服务器设置不正确。参阅下面的“更改代理服务器设置”。

右击该图标，然后点击**配置**，即可在**设置**对话框中查看当前安装的 RemoteCare 的版本号。

若要重启 RemoteCare 服务，可右击该图标，然后点击**重启**。

18.3.1 更改代理服务器设置

如果相关的代理服务器设置（IP 地址和/或端口号）不正确，RemoteCare 服务将无法运行。检查或更改代理服务器设置的方法是：

1. 右击 Windows 通知区域中的 RemoteCare 图标。
2. 点击**配置**。
3. 在**设置**对话框中，将对话框中显示的 IP 地址和端口号与您的 IT 部门提供的代理服务器设置进行比较。

若有任何不正确的显示值，则按要求更改，然后点击**保存**。

如果数值全都正确，点击**关闭**。

如果代理服务器设置正确而 RemoteCare 仍然出现问题，请联系客户支持部门。

19

规格

- 系统
- 物理规格
- 电功率和不间断电源 (UPS) 要求
- 环境要求
- 工作规格
- 显微镜载玻片
- 运输和储存

系统

网络连接要求	以太网 IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
网线	CAT5e 或 CAT6 屏蔽电缆, 带 RJ-45 接头
以太网交换机:	以太网 IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
单座	8 口以太网交换机 (最多支持 5 台操作仪)
BOND-ADVANCE	8 口或 16 口以太网交换机 (可连接在一起以支持多达 30 台操作仪)
设备规格	控制器、终端机和交换机必须由 Leica Biosystems 提供

物理规格

	BOND-III	BOND-MAX
尺寸	宽 – 790 mm (31.10 英寸) 高 – 1378 mm (54.25 英寸) 长 – 806 mm (31.73 英寸)	宽 – 760 mm (29.9 英寸) 高 – 703 mm (27.6 英寸) 长 – 775 mm (30.5 英寸)
重量 (干燥状态)	238 千克 (525 磅)	120 千克 (265 磅)
空间要求	上方 600 mm (24 英寸) 左侧 0 mm 右侧 150 mm (6 英寸) 后部 0 mm, 但用户必须能够在不移动操作仪的情况下断开主电源线连接。	
距外部大废液容器的最大距离 (仅 BOND-MAX)	~	1 米 (40 英寸)

电功率和不间断电源 (UPS) 要求

	BOND-III	BOND-MAX
工作电压 (使用较新型号电源、后部防护罩中有两个风扇的仪器)	220 V~	220 V~
电源频率	50 Hz	50 Hz
功率消耗	1200 VA	1000 VA

环境要求

	BOND-III	BOND-MAX
最高工作温度	35°C (95°F)	35°C (95°F)
最低工作温度	5°C (41°F)	5°C (41°F)
符合染色操作标准所需的温度	18–26°C (64–79°F)	18–26°C (64–79°F)
工作湿度 (无冷凝)	30 - 80% RH	30 - 80% RH
最大工作海拔	海拔 0 - 1600 米 (5250 英尺)	海拔 0 - 1600 米 (5250 英尺)
声压级输出 (1 米处)	< 85 dBA 最大 < 65 dBA 正常工作	< 85 dBA 最大 < 65 dBA 正常工作
最大热能输出	1200 VA	1000 VA

工作规格

	BOND-III	BOND-MAX
玻片处理能力	每次 30 张。 已结束运行的玻片架（10 张玻片）可接着再次放入玻片。	
试剂容器容量	7 mL 和 30 mL	7 mL 和 30 mL
试剂容器的无效容量	555 μ L（7 mL）和 1618 μ L（30 mL）	
试剂容器储备容量	280 μ L（7 mL）和 280 μ L（30 mL）	
滴定容器容量	6 mL	6 mL
滴定容器的无效容量	300 μ L	300 μ L
滴定容器的储备容量	280 μ L	280 μ L
试剂容器数量	36	36
大容量试剂容器容量	2 L 或 5 L	1 L 或 2 L
有害废液容器容量	5 L	2 L
标准废液容器容量	2 x 5 L	~
外部大废液容器容量	~	9 L
化学兼容性	所有 BOND 试剂 70% 酒精溶液（用于清洁）	
温度指示	默认值（可由服务代表进行更改）： 温热：35°C；高热：80°C	
气体和液体连接的最大允许压力	1.0 bar	2.5 bar

显微镜载玻片

尺寸	宽度：24.64 - 26.0 mm（0.97 - 1.02 英寸） 长度：74.9 - 76.0 mm（2.95 - 2.99 英寸） 厚度：0.8 - 1.3 mm（0.03 - 0.05 英寸）
标签区域	宽度：24.64 - 26.0 mm（0.97 - 1.02 英寸） 长度：16.9 - 21.0 mm（0.67 - 0.83 英寸）
材料	玻璃，ISO 8037/1 标准
可用区域	参考下面的示意图。分配容量指使用 BOND 软件设置玻片时可以选择的设定值（参阅 6.3 使用病例 ）


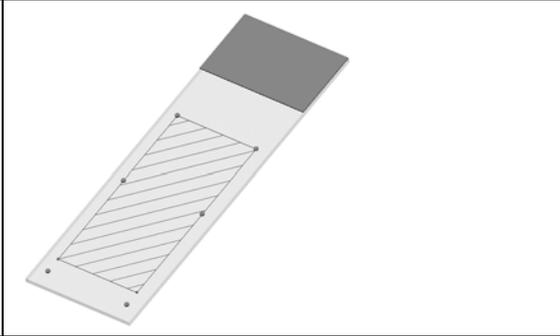
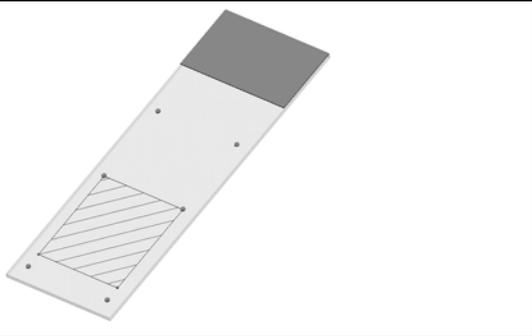
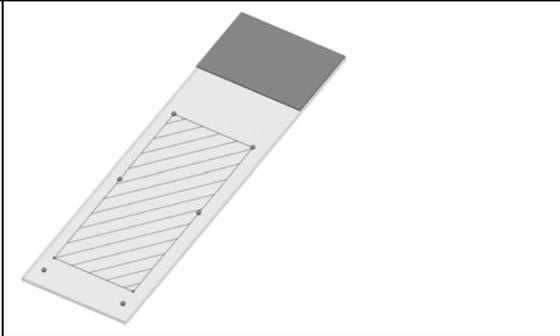
	100 μ L	150 μ L
BOND-III		
BOND-MAX		

图 165: BOND 操作仪玻片的可用区域

运输和储存

储存温度	-20 至 +55 °C (-4 至 +131 °F)
储存湿度 (无凝结)	< 80% RH
运输方式	陆运、空运和海运皆可。

请注意：上述信息仅针对包装的仪器。

关于打开包装的仪器，请参阅[环境要求](#)中的信息。

索引

A

安全性通告 4
安装与运输危险 8

B

BOND Aspirating Probe Cleaning System 247
BOND 控制器 64
BOND 链霉亲和素-生物素检测系统 273
BOND Polymer Refine Detection System 271
BOND 系统 30
BOND 系统管理器 285
BOND 系统架构 64
BOND-ADVANCE, 说明 65
帮助 74
 访问 25
报告 73
 病例 180
 玻片处理概要 181
 玻片设置 132
 程序 151
 导出玻片 182
 试剂使用 171
 系统 74
 运行事件 178
 运行详细信息 179
 摘要玻片历史 183
保留时间, 病例 120
保险丝 262
备份数据库 198
表格, 排序 70
标签
 打印 130
 概述
 快速入门 81
 设置 187
 和实验室信息系统 (LIS) 225
 信息类型 192
标签 ID 131
标签仪, 玻片 57
病例
 编辑 121
 标识 118
 复制 121
 激活 120
 即时创建 133
 默认设置 197
 删除 121
 实验室信息系统 (LIS) 218
 输入详细信息, 快速入门 78
 添加 119

 完成 120
 重复 120
病例 ID
 实验室信息系统 (LIS), 重复 187
 与病例编号 118
病例和玻片默认设置 197
并行双染 139
玻璃玻片
 规格 306
玻片
 编辑 127
 不兼容 101
 导出数据 182
 复制 127
 即时创建 133
 兼容性 136
 默认设置 197
 扫图后状态 99
 删除 127
 设置 123
 屏幕 115
 设置, 概述 114
 设置, 快速入门 78
 设置报告 132
 使用位置 128
 输入详细信息, 快速入门 79
 添加 125
 脱蜡玻片 131
 识别, 手动 127
 识别, 手动在机 102
 装载 81
 自动识别 102
玻片 ID 131
玻片, 玻璃, 类型和尺寸 58
玻片标签, 查看玻片
玻片标签仪 57
 清洗和维护 259
玻片处理概要 181
玻片架 60
玻片历史 174
 定义时间范围 176
 屏幕 174
玻片染色装置 39
 加热器 40, 92
 清洁和维护 240
 手动解锁 243
 温度指示 93
 状态 89
不兼容玻片 101
布局, 标签 187

C

Covertile 59
 清洁和维护 239
 操作危险 8
 操作仪
 初始化 37
 规格 305
 配置 199
 清洗和维护 227
 说明 31
 页签 89
 运输和存储 307
 重启 246
 状态 90
 操作员, 用户角色
 设置 184
 说明 68
 承滴盘 253
 大容器 254
 仪器承滴盘 255
 程序 138
 报告 151
 编辑 145, 194
 编辑用于双染 141
 查看 143
 导入 150
 结束运行 86
 列表 142, 186
 染色 152
 设置屏幕 138
 试剂段, 说明 145
 新 145
 预定义程序 152
 预染 153
 运行 85
 运行概述 27
 制备 153
 状态屏幕 110
 抽吸探针
 更换 247
 清洗 247
 说明 49
 初始步骤 26

D
 大容量容器
 禁用 201
 大容器 44
 清洗和维护 232
 状态 97
 大容器照明系统 46
 打印报告 73

打印玻片标签 130
 打印机
 玻片标签仪 57
 大用量液流探针
 清洗 257
 大用量液流自控装置, 说明 50
 大用量液流自控装置探针
 更换 258
 单座安装 64
 导出报告 73
 导出玻片数据 182
 登记试剂和检测系统 167
 滴定容器 61
 滴定试剂盒 275
 电气危险 6
 电源保险丝 262
 电源开关 53
 对照
 免疫组化 (IHC) 阴性试剂 278
 使用 115
 原位杂交 (ISH) 试剂 279
 组织 278
 多座安装 64, 65

F

法规通告 10
 防护罩
 清洗 251
 访问级别, 参阅用户角色
 访问级别, 查看用户角色
 废液容器
 清洗和维护 237
 说明 62
 状态 97
 分配类型 151
 分配容量 128
 符号 283
 服务日志 75

G

盖板, 重新放置 242
 更新软件 75
 更新数据库数据 194
 功能栏 69
 工作单元 65
 工作流程
 即时玻片和病例创建 133
 日常病例选项 122
 关闭软件 66
 管理客户端 184
 管理员, 用户角色
 设置 184
 说明 68

关于 BOND, 对话框 74
规格

BOND 系统 304
玻璃玻片 306
操作仪 305

H

红色, 检测系统 272
红色, 突出显示在试剂清单屏幕上 166
后部防护罩, 说明 54
恢复数据库 198
混合站 49

J

ID 扫描仪, 手持式
 登记试剂 168
ID 扫图仪 38
 清洗和维护 251
激活
 BOND 病例 120
 实验室信息系统 (LIS) 病例 187
即时玻片和病例创建 133
机械危险 6
加热器 40
加热器错误 92
检测系统

BOND 链霉亲和素-生物素 273
Bond Polymer Refine 271
Bond Polymer Refine Red 272
BOND, 概述 271
 登记 167
 清单报告 170
 说明 61

检测验证 277

兼容性

 玻片 136

角色, 用户 68

 设置 184

结束运行 86

浸入测试 164

禁用大容量容器 201

警报 72

警告 72

K

开放容器 61

 重新灌装 167

看板 71

抗原修复 131

烤片 276

科室, 设置 196

空, 标记试剂包为 166

控制器, 见 BOND 控制器 64
快速入门 76

L

LIS 集成组件
 术语 217

M

密码, BOND 185
免疫组化 (IHC), 原理 270
模板
 编辑 173
 创建 172
 屏幕 172
 添加 128
模板, 标签 187

O

OCR (光学字符识别) 102

P

PDF, 报告 73
配伍性
 大容量试剂和辅助试剂 161

Q

启动运行 108
 延迟启动 109
前部防护罩 41
清单屏幕, 试剂 162
清洗 227
清洗时间表 229
清洗液流系统, 维护程序 246

R

RemoteCare 302

染色

 解释 281

染色方法 126, 139

日常病例选项 122

日志, 服务 75

软件

 概述 63

 更新 75

 关闭 66

 启动 66

S

扫描仪, 手持式
 登记检测系统 168
 清洗和维护 264
 说明 56

- 删除
 - 病例 121
 - 玻片 127
 - 试剂 161
 - 仪器组 203
 - 商标 2
 - 设置
 - 玻片 78
 - 试剂 82
 - 设置 BOND 系统 184
 - 试剂 154
 - 登记 167
 - 管理 154
 - 解决问题 96
 - 空试剂包 166
 - 模板屏幕 172
 - 清单报告 170
 - 清单屏幕 162
 - 确定量 164
 - 删除 161
 - 设置屏幕 158
 - 使用报告 171
 - 手动识别 169
 - 替代 157
 - 添加/编辑 160
 - 识别 157
 - 重新灌装开放容器 167
 - 装载 82
 - 试剂步骤（程序中）
 - 重复 147
 - 试剂段
 - 编辑 147
 - 说明 145
 - 试剂段，试剂
 - 编辑 147
 - 试剂段，试剂，程序中，说明 145
 - 试剂架
 - 说明 60
 - 试剂危险 9
 - 试剂状态 93
 - 时间表
 - 清洗和维护 229
 - 实验室设置 196
 - 实验室信息系统（LIS）玻片数据字段 187
 - 实验室信息系统（LIS）集成软件
 - 状态模板 218
 - 实验室信息系统（LIS）集成组件 216
 - 病例 218
 - 病例及玻片数据 223
 - 玻片 219
 - 玻片标签 225
 - 错误 222
 - 获取实验室信息系统（LIS）数据 220
 - 连接与初始化 221
 - 实验室信息系统（LIS）属性 220
 - 通用标记名称 219
 - 许可 186
 - 优先玻片 220
 - 在 BOND 中的设置 186
 - 手持式条形码扫描仪
 - 登记检测系统 168
 - 清洗和维护 264
 - 说明 56
 - 手动玻片识别 127
 - 数据库 75
 - 备份 198
 - 数据库更新 194
 - 数据字段，实验室信息系统（LIS）玻片 187
 - 双染 139
 - 顺次双染 139
 - 所需材料 274
- T**
- 探针分配 140
 - 替代试剂 157
 - 添加
 - 病例 119
 - 玻片 125
 - 模板 128
 - 试剂 160
 - 条形码扫描仪，查看手持式条形码扫描仪
 - 条形码扫描仪，手持式
 - 说明 56
 - 停止运行 108
 - 通用标记名称 219
 - 通知 72
 - 脱蜡 131, 276
- W**
- 维护 227
 - 维护，预防性 228
 - 维护报告 112
 - 维护屏幕 111
 - 维护时间表 229
 - 危险
 - 安装与运输 8
 - 操作 8
 - 电气 8
 - 化学 6
 - 机械 6
 - 试剂 9
 - 唯一包装标识符（UPI）157
 - 温度，指示 93
 - 无效容量 49

X

洗涤区 49
 系统
 报告 74
 构架 64
 规格 304
 说明 30
 状态屏幕 88
 系统启动
 检查 76
 修订记录 195
 修复 276
 许可, LIS-ip 186

Y

延迟启动 109
 页签, 操作仪, 在系统状态屏幕上 89
 液位感应 (LLS) 164
 已处理病例保留时间 120
 已过期病例 120
 遗留数据报告 73
 仪器盖 37
 清洗 251
 仪器组
 管理 202
 说明 64, 65
 医生名单 122
 硬件配置 199
 硬件状态 91
 用户, 创建和编辑 184
 用户角色 68
 设置 184
 用户名 185
 用途声明 2
 有害废液 161
 优先玻片, LIS 220
 预防性维护 228
 原位杂交 (ISH), 原理 271
 运输 307
 运行程序, 简短概述 27

Z

识别玻片
 手动 127
 手动在机 102
 自动 102
 质量控制 277
 益处 280
 治疗诊断, 综述 273
 终端 64

重复病例 ID
 BOND 病例 120
 实验室信息系统 (LIS) 病例 187
 重复试剂步骤 (程序中) 147
 重新灌装开放容器 167
 主管, 用户角色
 设置 184
 说明 68
 注射器 52
 清洁和维护 259
 状态屏幕 87
 玻片状态 99
 程序 110
 大容器 97
 试剂状态 93
 实验室信息系统 (LIS) 218
 系统 88
 硬件状态 91
 装载玻片 81
 自动玻片识别 102
 自控装置
 大用量液流 50
 大用量液流导轨 50
 主自控装置和 ID 扫图仪 38
 主自控装置清洗和维护 251
 组织制备 276
 最低库存设置 166