

Advancing Cancer Diagnostics  
Improving Lives

**Leica**  
BIO SYSTEMS

# System BOND

W pełni automatyczny  
system barwienia IHC i ISH

Instrukcja obsługi

Dla systemów BOND  
korzystających z oprogramowania  
BOND 6.0

NIE do użytku w USA i Chinach



CE

Strona celowo pozostawiona pusta.

# Informacje prawne

## Oświadczenie dotyczące przeznaczenia

System BOND automatyzuje protokoły kliniczne immunobarwienia próbek patologicznych umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych. Szkiełka mikroskopowe są następnie interpretowane przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w celu ułatwienia rozpoznania.

## Znaki towarowe

Leica i logo Leica to zarejestrowane znaki towarowe firmy Leica Microsystems IR GmbH wykorzystywane w ramach licencji. BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer i Oracle to znaki handlowe Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Inne znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.

## Prawa autorskie

Firma Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd jest właścicielem praw autorskich do tego dokumentu i powiązanego oprogramowania. Zgodnie z prawem, nasze pisemne pozwolenie jest wymagane przed kopiowaniem, przetwarzaniem, tłumaczeniem lub konwertowaniem niniejszego dokumentu w formie elektronicznej lub innej w całości lub w jego części.

Dok. 21.7733.520 Wer. A05

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, Melbourne, Australia, 2021

## Producent



Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd  
495 Blackburn Road  
Mount Waverley VIC 3149  
Australia

## Ważne informacje dla wszystkich użytkowników

Termin „Leica Biosystems” użyty w tekście niniejszego dokumentu odnosi się do Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

Ze względu na politykę ciągłego doskonalenia Leica Biosystems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Roszczenia gwarancyjne można składać tylko wtedy, gdy system był używany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego postępowania z produktem i/lub niewłaściwego użytkowania produktu powodują unieważnienie gwarancji. Leica Biosystems nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody.

Osoby obsługujące moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX muszą być odpowiednio przeszkolone i ostrzeżone przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami lub niebezpiecznymi procedurami przed uruchomieniem urządzenia. Tylko przeszkolony personel może usuwać osłony lub części z modułu przetwarzania i wyłącznie w przypadku, gdy jest to zgodne z niniejszą instrukcją.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy autoryzowany przez Leica Biosystems.

Wszelkie poważne zdarzenia, które doprowadziły lub mogą prowadzić do zgonu pacjenta lub użytkownika, bądź do tymczasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, należy zgłaszać miejscowemu przedstawicielowi firmy Leica Biosystems i odpowiedniemu lokalnemu organowi regulacyjnemu.

### Historia zmian

Wer.	Wydano	Zmienione części	Szczegóły
A01	-	-	Nieopublikowany
A02	-	-	Nieopublikowany
A03	Marsz 2020 r.	Wszystkie	Opublikowane po raz pierwszy
A04	Listopad 2020 r.	<a href="#">Informacje dotyczące przepisów</a>	Zaktualizowano
A05	Grudzień 2021	<a href="#">Słowniczek symboli</a> <a href="#">Oświadczenie dotyczące przeznaczenia</a> <a href="#">Ważne informacje dla wszystkich użytkowników</a> <a href="#">Oznakowanie CE i informacje Unii Europejskiej</a> <a href="#">Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urządzenia</a> <a href="#">Specyfikacje</a> <a href="#">Ostrzeżenia ogólne</a> <a href="#">Podłączanie i inicjalizacja LIS</a> <a href="#">Ręczny skaner kodów kreskowych Zebra DS2208</a>	Zaktualizowano o nowe informacje w celu wsparcia IVDR. Usunięcie 12.9.1 Ponowna inicjalizacja czytnika ID. Dodanie instrukcji konfiguracji Zebra DS2208. Премахнати 18 RemoteCare.

### Kontakt z Leica Biosystems

Aby uzyskać pomoc techniczną, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Leica Biosystems lub odwiedzić stronę [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy stosować wszystkie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia obrażeń ciała, uszkodzeń, utraty lub błędnej identyfikacji próbek pacjenta oraz uszkodzenia sprzętu.

## Rodzaje informacji o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji to ostrzeżenia lub przestrogi.

### Ostrzeżenia

Ostrzeżenia to informacje o zagrożeniach, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub utraty, uszkodzenia lub błędnej identyfikacji próbek pacjenta.

Ostrzeżenia wykorzystują symbole z czarnym obramowaniem i żółtym tłem, jak pokazano poniżej:



Niebezpieczeństwo zgniecenia. Możliwość zmiżdżenia części dłoni lub ciała.



Niebezpieczeństwo związane z wysoką temperaturą. Gorące powierzchnie powodują oparzenia w przypadku dotknięcia.

Unikać dotykania części oznaczonych tym symbolem.



Zagrożenie chemiczne. Istnieje niebezpieczeństwo poważnego wpływu na zdrowie w przypadku braku stosowania odpowiednich środków ostrożności.

Zawsze nosić odzież ochronną i rękawice ochronne.

Natychmiast usunąć rozlane płyny stosując standardową procedurę laboratoryjną.



Niebezpieczeństwo związane z laserem. Możliwość poważnego urazu oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z laserem.



Uwaga. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie systemu lub obrażenia ciała. Przed kontynuowaniem należy zapoznać się z załączonym tekstem lub odpowiednią dokumentacją.



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonej dokumentacji, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń.



Zagrożenie dotyczące substancji toksycznych. Istnieje niebezpieczeństwo poważnego wpływu na zdrowie w przypadku braku stosowania odpowiednich procedur

obchodzenia się z substancjami chemicznymi.

Podczas pracy z odczynnikami należy stosować rękawiczki i okulary ochronne.



Zagrożenie dotyczące substancji łatwopalnych. W przypadku braku stosowania odpowiednich środków ostrożności łatwopalne odczynniki mogą ulec zapłonowi.

### Przestrogi

Przestrogi to informacje o zagrożeniach, które mogą prowadzić do uszkodzenia systemu BOND lub innych niepożądanych konsekwencji, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi.

Ostrzeżenia wykorzystują symbole z czarnym obramowaniem i białym tłem, jak pokazano poniżej:



### **Ostrzeżenia ogólne**

Ogólne ostrzeżenia dotyczące systemu BOND są opisane poniżej. Inne ostrzeżenia znajdują się w odpowiednich częściach instrukcji.

### Obsługa urządzenia



Aby uniknąć zanieczyszczenia odczynników i szkiełek, urządzenie powinno być użytkowane w czystym środowisku, w miarę możliwości wolnym od kurzu i cząstek stałych.



Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy umieścić każdy zbiorczy pojemnik z odczynnikami w odpowiednim przedziale, zgodnie z oznaczeniami kolorystycznymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na barwienie.

Więcej informacji znajduje się w części [2.2.7 - Przedział na pojemniki zbiorcze](#)




Sprawdzić poziomy pojemników zbiorczych i napełnić lub opróżnić je, w zależności od potrzeb, na początku każdego dnia (częściej, jeśli jest to konieczne – zob. [12.2.1 - Sprawdzanie poziomów w pojemnikach](#)). W przeciwnym razie konieczne może być przerwanie barwienia w celu usunięcia pojemników, co może negatywnie wpłynąć na barwienie.




Jeśli pojemnik zbiorczy wymaga napełnienia podczas przetwarzania, należy zawsze sprawdzać ekran **Protocol status** (status protokołu) i upewnić się, że pojemnik nie jest używany ani nie będzie wkrótce używany. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować pogorszeniem jakości przetwarzania szkiełek. Pojemnik należy umieścić ponownie natychmiast po napełnieniu – zob. [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#).


Pojemniki zbiorcze BOND nie muszą być wyjmowane w celu napełniania – zob. [12.2.2.1 - Napełnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki – BOND-III](#).

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy codziennie sprawdzać poziomy cieczy w pojemnikach zbiorczych (lub częściej, jeśli jest to wymagane – zob. [12.2.1 - Sprawdzanie poziomów w pojemnikach](#)).


	<p>Do funkcjonowania systemu BOND i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem nie potrzeba dostępu do sieci. Aby zapobiegać złośliwemu lub nieautoryzowanemu dostępowi, należy zainstalować BOND bez połączenia z siecią/infrastrukturą.</p> <p>Jeśli chce się mieć połączenie sieciowe, najlepiej połączyć BOND z wirtualną siecią lokalną (VLAN) zabezpieczoną zaporą sieciową firewall. Można również ustanowić i weryfikować własne mechanizmy zabezpieczenia sieci zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi. Więcej informacji podano w Przewodniku po systemach informacyjnych BOND 5.1+ (49.6062.811).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Zainfekowanie kontrolera oprogramowaniem złośliwym może powodować nieoczekiwane zachowania i działania systemu, z wyłączeniem przyrządów włącznie. Przed przyłączeniem pamięci USB do sterownika należy upewnić się, że jest wolna od wirusów. Ponieważ Leica Biosystems nie instaluje programów antywirusowych, zalecamy zainstalowanie własnego oprogramowania antywirusowego. Więcej informacji można uzyskać od miejscowych przedstawicieli Leica Biosystems.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Kontrole


	<p>Należy opracować i stosować odpowiednie środki kontroli laboratoryjnej, aby zapewnić prawidłowy wynik barwienia dla każdego szkiełka. Leica Biosystems zdecydowanie zaleca umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tych samych szkiełkach, co tkanka pacjenta.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Zagrożenia chemiczne

	<p>Niektóre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ są niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynności należy odbyć odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas tej procedury.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urządzenia należy nosić rękawiczki lateksowe lub nitylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie środki ochronne.</li> <li>Odczynniki i kondensat należy transportować i utylizować zgodnie ze wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowiązującymi w laboratorium.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Pojemniki na odczynniki mogą przewrócić się podczas transportu, pozostawiając resztki odczynnika wokół pokrywy. Podczas otwierania pojemników na odczynniki należy zawsze nosić zatwierdzone środki ochrony oczu, rękawice i odzież ochronną.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Potencjalnie niebezpieczne odczynniki mogą gromadzić się wokół zespołów barwienia szkiełek i zanieczyszczać tacę na szkiełka. Podczas pracy z tacami na szkiełka należy zawsze nosić zatwierdzoną odzież ochronną i rękawice ochronne.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Niektóre z odczynników używanych w modułach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX są łatwopalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie umieszczać płomienia ani źródła zapłonu w pobliżu modułów przetwarzania.</li> <li>Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Moduły przetwarzania wyposażone są w podgrzewacze i gorące powierzchnie, które mogą tworzyć ryzyko zapłonu, jeśli materiały łatwopalne zostaną umieszczone w bliskiej odległości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie umieszczać łatwopalnych materiałów na podgrzewaczach ani w ich pobliżu.</li> <li>• Nie umieszczać materiałów łatwopalnych na jakichkolwiek gorących powierzchniach modułu przetwarzania.</li> <li>• Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Zagrożenia mechaniczne


	<p>Należy zachować ostrożność podczas zamykania pokrywy urządzenia, aby uniknąć urazu dłoni.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Podczas pracy główny robot, sonda aspiracyjna, pompy strzykawek i roboty odczynników zbiorczych (BOND) mogą poruszać się bez ostrzeżenia i z prędkością, która może spowodować obrażenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie próbować otwierać pokrywy urządzenia w trakcie przebiegu.</li> <li>• Nie należy podejmować prób obejścia blokady zatrzymującej urządzenie po otwarciu pokrywy.</li> <li>• Upewnić się, że pokrywy pompy strzykawki znajdują się na swoich miejscach podczas pracy.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










	<p>Unikać kontaktu z zespołami barwienia szkiełek i podzespołami znajdującymi się w ich pobliżu. Mogą one być bardzo gorące i powodować poważne oparzenia. Po wyłączeniu odczekać dwadzieścia minut, aż zespoły barwienia szkiełek i ich otoczenie ostygną.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Skontaktować się z działem obsługi klienta w celu transportu modułu roboczego na dużą odległość lub w celu naprawy lub utylizacji. Moduł przetwarzania jest bardzo ciężki i nie jest przeznaczony do przenoszenia przez użytkownika.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Upewnić się, że drzwi strzykawki są zamknięte (BOND-MAX) lub zamontowana jest pokrywa strzykawki (BOND-III) podczas normalnej pracy. Jeśli strzykawka lub złącze strzykawki ulegną poluzowaniu, odczynnik pod ciśnieniem może wydostać się ze strzykawki.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Jeżeli robot główny i/lub roboty odczynników zbiorczych nadal działają przez ponad pięć sekund po otwarciu pokrywy modułu przetwarzania, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Nie przesuwaj ramienia głównego robota, gdy moduł przetwarzania jest włączony. Może dojść do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidłowego barwienia.</p> <p>Jeśli ustawienie robota uległo zmianie: wyłączyć urządzenie, odczekać 30 sekund, a następnie ponownie je uruchomić.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Należy zawsze wyłączać moduł przetwarzania podczas czyszczenia lub konserwacji (z wyjątkiem automatycznych zadań czyszczenia, takich jak czyszczenie sondy aspiracyjnej).</p>
	<p>Roboty odczynników zbiorczych BOND przemieszczają się wzdłuż zespołów barwienia szkiełek, zapewniając dostęp do czyszczenia. Procedura ta powinna być wykonywana wyłącznie przez operatorów, którzy zostali ostrzeżeni o potencjalnych zagrożeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.</p>
	<p>Zespoły barwienia szkiełek zawierają ruchome części, które mogą spowodować poważne obrażenia. Podczas pracy urządzenia trzymać palce z dala od otworu zespołu barwienia szkiełek.</p> <p>Przed przystąpieniem do ręcznego odblokowania zespołów barwienia szkiełek: wyłączyć moduł przetwarzania za pomocą wyłącznika zasilania, wyłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazda ściennego.</p>
	<p>Moduł pompy strzykawki (BOND-III) jest ciężki i może przewrócić się w przód po zwolnieniu. Procedura ta powinna być wykonywana wyłącznie przez operatorów, którzy zostali ostrzeżeni o potencjalnych zagrożeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.</p>
	<p>Nie używać dwóch czarnych uchwytów na tylnej osłonie BOND do podnoszenia urządzenia.</p>
<p><u>Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.</u></p>	
	<p>Nie zdejmować osłon modułu przetwarzania ani nie próbować uzyskać dostępu do wewnętrznych elementów. Wewnątrz modułu przetwarzania BOND znajduje się prąd o wysokim napięciu i wyłącznie wykwalifikowani serwisanci zatwierdzeni przez Leica Biosystems mogą wykonywać te czynności.</p>
	<p>Nie należy zmieniać napięcia roboczego modułu przetwarzania. Jeśli urządzenie zostanie podłączone do niewłaściwego napięcia zasilania, może dojść do poważnych uszkodzeń. Skontaktować się działem obsługi klienta, aby zmienić to ustawienie.</p>
	<p>Moduł roboczy musi być podłączony do uziemionego gniazda zasilania sieciowego i ustawiony tak, aby personel mógł łatwo odłączyć przewód zasilania bez konieczności przemieszczania urządzenia.</p>
	<p>Nie omijać ani nie zwierać bezpieczników.</p> <p>Przed wymianą bezpieczników wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający. Bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na standardowe części. Jeśli bezpieczniki wielokrotnie się przepalają, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.</p>



## Przestrogi ogólne

Ogólne przestrogi BOND opisano poniżej. Inne przestrogi znajdują się w odpowiednich częściach instrukcji.

### Zagrożenia związane z instalacją



Nie należy blokować otworów wentylacyjnych znajdujących się na tylnej osłonie urządzenia. Nie należy również zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się na drzwiach strzykawki (BOND-MAX).

### Zagrożenia dotyczące obsługi



Wszystkie części etykiety szkiełka powinny znajdować się w obszarze ograniczonym krawędziami szkiełka. Odsłonięta powierzchnia samoprzylepna może spowodować przywarcie etykiety (i szkiełka) do szkiełka nakrywkowego Covertile lub innego elementu i uszkodzenie szkiełka.



Nie zdejmować małej nakrętki czujnika poziomu cieczy z pojemnika zbiorczego (BOND-MAX), ponieważ może ona ulec uszkodzeniu. Pojemniki zbiorcze należy opróżniać i napełniać wyłącznie przez duży otwór do napełniania/oprózniania.



Wszystkie wyjmowane elementy należy czyścić wyłącznie ręcznie. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć żadnego elementu w zmywarce. Nie czyścić żadnych części przy użyciu rozpuszczalników, środków czyszczących zawierających substancje ściernie ani szorstkich ściereczek.



Nie używać patyczków do uszu ani innych aplikatorów z bawełnianą końcówką do czyszczenia otworów w bloku myjącym lub słupków do odprowadzania wilgoci w zespole barwienia szkiełek, ponieważ końcówka bawełniana może się oderwać i zablokować otwór.



Nie używać siły podczas ponownego montażu pojemników zbiorczych w odpowiedniej pozycji, ponieważ może dojść do uszkodzenia pojemnika i czujnika cieczy.



Nie używać uszkodzonych szkiełek. Przed załadowaniem do modułu przetwarzania upewnić się, że wszystkie szkiełka są prawidłowo ustawione na tacach na szkiełka oraz że wszystkie szkiełka nakrywkowe Covertile są prawidłowo ustawione (zob. [2.6.2 - BOND Universal Covertiles](#)).



Upewnić się, że moduł strzykawki (BOND-III) jest całkowicie zamknięty przed rozpoczęciem przebiegu lub inicjalizacją modułu przetwarzania (zob. [12.4.1 - Ręczne odblokowanie zespołów barwienia szkiełek](#)). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia strzykawkę podczas pracy.



Przed czyszczeniem lub demontażem płyty górnej należy upewnić się, że roboty odczynników zbiorczych (BOND-III) znajdują się w pozycji wyjściowej w tylnej części urządzenia i nie są umieszczone wzdłuż zespołów barwienia szkiełek.

#### Zagrożenia związane z odczynnikami



W przypadku kontaktu niekompatybilnych ze sobą roztworów może dojść do uzyskania niezadawalających wyników barwienia i potencjalnego uszkodzenia modułu przetwarzania. Skontaktować się z firmą Leica Biosystems, aby ustalić, czy roztwory są kompatybilne.



Nie stosować ksyłenu, chloroformu, acetonu, silnych kwasów (np. 20% HCl), silnych zasad (np. 20% NaOH) w module przetwarzania BOND. Jeśli którakolwiek z tych substancji chemicznych zostanie rozlana na lub w pobliżu urządzenia BOND, należy natychmiast wyczyścić wyciek za pomocą alkoholu o stężeniu 70%, aby zapobiec uszkodzeniu modułu przetwarzania.



W urządzeniach BOND-III oraz BOND-MAX używać wyłącznie roztworu BOND Dewax Solution. Nie używać ksyłenu, zamienników ksyłenu ani innych odczynników, które mogą rozkładać części systemu BOND i powodować wyciek płynu.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# Informacje dotyczące przepisów

## Symbol diagnostyki in vitro



## Zgodność FCC

Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 podrozdziałem B zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest użytkowane w środowisku komercyjnym. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Eksploatacja tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie musiał usunąć na własny koszt.

Aby zachować zgodność z przepisami, należy używać wyłącznie kabli dostarczonych z urządzeniem.

**Ostrzeżenie:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Leica Biosystems mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego urządzenia.

## Oznakowanie CE i informacje Unii Europejskiej



Znak CE oznacza zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE wymienionymi w deklaracji zgodności producenta.

## Instrukcja obsługi urządzenia do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnego

Niniejsze urządzenie do diagnostyki in vitro spełnia wymogi normy IEC 61326, części 2-6, dot. emisji i odporności.

Środowisko elektromagnetyczne powinno zostać sprawdzone przed uruchomieniem urządzenia.

Nie używać tego urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. nieekranowanych celowych źródeł fal radiowych), ponieważ mogą one zakłócać jego prawidłowe działanie.

**Ostrzeżenie:** Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane pod kątem CISPR 11, klasa A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których może być konieczne podjęcie działań mających na celu ograniczenie zakłóceń.

Wymagania prawne dotyczące komputerów: Certyfikat UL (UL 60950), certyfikat IEC 60950.

## Klasyfikacja urządzenia zgodnie z CISPR 11 (EN 55011)


Niniejsze urządzenie jest sklasyfikowane jako grupa 1 klasy A zgodnie z CISPR 11 (EN 55011). Grupy i klasy opisano poniżej.

**Grupa 1** – Dotyczy to wszystkich urządzeń, które nie są sklasyfikowane jako sprzęt grupy 2.

**Grupa 2** – Dotyczy to wszystkich urządzeń RF ISM, w których energia o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 KHz do 400 Ghz jest celowo generowana i używana lub używana wyłącznie w formie promieniowania elektromagnetycznego, indukcyjnego i/lub pojemnościowego, do obróbki materiałów lub ich kontroli/analizy.

**Klasa A** – Dotyczy to wszystkich urządzeń, które nadają się do użytku we wszystkich budynkach innych niż mieszkalne i są bezpośrednio podłączone do sieci zasilania niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne.

**Klasa B** – Dotyczy to wszystkich urządzeń, które nadają się do użytku w budynkach mieszkalnych i są bezpośrednio podłączone do sieci zasilania niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne.

 ISM: Przemysłowe, naukowe i medyczne

RF: Częstotliwość radiowa

## Słowniczek symboli

### Symbole regulacyjne

Objaśnienie symboli regulacyjnych stosowanych dla produktów Leica Biosystems.







**Uwaga:** Niniejszy słownik zawiera obrazy symboli przedstawionych w odpowiednich normach, jednak niektóre z używanych symboli mogą się różnić kolorem.

Poniżej znajduje się lista symboli używanych na etykiecie produktu i ich znaczenie.


### ISO 15223-1

Wyroby medyczne – symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach – Część 1: Wymagania ogólne.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 15223-1	5.1.1	<b>Producent</b> Producent danego wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1	5.1.2	<b>Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej</b> Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej.
	ISO 15223-1	5.1.3	<b>Data produkcji</b> Data produkcji danego wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1	5.1.4	<b>Użyć do (data ważności)</b> Data, po której dany wyrób medyczny nie może być używany.








Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 15223-1	5.1.5	<b>Kod partii</b> Kod partii producenta, do identyfikacji partii lub serii.
	ISO 15223-1	5.1.6	<b>Numer katalogowy / Numer referencyjny</b> Numer katalogowy producenta, do identyfikacji wyrobów medycznych.
	ISO 15223-1	5.1.7	<b>Numer seryjny</b> Numer seryjny producenta, do identyfikacji wyrobów medycznych.
	ISO 15223-1	5.3.1	<b>Delikatny produkt, obchodzić się ostrożnie</b> Wyrób medyczny, który może zostać uszkodzony lub zniszczony, jeśli nie zachowano ostrożności przy obchodzeniu się z nim.
	ISO 15223-1	5.3.4	<b>Chronić przed deszczem</b> Opakowanie transportowe, które trzeba chronić przed deszczem i przechowywać w suchych warunkach.
	ISO 15223-1	5.3.7	<b>Ograniczenie temperatury</b> Limity temperatury, na które można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1	5.4.2	<b>Nie używać ponownie</b> Wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użytku lub do użycia u jednego pacjenta podczas jednego zabiegu.
	ISO 15223-1	5.4.3	<b>Zapoznać się z instrukcją użycia</b> Wezwanie użytkownika do zapoznania się z daną instrukcją użycia.
	ISO 15223-1	5.4.4	<b>Przeostroga</b> Wezwanie użytkownika do zapoznania się z instrukcją użycia, gdzie podano ważne informacje ostrzegawcze, takie jak ostrzeżenia i środki ostrożności, które z różnych powodów nie mogą być umieszczone na samym wyrobie medycznym.
	ISO 15223-1	5.5.1	<b>Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro</b> Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania jako urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 15223-1	5.1.8	<b>Importer</b> Oznacza podmiot importujący dany wyrób medyczny do Unii Europejskiej.








## ISO 7000




Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie — symbole zarejestrowane.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 7000	1135	<b>Recykling</b> Oznaczony przedmiot lub jego materiał podlega procesowi odzysku lub recyklingu.
	ISO 7000	1640	<b>Instrukcja techniczna; instrukcja serwisowa</b> Wskazuje miejsce przechowywania podręcznika lub informacje dotyczące instrukcji serwisowania danego sprzętu. Wskazuje, że przy serwisowaniu danego wyrobu w pobliżu miejsca umieszczenia tego symbolu należy wziąć pod uwagę instrukcję serwisową lub podręcznik serwisowy.
	ISO 7000	2594	<b>Wentylacja otwarta</b> Oznacza układ sterowania, który wpuszcza powietrze z zewnątrz do wnętrza.
	ISO 7000	3650	<b>USB</b> Oznacza port lub wtyczkę spełniającą ogólne wymagania technologii uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Oznacza, że dany wyrób jest przyłączony do portu USB lub jest kompatybilny z portem USB.
	ISO 7000	5016	<b>Bezpiecznik</b> Oznacza skrzynki bezpieczników lub ich lokalizację.



4.0.0.1 IEC 60417




Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	IEC 60417	5007	<b>Wł</b> Oznacza przyłączenie do sieci zasilającej, co najmniej w przypadku przełączników sieciowych lub ich połączeń oraz we wszystkich przypadkach, w których chodzi o bezpieczeństwo.
	IEC 60417	5008	<b>Wył</b> Oznacza odłączenie od sieci zasilającej, co najmniej w przypadku przełączników sieciowych lub ich połączeń oraz we wszystkich przypadkach, w których chodzi o bezpieczeństwo.
	IEC 60417	5009	<b>Tryb gotowości</b> Oznacza przełącznik lub położenie przełącznika, za pomocą którego włącza się część danego wyrobu, aby doprowadzić je do stanu gotowości.
	IEC 60417	5019	<b>Uziemienie ochronne</b> Zacisk przeznaczony do przyłączenia do zewnętrznego przewodu w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zacisk uziomu ochronnego (masy).
	IEC 60417	5032	<b>Jednofazowy prąd przemienny</b> Na tabliczce znamionowej oznacza, że dany wyrób można zasilać wyłącznie prądem przemiennym; oznacza odpowiednie zaciski.
	IEC 60417	5134	<b>Wyroby wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne</b> Opakowania zawierające wyroby wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne lub wyrób albo złącze, które nie zostało przetestowane pod kątem odporności na wyładowania elektrostatyczne.
	IEC 60417	5988	<b>Sieć komputerowa</b> Oznacza samą sieć komputerową lub wskazuje zaciski przyłączeniowe danej sieci komputerowej.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	IEC 60417	6040	<b>Ostrzeżenie: Promieniowanie ultrafioletowe</b> Ostrzeżenie o obecności światła UV w obudowie danego produktu, które może być wystarczająco silne, aby stanowiło ryzyko dla operatora. Przed otwarciem wyłączyć lampę UV. Podczas serwisowania należy stosować ochronę oczu i skóry przed promieniowaniem UV.
	IEC 60417	6057	<b>Przestroga: części ruchome</b> Instrukcja, aby trzymać się z dala od ruchomych części.
	IEC 60417	6222	<b>Informacje: ogólne</b> Oznacza układ sterowania w celu sprawdzenia stanu sprzętu, np. kopiarek wielofunkcyjnych.

### Inne symbole i oznaczenia

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	21 CFR 801.15(c)(1) (i)F		<b>Tylko na receptę</b> zamiennik „Uwaga: według prawa federalnego wyrób może być sprzedawany wyłącznie przez licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie.
	Deklaracja zgodności przyrządu zawiera wykaz dyrektyw, z którymi zgodny jest dany system		<b>Zgodność europejska</b> Znak zgodności CE oznacza, że dany system jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE. Deklaracja zgodności przyrządu zawiera wykaz dyrektyw, z którymi zgodny jest dany system.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	Dyrektywa 2012/19/WE UE: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)		<p><b>Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego</b></p> <p>Tego produktu elektronicznego nie należy wyrzucać jako niesortowany odpad, ale należy go wysłać do specjalnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.</p> <p>Etykieta ta oznacza, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyrób został wprowadzony na rynek europejski po 13 sierpnia 2005 r.</li> <li>• W żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej wyrobu nie wolno pozbywać się za pośrednictwem komunalnego systemu zbiórki odpadów.</li> </ul> <p>Klienci muszą rozumieć i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących prawidłowego odkażania i bezpiecznej utylizacji sprzętu elektrycznego.</p>
	AS/NZS 4417.1		<p><b>Oznaczenie zgodności z przepisami (RCM)</b></p> <p>Oznacza zgodność z wymogami Australijskiego Urzędu ds. Mediów Komunikacyjnych (ACMA) (bezpieczeństwo i EMC) dla Australii i Nowej Zelandii.</p>
	Chińskiej Republiki Ludowej Standard przemysłu elektronicznego SJ/T11364		<p><b>Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS 2)</b></p> <p>Oznacza, że ten elektroniczny produkt informacyjny zawiera pewne elementy toksyczne lub niebezpieczne i może być bezpiecznie używany w okresie, kiedy zapewnia ochronę środowiska. Liczba w środku logotypu wskazuje okres użytkowania danego produktu przy zapewnieniu ochrony środowiska (w latach). Zewnętrzny okrąg wskazuje, że produkt można poddać recyklingowi. Logotyp ten oznacza również, że dany produkt powinien zostać poddany recyklingowi natychmiast po upływie okresu użytkowania przy zachowaniu ochrony środowiska. Data na tej etykiecie to data produkcji.</p>



Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	Chińskiej Republiki Ludowej Standard przemysłu elektronicznego SJ/T11364		<b>Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS 2)</b> Oznacza, że ten elektroniczny produkt informacyjny nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych lub że ich stężenia nie przekraczają limitów podanych w GB/T 26572. Jest to ekologiczny produkt, który można poddać recyklingowi.
	Titlul 47 Codul Statelor Unite ale Reglementărilor Federale Partea 15		<b>Federalna Komisja Łączności (FCC)</b> Produkt ten został zbadany i uznany za zgodny z ograniczeniami wynikającymi z części 15 Zasad FCC.
	N/A		<b>Znak certyfikacji Underwriters Laboratories (UL)</b> Underwriters Laboratories poświadczyło, że wymienione produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w USA i Kanadzie.
	CSA Międzynarodowy		<b>Wyrób uznany przez agencję badawczą Grupy CSA</b> Grupa CSA poświadczyła, że wymienione produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w USA i Kanadzie.
	N/A		<b>Wyrób uznany przez agencję badawczą Intertek</b> Intertek Testing Agency poświadczyła, że wymienione produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w USA i Kanadzie.
	N/A		<b>Nieprzyłączony port</b> Produkt ten ma nieprzyłączony port na pompie strzykawkowej.



## Symbole bezpieczeństwa

Objaśnienie symboli bezpieczeństwa stosowanych w produktach Leica Biosystems.

### ISO 7010

Symbole graficzne — Kolory bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 7010	W001	<b>Ostrzeżenia ogólne</b> Wezwanie użytkownika do zapoznania się z instrukcją użycia, gdzie podano ważne informacje ostrzegawcze, takie jak ostrzeżenia i środki ostrożności, które z różnych powodów nie mogą być umieszczone na samym wyrobie medycznym.
	ISO 7010	W004	<b>Ostrzeżenie: wiązka lasera</b> Niebezpieczeństwo związane z laserem. Możliwość poważnego urazu oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze światłem lasera.
	ISO 7010	W009	<b>Ostrzeżenie: zagrożenie biologiczne</b> Zagrożenie biologiczne. Potencjalne narażenie na zagrożenie biologiczne. Aby uniknąć narażenia, należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonej dokumentacji.
	ISO 7010	W012	<b>Przestroga: ryzyko porażenia prądem elektrycznym</b> Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Potencjalne ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Aby uniknąć urazów lub uszkodzeń, należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonej dokumentacji.
	ISO 7010	W016	<b>Ostrzeżenie: materiał toksyczny</b> Zagrożenie dotyczące substancji toksycznych. Potencjalne poważne zagrożenie zdrowia, jeśli nie przestrzega się odpowiednich procedur obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Podczas pracy z odczynnikami należy stosować rękawiczki i okulary ochronne.
	ISO 7010	W017	<b>Ostrzeżenie: gorąca powierzchnia</b> Niebezpieczeństwo związane z wysoką temperaturą. Gorące powierzchnie powodują oparzenia, jeśli się ich dotknie. Unikać dotykania części oznaczonych tym symbolem.
	ISO 7010	W021	<b>Ostrzeżenie: materiał łatwopalny</b> Zagrożenie dotyczące substancji łatwopalnych. Przy zaniedbaniu odpowiednich środków ostrożności łatwopalne materiały mogą ulec zapłonowi.

Symbol	Norma / Rozporządzenie	Referencyjny	Opis
	ISO 7010	W023	<p><b>Ostrzeżenie: substancja korodująca</b></p> <p>Zagrożenie chemiczne związane z substancją korodującą. Poważne zagrożenie zdrowia, jeśli nie zachowuje się odpowiednich środków ostrożności. Zawsze nosić odzież ochronną i rękawice ochronne. Natychmiast usunąć rozlane płyny stosując standardową procedurę laboratoryjną.</p>
	ISO 7010	W024	<p><b>Ostrzeżenie: zgniecenie dłoni</b></p> <p>Niebezpieczeństwo zgniecenia. Dłonie lub części ciała mogą zostać zgniecione przy ruchu zamykającym części mechanicznych urządzenia.</p>

---

# Spis treści

<b>Informacje prawne</b> .....	<b>i</b>
<b>Informacje dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>iii</b>
<b>Informacje dotyczące przepisów</b> .....	<b>xi</b>
Słowniczek symboli .....	xii
Symbole regulacyjne .....	xii
Symbole bezpieczeństwa .....	xviii
<b>1. Wprowadzenie</b> .....	<b>9</b>
1.1 Przegląd systemu .....	9
1.2 Uzyskiwanie pomocy .....	10
1.3 Pierwsze kroki .....	11
1.4 Uruchamianie protokołu – przebieg pracy .....	12
1.4.1 BOND-III oraz BOND-MAX .....	12
<b>2. Urządzenie</b> .....	<b>15</b>
2.1 System BOND .....	16
2.1.1 Produkty pomocnicze BOND .....	17
2.2 Moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX .....	18
2.2.1 Główne komponenty .....	18
2.2.2 Inicjalizacja modułu przetwarzania .....	24
2.2.3 Pokrywa .....	24
2.2.4 Główny robot i czytnik ID .....	25
2.2.5 Zespoły barwienia szkiełek .....	26
2.2.6 Osłona przednia .....	28
2.2.7 Przedział na pojemniki zbiorcze .....	31
2.2.8 Sonda aspiracyjna .....	38
2.2.9 Blok myjący i stacja mieszania .....	39
2.2.10 Roboty odczynników zbiorczych (wyłącznie BOND-III) .....	40
2.2.11 Strzykawki .....	42
2.2.12 Wyłącznik zasilania .....	43
2.2.13 Osłona tylna .....	44
2.3 Kontroler i terminale BOND .....	46
2.4 Ręczny skaner kodów kreskowych .....	47
2.4.1 Korzystanie z ręcznego skanera kodów kreskowych .....	47
2.5 Drukarka etykiet do szkiełek .....	48
2.6 Wyposażenie pomocnicze .....	48
2.6.1 Szkiełka .....	48
2.6.2 BOND Universal Covertiles .....	49
2.6.3 Systemy odczynników i pojemniki na odczynniki .....	52
2.7 Przeniesienie urządzenia .....	53

2.8	Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urządzenia .....	53
<b>3.</b>	<b>Przegląd oprogramowania (Kontroler BOND ) .....</b>	<b>55</b>
3.1	Architektura systemu .....	56
3.1.1	Konfiguracja jednostanowiskowa .....	57
3.1.2	BOND-ADVANCE .....	58
3.2	Uruchamianie i wyłączanie oprogramowania BOND .....	59
3.3	Role użytkownika .....	61
3.4	Przegląd interfejsu klienta klinicznego .....	61
3.4.1	Pasek funkcji .....	61
3.4.2	Karty modułów przetwarzania .....	64
3.4.3	Sortowanie tabel .....	64
3.4.4	Format daty .....	64
3.5	BOND Dashboard .....	65
3.5.1	Stan zespołu barwienia szkiełek .....	66
3.6	Powiadomienia, ostrzeżenia i alarmy .....	67
3.7	Raporty .....	67
3.7.1	Starsze raporty .....	68
3.8	Pomoc .....	68
3.9	O systemie BOND .....	69
3.10	Definicje danych BOND .....	70
3.10.1	Aktualizacje definicji danych .....	70
3.11	Aktualizacje oprogramowania .....	70
<b>4.</b>	<b>Szybkie uruchamianie .....</b>	<b>71</b>
4.1	BOND-III oraz BOND-MAX .....	71
4.1.1	Kontrole wstępne i uruchomienie .....	71
4.1.2	Kontrole protokołu i odczynników .....	72
4.1.3	Konfigurowanie szkiełek .....	74
4.1.4	Ładowanie odczynników .....	79
4.1.5	Uruchamianie protokołu .....	82
4.1.6	Kończenie przebiegu .....	83
<b>5.</b>	<b>Ekran statusu (kontroler BOND ) .....</b>	<b>85</b>
5.1	Ekran stanu systemu .....	86
5.1.1	Karty modułów przetwarzania .....	87
5.1.2	Status urządzenia .....	89
5.1.3	Status odczynników .....	92
5.1.4	Informacje o szkiełkach .....	98
5.1.5	Identyfikacja szkiełek w urządzeniu .....	101
5.1.6	Wskaźnik postępu przebiegu .....	105
5.1.7	Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu .....	109
5.1.8	Opóźnione uruchomienie .....	110
5.2	Ekran statusu protokołu .....	111
5.3	Ekran konserwacji .....	112
5.3.1	Raport dot. konserwacji .....	113



<b>6. Konfiguracja szkiełek (kontroler BOND )</b>	<b>115</b>
6.1 Ekran konfiguracji szkiełek	116
6.2 Praca z próbkami kontrolnymi	117
6.2.1 Tkanka kontrolna	117
6.2.2 Odczynnik kontrolny	117
6.3 Praca z przypadkami	118
6.3.1 Elementy sterujące dla przypadku i informacje o aktywnym przypadku	118
6.3.2 Identyfikator przypadku	120
6.3.3 Dodawanie przypadku	120
6.3.4 Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku	121
6.3.5 Edytowanie przypadku	123
6.3.6 Kopiowanie przypadku	123
6.3.7 Opcja przypadku dziennego	124
6.3.8 Raport dla przypadku	124
6.4 Zarządzanie lekarzami	125
6.5 Praca ze szkiełkami	126
6.5.1 Opis pól i elementów sterujących dla szkiełek	127
6.5.2 Tworzenie szkiełek	128
6.5.3 Kopiowanie szkiełek	130
6.5.4 Edytowanie szkiełka	130
6.5.5 Usuwanie szkiełek	130
6.5.6 Ręczna identyfikacja szkiełka	130
6.5.7 Dodawanie panelu szkiełek	131
6.5.8 Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach	131
6.6 Etykietowanie szkiełek	134
6.6.1 Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkiełka	134
6.6.2 ID szkiełek i ID etykiet	136
6.7 Raport dot. podsumowania konfiguracji szkiełka	137
6.8 Ręczne tworzenie slajdów i przypadków	138
6.8.1 Tworzenie nowych przypadków i/lub szkiełek po zakończeniu obrazowania	138
6.8.2 Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu	141
6.9 Zgodność szkiełek	143
6.9.1 Zgodność protokołów	143
<b>7. Protokoły (kontroler BOND )</b>	<b>145</b>
7.1 Typy protokołów	146
7.1.1 Metody barwienia	146
7.1.2 Sekwencje protokołów	148
7.2 Ekran konfiguracji protokołów	150
7.2.1 Szczegóły protokołu	152
7.3 Tworzenie nowych protokołów	155
7.4 Edytowanie protokołów użytkownika	156
7.4.1 Edytowanie kroków protokołu	156
7.4.2 Dodawanie i usuwanie kroków protokołu	157

7.4.3	Reguły dla protokołów .....	160
7.4.4	Typy urządzeń i wersje protokołów .....	161
7.4.5	Usuwanie protokołów .....	162
7.5	Raporty dot. protokołów .....	163
7.6	Wstępnie zdefiniowane protokoły .....	164
7.6.1	Protokoły barwienia .....	164
7.6.2	Protokoły barwienia wstępnego .....	166
<b>8.</b>	<b>Zarządzanie odczynnikami (kontroler BOND ) .....</b>	<b>167</b>
8.1	Przegląd zarządzania odczynnikami .....	168
8.1.1	Informacje ogólne .....	169
8.1.2	Systemy teranostyczne .....	171
8.2	Ekran konfiguracji odczynników .....	172
8.2.1	Dodawanie lub edytowanie odczynnika .....	174
8.2.2	Usuwanie odczynnika .....	176
8.3	Ekran rejestru odczynników .....	177
8.3.1	Określanie objętości odczynnika .....	180
8.3.2	Szczegóły odczynnika lub systemu odczynników .....	181
8.3.3	Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników .....	184
8.3.4	Raport dot. szczegółów rejestru .....	187
8.3.5	Raport dot. użycia odczynnika .....	188
8.4	Ekran paneli odczynników .....	189
8.4.1	Tworzenie panelu .....	189
8.4.2	Wyświetlanie lub edytowanie szczegółów panelu .....	190
8.4.3	Usuwanie panelu .....	190
<b>9.</b>	<b>Historia szkiełek (kontroler BOND ) .....</b>	<b>191</b>
9.1	Ekran historii szkiełek .....	192
9.2	Wybór szkiełek .....	193
9.3	Właściwości szkiełka i ponowny przebieg .....	194
9.3.1	Ponowne przetwarzanie szkiełek .....	194
9.4	Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu .....	195
9.5	Raport dot. szczegółów przebiegu .....	196
9.6	Raport dla przypadku .....	197
9.7	Raport dot. protokołu .....	199
9.8	Podsumowanie szkiełek .....	200
9.9	Eksport danych .....	201
9.10	Krótką historia szkiełek .....	203
<b>10.</b>	<b>Klient administracyjny (w kontrolerze BOND ) .....</b>	<b>205</b>
10.1	Users (użytkownicy) .....	206
10.2	LIS .....	209
10.3	Labels (etykiety) .....	212
10.3.1	Tworzenie, edycja i aktywacja szablonów etykiet .....	216
10.3.2	Typy informacji .....	218

10.4	BDD .....	221
10.4.1	Aktualizacje BDD .....	222
10.4.2	Dziennik audytu .....	223
10.5	Settings (ustawienia) .....	224
10.5.1	Ustawienia laboratorium .....	224
10.5.2	Ustawienia przypadków i szkiełek .....	225
10.5.3	Kopie zapasowe bazy danych .....	226
10.6	Hardware (urządzenia) .....	228
10.6.1	Processing Modules (moduły przetwarzania) .....	228
10.6.2	Pods (grupy) .....	231
10.6.3	Slide Labelers (drukarki etykiet do szkiełek) .....	233
<b>11.</b>	<b>Pakiet integracji LIS (kontroler BOND ) .....</b>	<b>245</b>
11.1	Terminologia LIS .....	246
11.2	Dodatkowe funkcje oprogramowania .....	247
11.2.1	Ikona statusu LIS .....	247
11.2.2	Przypadki LIS .....	247
11.2.3	Szkiełka LIS .....	248
11.2.4	Nazwy publiczne markerów .....	248
11.2.5	Szkiełka priorytetowe .....	249
11.2.6	Pola danych szkiełek LIS .....	249
11.3	Podłączanie i inicjalizacja LIS .....	250
11.4	Powiadomienia LIS .....	251
11.5	Wymagania dotyczące danych przypadków i szkiełek .....	252
11.5.1	Dane przypadku .....	252
11.5.2	Dane szkiełka .....	253
11.6	Przesyłanie danych dotyczących szkiełek z powrotem do LIS .....	254
11.7	Etykiety szkiełek .....	254
11.8	Przebieg pracy .....	255
<b>12.</b>	<b>Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX) .....</b>	<b>257</b>
12.1	Harmonogram czyszczenia i konserwacji .....	259
12.1.1	Listy kontrolne czyszczenia i konserwacji .....	260
12.2	Pojemniki zbiorcze .....	263
12.2.1	Sprawdzanie poziomów w pojemnikach .....	263
12.2.2	Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych .....	264
12.2.3	Czyszczenie pojemników zbiorczych .....	268
12.2.4	Zewnętrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX) .....	269
12.3	Szkiełka nakrywkowe Covertile .....	271
12.3.1	Usuwanie pozostałości DAB (opcjonalne) .....	271
12.3.2	Standardowe czyszczenie (obowiązkowe) .....	271
12.4	Zespół barwienia szkiełek .....	272
12.4.1	Ręczne odblokowanie zespołów barwienia szkiełek .....	276
12.5	Ponowne uruchamianie modułu przetwarzania .....	278
12.6	Sonda aspiracyjna .....	280

12.6.1	Czyszczenie sondy aspiracyjnej .....	280
12.6.2	Wymiana sondy aspiracyjnej .....	281
12.7	Blok myjący i stacja mieszania .....	285
12.8	Oslony, drzwi i pokrywy .....	285
12.9	Czytnik ID .....	286
12.10	Tace ociekowe .....	287
12.10.1	Tace ociekowe do pojemników zbiorczych BOND-III .....	287
12.10.2	Taca ociekowa urządzenia BOND-III .....	289
12.10.3	Taca ociekowa do pojemników zbiorczych BOND-MAX .....	289
12.11	Tace na szkiełka .....	290
12.12	Sondy robota odczynników zbiorczych (tylko BOND-III) .....	290
12.12.1	Czyszczenie sond robota odczynników zbiorczych .....	290
12.12.2	Wymiana sond robota odczynników zbiorczych .....	292
12.13	Strzykawki .....	293
12.13.1	Wymiana BOND-III strzykawk .....	293
12.13.2	Wymiana strzykawki 9-portowej BOND-MAX .....	294
12.14	Bezpieczniki zasilania .....	296
<b>13.</b>	<b>Czyszczenie i konserwacja (różne urządzenia) .....</b>	<b>299</b>
13.1	Ręczne skanery kodów kreskowych .....	299
13.1.1	Skaner kodów kreskowych Symbol .....	299
13.1.2	Skaner kodów kreskowych Honeywell .....	302
13.1.3	Ręczny skaner kodów kreskowych Zebra DS2208 .....	305
13.2	Drukarka etykiet do szkiełek .....	308
<b>14.</b>	<b>Korzystanie z odczynników BOND .....</b>	<b>309</b>
14.1	Zasady stosowania procedury .....	309
14.1.1	Systemy detekcji BOND .....	310
14.1.2	Systemy teranostyczne .....	312
14.2	Przygotowanie próbek .....	312
14.2.1	Wymagane materiały .....	312
14.2.2	Przygotowanie tkanki .....	314
14.2.3	Odfarbinowanie i podgrzewanie .....	314
14.2.4	Odsłonięcie epitopu .....	315
14.3	Kontrola jakości .....	315
14.3.1	Weryfikacja oznaczenia .....	316
14.3.2	Tkanki kontrolne .....	316
14.3.3	Ujemne odczynniki kontrolne do IHC .....	317
14.3.4	Odczynniki kontrolne do ISH .....	318
14.3.5	Zalety kontroli jakości .....	319
14.4	Interpretacja barwienia .....	321
14.4.1	Tkanka do dodatniej próby kontrolnej .....	321
14.4.2	Tkanka do ujemnej próby kontrolnej .....	321
14.4.3	Tkanka pacjenta .....	321
14.5	Ogólne ograniczenia .....	322

---

14.6 Bibliografia .....	324
<b>15. Zarządzanie systemem (kontroler BOND ) .....</b>	<b>327</b>
15.1 BOND System Manager .....	327
15.1.1 Informacje ogólne .....	327
15.1.2 Okno BOND System Manager .....	328
15.1.3 Zatrzymywanie usług .....	329
15.1.4 Uruchamianie usług .....	329
15.2 Redundancja dysku twardego .....	330
<b>16. Działanie BOND-ADVANCE .....</b>	<b>331</b>
16.1 Ponowne uruchamianie systemu BOND-ADVANCE .....	331
16.2 Przełączanie na kontroler dodatkowy .....	332
<b>17. Wymiana drukarki etykiet do szkiełek .....</b>	<b>337</b>
17.1 Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie jedno stanowiskowym .....	337
17.2 Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie BOND-ADVANCE .....	338
17.3 Wymiana drukarki Zebra Printer na drukarkę Cognitive Cxi w systemie jedno stanowiskowym .....	341
<b>18. Specyfikacje .....</b>	<b>343</b>
18.1 System .....	343
18.2 Dane fizyczne .....	343
18.3 Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i UPS .....	344
18.4 Dane środowiskowe .....	344
18.5 Dane dotyczące pracy .....	345
18.6 Szkiełka mikroskopowe .....	346
18.7 Transport i przechowywanie .....	347
<b>Indeks .....</b>	<b>349</b>

---

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 1. Wprowadzenie

## 1.1 Przegląd systemu

Gratulujemy zakupu automatycznego systemu immunohistochemicznego (IHC) BOND i hybrydyzacji in situ (ISH). Jesteśmy pewni, że zapewni wysoką jakość barwienia, wydajność i łatwość użycia potrzebne w laboratorium. Docelowymi użytkownikami systemu BOND jest odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny.

System BOND może zawierać wiele modułów przetwarzania, koordynowanych przez kontroler BOND. Istnieją dwa typy modułu przetwarzania (PM) – BOND-III oraz BOND-MAX – każdy o pojemności 30 szkiełek. W razie potrzeby trzy przebiegi po dziesięć szkiełek mogą być przetwarzane jednocześnie przy użyciu różnych protokołów barwienia, przy czym każdy przebieg rozpoczyna się oddzielnie w celu zapewnienia ciągłego przetwarzania. Przynajmniej jeden przebieg można skonfigurować do podwójnego barwienia, podczas gdy inny może przetwarzać szkiełka przy użyciu systemu teranostycznego Leica specjalnie zaprojektowanego dla BOND.

Oprogramowanie BOND ułatwia konfigurowanie i barwienie szkiełek. Należy stosować rygorystycznie sprawdzone protokoły dostarczone wraz z systemem lub utworzyć własne. Wybrać spośród szerokiej gamy gotowych do użycia odczynników BOND lub innych przeciwciał lub sond, łącząc je z serią wysokiej jakości systemów wykrywania BOND. Po utworzeniu wirtualnych szkiełek w oprogramowaniu lub zaimportowaniu ich z systemu Laboratory Information System (LIS) – należy wydrukować etykiety (lub użyć etykiet drukowanych przez LIS), nakleić je na szkiełka, a następnie załadować szkiełka do modułu przetwarzania. System BOND wykonuje resztę, konsekwentnie i niezawodnie dostarczając barwienie wysokiej jakości.



Protokoły i odczynniki dostarczone przez Leica Biosystems są wyświetlane w oprogramowaniu jako dostarczone przez Leica Microsystems.

Cechy systemu BOND to:

- Wysoka wydajność
- Elastyczność
- Bezpieczeństwo
- Automatyczne barwienie immunohistochemiczne i kontrastowe
- Automatyczne barwienie ISH i kontrastowe
- Automatyczne odparafinowanie, podgrzewanie i odzyskiwanie
- Automatyczne barwienie podwójne
- Integracja z systemami teranostycznymi Leica

Wierzymy, że system BOND będzie wartościowym dodatkiem do laboratorium.

Zob. części:

- [1.2 - Uzyskiwanie pomocy](#)
- [1.3 - Pierwsze kroki](#)
- [1.4 - Uruchamianie protokołu – przebieg pracy](#)

## 1.2 Uzyskiwanie pomocy

Instrukcja obsługi BOND (niniejsza instrukcja) jest zapisana w formacie PDF na wszystkich kontrolerach (wersja jedno stanowiskowa) i terminalach (BOND-ADVANCE). Znajduje się ona również na płycie CD dostarczonej z systemem.

Niniejszą instrukcję można wyświetlić, klikając **Help** (pomoc) na pasku funkcji w obu wersjach klienta oprogramowania BOND.



W przypadku problemów z systemem BOND należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Leica Biosystems lub odwiedzić stronę [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



## 1.3 Pierwsze kroki

Ten rozdział opisuje nowym użytkownikom systemu BOND, gdzie w instrukcji obsługi znaleźć informacje potrzebne do uzyskania pełnej wiedzy na temat produktu.

<b>Krok</b>	<b>Opis</b>	<b>Część instrukcji</b>
1	<p><b>Montaż i oddanie do eksploatacji</b></p> <p>Konfiguracja sprzętu, instalacja oprogramowania, sprawdzenie systemu.</p> <p>Wykonywane przez przedstawicieli Leica Biosystems lub autoryzowanego dystrybutora.</p>	–
2	<p><b>Zapoznanie się z częścią Bezpieczeństwo</b></p> <p>Zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa dla systemu BOND.</p>	<a href="#">Informacje dotyczące bezpieczeństwa</a>
3	<p><b>Zapoznanie się z urządzeniem</b></p> <p>Zapoznanie się z nazwami i zastosowaniami urządzenia BOND.</p>	<a href="#">2 - Urządzenie</a>
4	<p><b>Zapoznanie się z oprogramowaniem</b></p> <p>Ogólne zrozumienie oprogramowania i sposobu użytkowania.</p>	<a href="#">3 - Przegląd oprogramowania (Kontroler BOND )</a>
5	<p><b>Sprawdzenie protokołów i odczynników</b></p> <p>Odczynniki i protokoły mogły zostać skonfigurowane podczas montażu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzić, czy protokoły, które mają być uruchamiane, zostały skonfigurowane.</li> <li>• Sprawdzić, czy odczynniki wymagane w laboratorium zostały skonfigurowane.</li> </ul>	<p><a href="#">7 - Protokoły (kontroler BOND )</a></p> <p><a href="#">8 - Zarządzanie odczynnikami (kontroler BOND )</a></p>
6	<p><b>Uruchamianie protokołu</b></p> <p>Krótki przegląd.</p> <p>Bardziej szczegółowy przegląd.</p>	<p><a href="#">1.4 - Uruchamianie protokołu – przebieg pracy</a></p> <p><a href="#">4 - Szybkie uruchamianie</a></p>
7	<p><b>Zaawansowane</b></p> <p>W razie potrzeby można uzyskać dokładniejsze informacje na temat oprogramowania.</p>	<p><a href="#">5 - Ekrany statusu (kontroler BOND ) do</a></p> <p><a href="#">9 - Historia szkiełek (kontroler BOND )</a></p>

Krok	Opis	Część instrukcji
8	<b>Praca z systemem LIS</b> Opcjonalny pakiet umożliwiający podłączenie do systemu informatycznego laboratorium.	<a href="#">11 - Pakiet integracji LIS (kontroler BOND )</a>
9	<b>Dbanie o system BOND</b>	<a href="#">12 - Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)</a>

## 1.4 Uruchamianie protokołu – przebieg pracy

### 1.4.1 BOND-III oraz BOND-MAX



Aby uniknąć zanieczyszczenia odczynników i szkiełek, urządzenie powinno być użytkowane w czystym środowisku, w miarę możliwości wolnym od kurzu i cząstek stałych.

Poniżej przedstawiono przegląd standardowych kroków związanych z barwieniem tacy na szkiełka. Przy różnych ustawieniach możliwe są inne przebiegi pracy.

#### 1.4.1.1 Kontrole wstępne i uruchomienie

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest czysty i że wszystkie zadania konserwacyjne zostały wykonane ([12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwacji](#)). Codzienne zadania przed uruchomieniem to:
  - i. Sprawdzić, czy zbiorcze pojemniki na odpady są napełnione maksymalnie w połowie.
  - ii. Sprawdzić, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki są przynajmniej w połowie pełne oraz czy zawierają odpowiedni odczynnik.
2. Sprawdzić bloki myjące i stację mieszania – w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić.
3. Sprawdzić, czy drukarka etykiet do szkiełek ma etykiety i taśmę do druku oraz czy jest włączona.
4. Włączyć kontroler modułu przetwarzania, (i terminal dla BOND-ADVANCE) i otworzyć klienta klinicznego BOND.

#### 1.4.1.2 Konfiguracja odczynników

5. W razie potrzeby utworzyć odczynniki w systemie ([8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)).
6. Zarejestrować pojemniki na odczynniki ([8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#)).


#### 1.4.1.3 Konfiguracja protokołów

7. W razie potrzeby utworzyć nowe protokoły ([7.3 - Tworzenie nowych protokołów](#)).

#### 1.4.1.4 Konfiguracja szkiełek

8. Utworzyć przypadki w oprogramowaniu ([6.3.3 - Dodawanie przypadku](#)).
9. Utworzyć szkiełka w oprogramowaniu ([6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)).
10. Wydrukować etykiety szkiełek i umieścić je na szkiełkach ([6.6.1 - Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkiełka](#)).
11. Umieścić szkiełka i szkiełka nakrywkowe Covertile na tacach na szkiełka ([4.1.3.5 - Ładowanie szkiełek](#)).

#### 1.4.1.5 Załadować moduł przetwarzania i uruchomić przebieg

12. Włożyć tace na szkiełka do modułu przetwarzania ([4.1.3.5 - Ładowanie szkiełek](#)).
13. Załadować system wykrywania i tace na odczynniki do modułu przetwarzania ([4.1.4 - Ładowanie odczynników](#)).
14. Nacisnąć przyciski Load/Unload (załaduj/wyładuj) na module przetwarzania, aby zablokować tace na szkiełka.
15. W menu **System status** (stan sytemu) sprawdzić, czy wszystkie szkiełka zostały zidentyfikowane – ręcznie zidentyfikować szkiełka, które nie zostały zidentyfikowane automatycznie ([5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#)).
16. Wyświetlić i usunąć ostrzeżenia na ekranie **System status** (stan systemu).
17. Kliknąć , aby uruchomić przebieg.

#### 1.4.1.6 Monitorowanie przebiegu

18. Przebieg można monitorować na ekranie **System status** (stan systemu) ([5.1 - Ekran stanu systemu](#)) lub na pulpicie BOND Dashboard ([3.5 - BOND Dashboard](#)). Wyświetlić i usunąć wszystkie powiadomienia.

#### 1.4.1.7 Wyładować szkiełka i odczynniki

19. Po zakończeniu przebiegu należy usunąć system wykrywania i tace na odczynniki oraz schować odczynniki ([4.1.6 - Kończenie przebiegu](#)).



Gdy moduł przetwarzania nie jest używany, należy wyjąć pojemniki zbiorcze ER1 i ER2 i przechowywać je w temperaturze od +2 do +8°C (od +36 do +46°F). Zob. również [2.2.7 - Przedział na pojemniki zbiorcze](#).

20. Nacisnąć przyciski Load/Unload (załaduj/wyładuj) na module przetwarzania, aby odblokować tace na szkiełka i wyjąć tace.
21. Wyjąć szkiełka nakrywkowe Covertile i wyczyścić je ([12.3 - Szkiełka nakrywkowe Covertile](#)).
22. Wyjąć szkiełka.
23. Należy usunąć wszelkie wycieki lub zabrudzenia z zespołów barwienia szkiełek ([12.4 - Zespół barwienia szkiełek](#)), innych części modułu przetwarzania lub tac na szkiełka lub odczynniki.

Strona celowo pozostawiona pusta.

## 2. Urządzenie

Ta część zawiera następujące informacje:

- Nazwy elementów urządzenia systemu BOND
- Funkcje tych elementów oraz sposób, w jaki odnoszą się one do systemu jako całości
- Gdzie znaleźć dodatkowe informacje, na przykład procedury obsługi i konserwacji związane z urządzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i podłączania elementów nie są zawarte w opisach urządzenia, ponieważ system powinien być fabrycznie skonfigurowany i sprawdzony. Jeśli trzeba wymienić lub ponownie podłączyć element, szczegółowe informacje znajdują się w części [12 - Czyszczenie i konserwacja \(BOND-III i BOND-MAX\)](#).

Jeśli to konieczne, informacje o modułach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX są podzielone na oddzielne części, aby ułatwić znajdowanie potrzebnych informacji.

Zob. części:

- [2.1 - System BOND](#)
- [2.2 - Moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX](#)
- [2.3 - Kontroler i terminale BOND](#)
- [2.4 - Ręczny skaner kodów kreskowych](#)
- [2.5 - Drukarka etykiet do szkiełek](#)
- [2.6 - Wyposażenie pomocnicze](#)
- [2.7 - Przeniesienie urządzenia](#)
- [2.8 - Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urządzenia](#)

## 2.1 System BOND

System BOND składa się z następujących głównych elementów:

- Co najmniej jeden moduł przetwarzania (zob. [2.2 - Moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX](#))
- Kontroler BOND lub BOND-ADVANCE (zob. [2.3 - Kontroler i terminale BOND](#))  
Instalacje BOND-ADVANCE wyposażone są w terminale oraz kontroler; mogą też być wyposażone w dodatkowy kontroler (zapasowy)
- Co najmniej jeden ręczny skaner kodów kreskowych (zob. [2.4 - Ręczny skaner kodów kreskowych](#))
- Co najmniej jedna drukarka etykiet do szkiełek (zob. [2.5 - Drukarka etykiet do szkiełek](#))

Każdy nowy moduł przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX posiada:

- 4 tace na szkiełka (zob. [2.6.2.1 - Tace na szkiełka](#))
- 4 tace na odczynniki (zob. [2.6.2.2 - Tace na odczynniki](#))
- 1 stację mieszania (zob. [2.2.9 - Blok myjący i stacja mieszania](#))
- 1 (BOND-MAX) lub 2 (BOND-III) klucze sześciokątne do wymiany pompy strzykawki
- 1 kabel Ethernet

Konieczne będzie również:

- Szkiełka nakrywkowe Covertile (zob. [2.6.2 - BOND Universal Covertiles](#))
- Systemy wykrywania BOND oraz odczynniki gotowe do użycia BOND lub koncentraty i/lub otwarte pojemniki na odczynniki (zob. [2.6.3 - Systemy odczynników i pojemniki na odczynniki](#))

Kompletna i aktualna lista materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych znajduje się na stronie [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

Zob. również [3.1 - Architektura systemu](#).

## 2.1.1 Produkty pomocnicze BOND

Produkty pomocnicze BOND zaprojektowano specjalnie dla systemu BOND, a ich stosowanie pomaga zapewnić optymalne efekty barwienia. Korzystanie z produktów pomocniczych BOND pozwala również utrzymać urządzenie w dobrym stanie i zapobiega jego uszkodzeniu.



Następujące produkty powinny *zawsze* być używane z systemem BOND oraz *nigdy* nie powinny być zastępowane innymi produktami:

### Odczynniki pomocnicze

- BOND Wash Solution
- BOND Epitope Retrieval Solution (1 & 2)
- BOND Dewax Solution

### Materiały eksploatacyjne

- Szkiełka BOND Plus (lub szkiełka mikroskopowe zgodne ze specyfikacjami podanymi w części [2.6.1 - Szkiełka](#))
- BOND Universal Covertiles
- Otwarte pojemniki BOND (7 ml i 30 ml)
- Pojemniki i wkłady do miareczkowania BOND (6 ml)
- Fiolka do mieszania BOND
- BOND Slide Label and Print Ribbon Kit

## 2.2 Moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX

Moduł przetwarzania (PM) to platforma barwienia systemu BOND. Jeden system BOND może mieć dowolną kombinację modułów typu BOND-III oraz BOND-MAX.



Moduł roboczy musi być podłączony do uziemionego gniazda zasilania sieciowego i ustawiony tak, aby personel mógł łatwo odłączyć przewód zasilania bez konieczności przemieszczania urządzenia.

---

- [2.2.1 - Główne komponenty](#)
- [2.2.2 - Inicjalizacja modułu przetwarzania](#)
- [2.2.3 - Pokrywa](#)
- [2.2.4 - Główny robot i czytnik ID](#)
- [2.2.5 - Zespoły barwienia szkiełek](#)
- [2.2.6 - Osłona przednia](#)
- [2.2.7 - Przedział na pojemniki zbiorcze](#)
- [2.2.8 - Sonda aspiracyjna](#)
- [2.2.9 - Blok myjący i stacja mieszania](#)
- [2.2.10 - Roboty odczynników zbiorczych \(wyłącznie BOND-III\)](#)
- [2.2.11 - Strzykawki](#)
- [2.2.12 - Wyłącznik zasilania](#)
- [2.2.13 - Osłona tylna](#)

### 2.2.1 Główne komponenty

Główne komponenty BOND-III oraz BOND-MAX:


- [2.2.1.1 - BOND-III](#)
- [2.2.1.2 - BOND-MAX](#)



2.2.1.1 BOND-III

Poniższe zdjęcia przedstawiają elementy głównego modułu przetwarzania dla BOND-III.

Opis tylnej osłony znajduje się w części [2.2.13 - Osłona tylna](#).

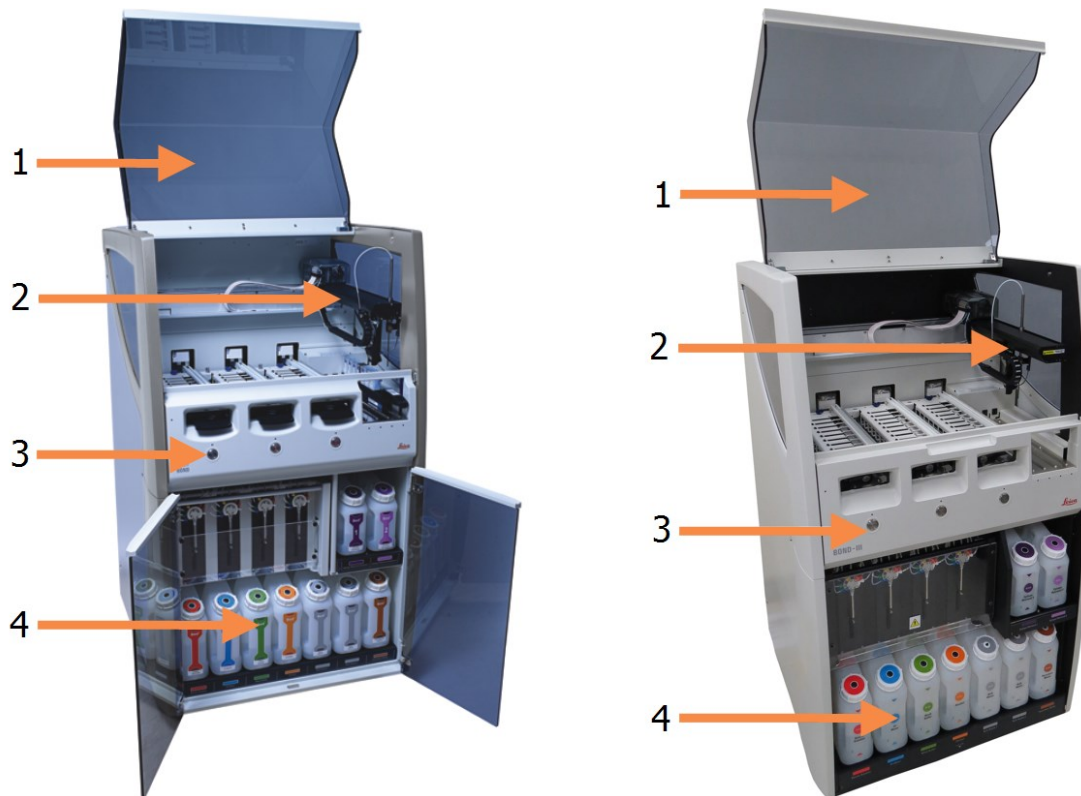


Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 2-1</a> )
1	<b>Pokrywa</b> <a href="#">2.2.3 - Pokrywa</a>
2	<b>Ramię robota głównego</b> <a href="#">2.2.4 - Główny robot i czytnik ID</a>
3	<b>Osłona przednia</b> <a href="#">2.2.6 - Osłona przednia</a>
4	<b>Przedział na pojemniki zbiorcze</b> <a href="#">2.2.7 - Przedział na pojemniki zbiorcze</a>

Postać 2-1: Widok od przodu poprzedniego (po lewej) i aktualnego (prawa) modułu przetwarzania BOND-III



Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 2-2</a> )
5	<b>Robot odczynników zbiorczych</b> <a href="#">2.2.10 - Roboty odczynników zbiorczych (wyłącznie BOND-III)</a>
6	<b>Zespoły barwienia szkiełek</b> <a href="#">2.2.5 - Zespoły barwienia szkiełek</a>
7	<b>Strzykawki</b> <a href="#">2.2.11 - Strzykawki</a>
8	<b>Platforma odczynników</b> <a href="#">2.2.6.5 - Platforma odczynników</a>

Postać 2-2: Prząd modułu przetwarzania BOND-III

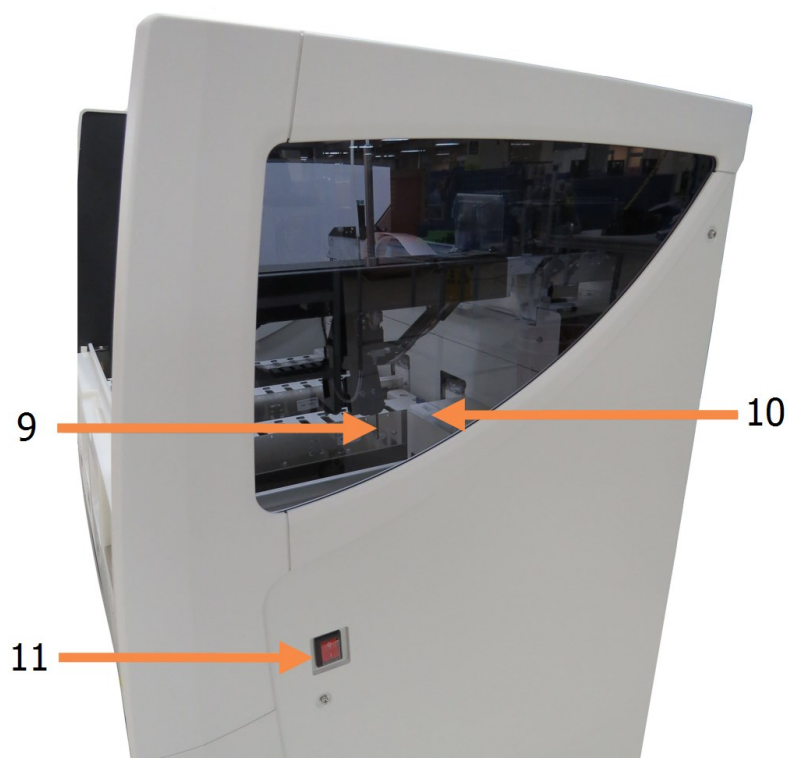

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 2-3</a> )
9	<b>Sonda aspiracyjna</b> <a href="#">2.2.8 - Sonda aspiracyjna</a>
10	<b>Blok myjący i stacja mieszania</b> <a href="#">2.2.9 - Blok myjący i stacja mieszania</a>
11	<b>Wyłącznik zasilania</b> <a href="#">2.2.12 - Wyłącznik zasilania</a>

Postać 2-3: Moduł przetwarzania BOND-III widziany od prawej strony


2.2.1.2 BOND-MAX

Poniższe zdjęcia przedstawiają główne elementy modułu przetwarzania BOND-MAX. Przedstawiony jest obecny model – poprzednie modele różnią się wyglądem, jednak główne elementy są takie same.



Nr	Nazwa ( <u>Postać 2-4</u> )	Rozdział
1	Pokrywa	<a href="#">2.2.3</a>
2	Ramię robota	<a href="#">2.2.4</a>
3	Zespoły barwienia szkiełek	<a href="#">2.2.5</a>
4	Ośłona przednia	<a href="#">2.2.6</a>
5	Przedział na pojemniki zbiorcze	<a href="#">2.2.7</a>

Postać 2-4: Przód modułu przetwarzania BOND-MAX

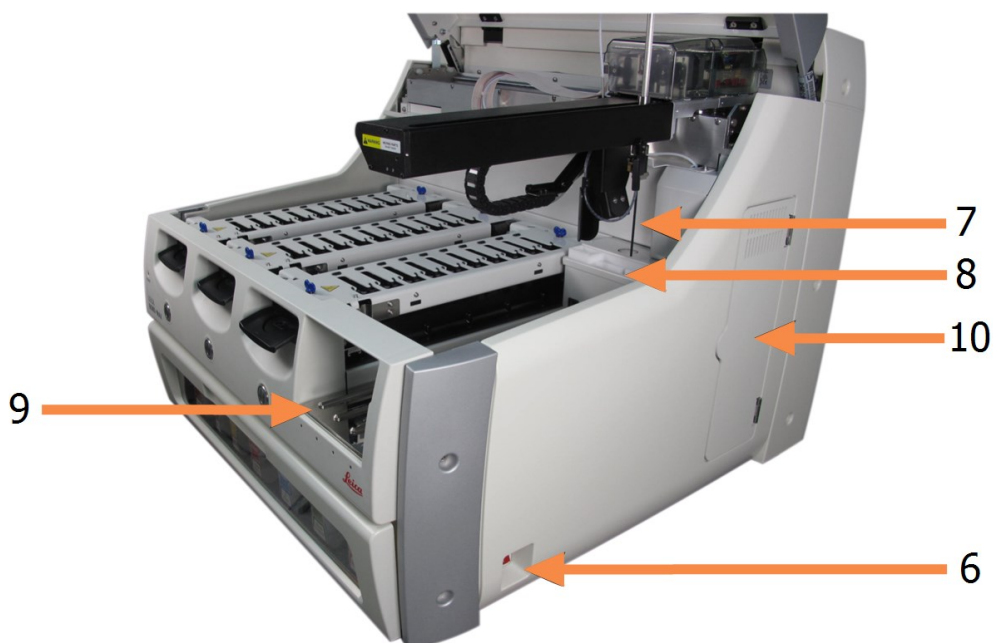

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 2-5</a> )	Rozdział
6	Wyłącznik zasilania	<a href="#">2.2.12</a>
7	Sonda aspiracyjna	<a href="#">2.2.8</a>
8	Blok myjący i stacja mieszania	<a href="#">2.2.9</a>
9	Platforma odczynników	<a href="#">2.2.6</a>
10	Strzykawka (zob. poniżej)	<a href="#">2.2.11</a>

Postać 2-5: Moduł przetwarzania BOND-MAX widziany od prawej strony

Opis tylnej osłony znajduje się w części [2.2.13 - Osłona tylna](#).



Postać 2-6: Strzykawka za drzwiami z zawiasami

## 2.2.2 Inicjalizacja modułu przetwarzania

Po włączeniu modułu przetwarzania system BOND przeprowadza kontrole wewnętrzne, zalewa układ płynów i przesuwa roboty do pozycji wyjściowych. Główny robot przesuwa się do lewego tylnego rogu urządzenia, a trzy roboty odczynników zbiorczych (tylko BOND-III) przesuwa się do tyłu urządzenia.

Zespoły barwienia szkiełek są inicjowane i wracają do pozycji odblokowanej. Proces inicjalizacji zatrzymuje się w przypadku wykrycia błędu lub jeśli moduł znajduje się w stanie nieodpowiednim do przetwarzania.




Przed próbą inicjalizacji modułu przetwarzania należy sprawdzić następujące elementy:

- Pokrywa jest zamknięta
- Zbiorcze pojemniki na odpady są napełnione mniej niż w połowie
- Zbiorcze pojemniki na odczynniki są napełnione przynajmniej w połowie
- Stacja mieszania jest we właściwym miejscu
- Fiolki stacji mieszania są puste i czyste
- Górne płytki zespołów barwienia szkiełek (SSA) znajdują się w położeniu zamkniętym.

Dioda LED zasilania z przodu modułu przetwarzania zmienia kolor na zielony a oprogramowanie BOND wskazuje, że moduł jest podłączony. Po zakończeniu inicjalizacji na karcie modułu przetwarzania pojawiają się ikony trzech tac na szkiełka (zob. [5.1.1 - Karty modułów przetwarzania](#)). Nie próbować używać modułu przetwarzania przed zakończeniem inicjalizacji.

## 2.2.3 Pokrywa

Pokrywa powinna być zamknięta podczas pracy i jest zabezpieczona blokadami.

	Należy zachować ostrożność podczas zamykania pokrywy urządzenia, aby uniknąć urazu dłoni.
	Podczas pracy główny robot, sonda aspiracyjna i roboty odczynników zbiorczych (BOND-III) mogą poruszać się bez ostrzeżenia i z prędkością, która może spowodować obrażenia. Nie próbować otwierać pokrywy urządzenia w trakcie przebiegu. Nie należy podejmować prób obejścia blokady zatrzymującej urządzenie po otwarciu pokrywy.
	Jeżeli robot główny i/lub roboty odczynników zbiorczych nadal działają przez ponad 5 sekund po otwarciu pokrywy modułu przetwarzania, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.



## 2.2.4 Główny robot i czytnik ID

Główny robot ustawia sondę aspiracyjną w celu pobierania i dozowania odczynników. Ramię robota posiada czytnik ID, który służy do identyfikacji szkiełek i odczynników załadowanych w module przetwarzania.



Postać 2-7: Zdjęcie robota głównego z czytnikiem ID wskazanym strzałką



Nie przesuwaj ramienia głównego robota, gdy moduł przetwarzania jest włączony. Może dojść do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidłowego barwienia.

Jeśli ustawienie robota uległo zmianie: wyłączyć urządzenie, odczekać 30 sekund, a następnie ponownie je uruchomić.

W przypadku szkiełek system BOND skanuje każdą etykietę szkiełka w celu identyfikacji (zob. [5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkiełek](#)).

- Okno czytnika ID należy okresowo czyścić.  
Zob. [12.9 - Czytnik ID](#) w celu uzyskania dodatkowych informacji.
- Jeśli sonda aspiracyjna jest uszkodzona lub zgięta, należy ją wymienić zgodnie z procedurą [12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej](#).

## 2.2.5 Zespoły barwienia szkiełek




Unikać kontaktu z zespołami barwienia szkiełek i podzespołami znajdującymi się w ich pobliżu. Mogą one być bardzo gorące i powodować poważne oparzenia. Po wyłączeniu odczekać dwadzieścia minut, aż zespoły barwienia szkiełek i ich otoczenie ostygną.



Potencjalnie niebezpieczne odczynniki mogą gromadzić się wokół zespołów barwienia szkiełek i zanieczyszczać tacę na szkiełka. Podczas pracy z tacami na szkiełka należy zawsze nosić zatwierdzoną odzież ochronną i rękawice ochronne.

Szkiełka są przetwarzane w zespołach do barwienia szkiełek. Każdy moduł przetwarzania zawiera trzy zespoły do barwienia szkiełek.

Aby rozpocząć przebieg, operator wprowadza tacę na szkiełka przez osłonę przednią (opisaną w [2.2.6 - Osłona przednia](#)), następnie naciska przycisk ładowania. System BOND przechwytytuje obrazy szkiełek. Jeśli szkiełka są zgodne (zob. [6.9 - Zgodność szkiełek](#)) i wszystkie odczynniki są obecne, użytkownik może rozpocząć przebieg. Więcej informacji na temat wprowadzania szczegółów szkiełek i załadunku można znaleźć w części [6 - Konfiguracja szkiełek \(kontroler BOND\)](#).

Podczas przetwarzania system BOND blokuje szkiełka w zespole barwienia szkiełek. Nie próbować wyjmować tacy na szkiełka, gdy system BOND przetwarza szkiełka – najpierw anulować przebieg, klikając  pod tacą na ekranie **stanu systemu** (zob. [5.1.7 - Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu](#)), a następnie odblokować zespół barwienia szkiełek.

Czyszczenie i rutynowa konserwacja zespołu barwienia szkiełek zostały opisane w części [12.4 - Zespół barwienia szkiełek](#).

### 2.2.5.1 Podgrzewacze zespołu barwienia szkiełek



Podgrzewacze i podgrzewane powierzchnie modułu przetwarzania mogą powodować ryzyko zapłonu:

- Nie umieszczać łatwopalnych materiałów na podgrzewaczach ani w ich pobliżu.
- Nie umieszczać materiałów łatwopalnych na jakichkolwiek gorących powierzchniach modułu przetwarzania.
- Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.



Niektóre z odczynników używanych w modułach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX są łatwopalne:

- Nie umieszczać płomienia ani źródła zapłonu w pobliżu modułów przetwarzania.
- Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.



Urządzenia BOND-III oraz BOND-MAX wyposażone są w element grzejny w każdej pozycji szkiełka. Każdy z tych elementów jest niezależnie monitorowany i jest oznaczany jako uszkodzony, jeśli wystąpi błąd temperatury (zob. [Postać 2-8](#)). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podgrzewacza należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Postać 2-8: Błąd pojedynczego podgrzewacza

Nie należy próbować uruchamiać przebiegu dla szkiełka wymagającego ogrzewania w pozycji oznaczonej jako wadliwa. W przypadku nieprawidłowego działania podgrzewacza podczas przebiegu szkiełko może nie zostać przetworzone prawidłowo.

Jeśli awaria podgrzewacza stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, moduł przetwarzania wyłącza wszystkie podgrzewacze szkiełek, w tym podgrzewacz dowolnego przetwarzanego szkiełka kontrolowanego temperaturowo.



Postać 2-9: Szare symbole podgrzewaczy we wszystkich pozycjach oznaczają całkowite wyłączenie podgrzewania.

Po wyłączeniu podgrzewania szkiełek należy wyłączyć, a następnie ponownie uruchomić moduł przetwarzania, aby usunąć blokadę podgrzewacza. Można nadal używać pozycji szkiełek z wadliwymi podgrzewaczami, o ile przetwarzane szkiełka nie wymagają ogrzewania.

## 2.2.6 Osłona przednia

Poniższe rysunki przedstawiają osłony przednie BOND-III oraz BOND-MAX. Ponumerowane elementy są opisane poniżej [Postać 2-11](#).



Postać 2-10: Osłona przednia BOND-III



Postać 2-11: Osłona przednia BOND-MAX

Nr	Pozycja	Nr	Pozycja
1	<a href="#">Dioda LED zasilania</a>	4	<a href="#">Platforma odczynników</a>
2	<a href="#">Gniazdo na tacę na szkiełka</a>	5	<a href="#">Dioda LED tacy na odczynniki</a>
3	<a href="#">Dioda LED tacy na szkiełka</a>	6	<a href="#">Przycisk załadunku/rozładunku</a>

### 2.2.6.1 Dioda LED zasilania

Działa w następujący sposób:

- **Wył.** – brak zasilania
- **Niebieski** (obecny model) lub **pomarańczowy** (poprzednie modele) – zasilanie włączone, ale oprogramowanie modułu przetwarzania nie zostało jeszcze uruchomione
- **Zielony** – zasilanie włączone, system pracuje.



Postać 2-12: Kolory diody LED zasilania (niebieski, zielony) w urządzeniu BOND-MAX

### 2.2.6.2 Gniazdo na tacę na szkiełka


Dostępne są trzy otwory (jeden dla każdego zespołu barwienia szkiełek), w którym umieszczane są tace na szkiełka. Po włożeniu tacy na szkiełka nacisnąć przycisk Load/Unload (Załaduj/Wyładuj), aby zablokować ją w zespole barwienia szkiełek. Po zablokowaniu tacy ramię robota przesuwają czytnik ID nad szkiełkami, aby automatycznie je zidentyfikować.

### 2.2.6.3 Dioda LED tacy na szkiełka

Wielokolorowe diody LED na osłonie przedniej pod każdym zespołem barwienia szkiełek wskazują stan tacy na szkiełka. W przypadku urządzeń BOND-MAX diody LED tacy na szkiełka znajdują się na przyciskach Load/Unload (załaduj/wyładuj). W przypadku tych urządzeń dioda LED po naciśnięciu zmienia kolor na niebieski na kilka sekund.

Kolory diod LED zespołu barwienia szkiełek są następujące:

- **Wył.** – brak tacy szkiełek lub taca na szkiełka jest odblokowana.
- **Ciągły pomarańczowy** – taca jest załadowana i zablokowana, ale przetwarzanie nie zostało rozpoczęte.  
Tacę można bezpiecznie odblokować i wyjąć za pomocą przycisku Load/Unload (załaduj/wyładuj).
- **Ciągły czerwony** – taca jest przetwarzana.  
Taca jest zablokowana i nie może zostać odblokowana za pomocą przycisku Load/Unload (Załaduj/Wyładuj). Aby rozładować tacę, należy najpierw zrezygnować z przebiegu w oprogramowaniu.
- **Migający zielony** – przetwarzanie zakończone bez powiadomień. Tacę można odblokować za pomocą przycisku Load/Unload (załaduj/wyładuj).
- **Migający czerwony** – przebieg został odrzucony lub przetwarzanie zostało zakończone z powiadomieniami. Tacę można odblokować za pomocą przycisku Load/Unload (załaduj/wyładuj).

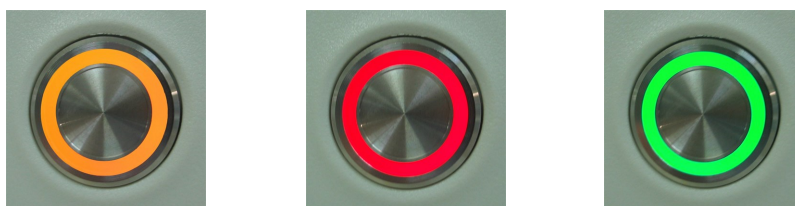

Postać 2-13: Kolory diod LED tacy na szkiełka (pomarańczowy, czerwony, zielony) dla narzędzia BOND-MAX

#### 2.2.6.4 Przycisk załadunku/rozładunku

Naciśnięcie przycisku Load/Unload (załadowaj/wyładowaj) powoduje:

- Jeśli taca nie zostanie załadowana, nic się nie dzieje.
- Jeśli taca jest załadowana i nie jest zablokowana, urządzenie BOND-III lub BOND-MAX zablokuje tacę, a jeśli ramię robota jest dostępne, czytnik ID zidentyfikuje szkiełka.
- Jeśli taca jest zablokowana i nie rozpoczęto przebiegu, urządzenie BOND-III lub BOND-MAX odblokuje tacę.
- Jeśli taca jest zablokowana i nie zakończono przebiegu, urządzenie BOND-III lub BOND-MAX odblokuje tacę.
- Jeśli taca jest zablokowana i trwa przebieg, przycisk Load/Unload (załadowaj/wyładowaj) jest nieaktywny. Nie można odblokować tacy aż do zakończenia lub anulowania przebiegu.

Jeśli zespół barwienia szkiełek jest gorący, nie można zablokować ani odblokować tacy – należy poczekać na schłodzenie zespołu.

#### 2.2.6.5 Platforma odczynników


W tym miejscu umieszczane są tace na odczynniki zawierające systemy detekcji, pojemniki na odczynniki 7 ml i 30 ml i/lub pojemniki do miareczkowania 6 ml. Każda taca może pomieścić do dziewięciu odczynników, a platforma odczynników może pomieścić cztery tace na odczynniki.

Aby załadować tacę na odczynniki, należy wsunąć tacę na platformę i w mechanizm blokujący (zob. [4.1.4 - Ładowanie odczynników](#)). Gdy ramię robota jest dostępne, system BOND zidentyfikuje odczynniki w poszczególnych pozycjach.

#### 2.2.6.6 Dioda LED tacy na odczynniki

Poniżej każdej pozycji tacy znajduje się dwukolorowa dioda LED, która działa w następujący sposób:

- **Wył.** – nie wykryto tacy.  
Jeśli taca jest włożona a dioda LED jest wyłączona, należy sprawdzić, czy taca została umieszczona prawidłowo.
- **Ciągle czerwone światło** – w ciągu następnych dwóch minut potrzebny będzie odczynnik z tej tacy.  
Taca jest zablokowana i nie można jej usunąć.
- **Ciągle zielone światło** – w ciągu następnych dwóch minut żaden odczynnik z tej tacy nie będzie potrzebny.  
Taca jest odblokowana i może zostać tymczasowo usunięta.

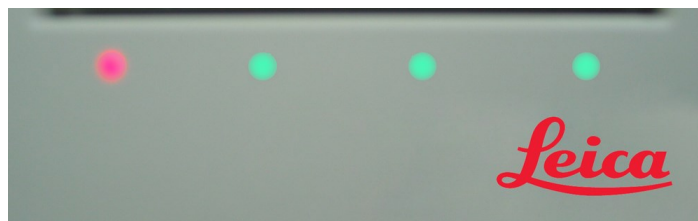

Postać 2-14: Kolory diod LED tacy na odczynniki (czerwony, zielony) dla narzędzia BOND-MAX

## 2.2.7 Przedział na pojemniki zbiorcze

Pojemniki zbiorcze i pojemniki na odpady znajdują się pod osłoną przednią w BOND-III oraz BOND-MAX. System BOND-MAX posiada również pojemnik zewnętrzny na odpady standardowe.

Zob. [12.2 - Pojemniki zbiorcze](#) aby uzyskać informacje na temat napełniania, opróżniania i konserwacji pojemników zbiorczych.



Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy umieścić każdy zbiorczy pojemnik z odczynnikiem w odpowiednim przedziale, zgodnie z oznaczeniami kolorystycznymi.

Dla BOND-III, zob. [Postać 2-15](#); dla BOND-MAX, zob. [Postać 2-17](#).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na barwienie.



Niektóre z odczynników używanych w modułach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX są łatwopalne:

- Nie umieszczaj płomienia ani źródła zapłonu w pobliżu modułów przetwarzania.
- Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnij się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.

- [2.2.7.1 - BOND-III](#)
- [2.2.7.2 - BOND-MAX](#)

### 2.2.7.1 BOND-III

Poprzedni moduł BOND-III wyposażony jest w podwójne drzwi szafki, które umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich pojemników zbiorczych. Podczas otwierania należy trzymać poręcz na górze drzwi.

Wszystkie odpady z zespołów barwienia szkiełek są transportowane do pojemnika na odpady niebezpieczne. Odpady z bloku myjącego są transportowane do pojemników na odpady standardowe lub niebezpieczne w zależności od stanu odczynnika w odpadach (jeśli to konieczne, należy określić niebezpieczne odczynniki – zob. [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)).

Czujniki masy dla każdego pojemnika zbiorczego i pojemnika na odpady ostrzegają użytkownika, kiedy poziom odczynnika jest niski lub poziom odpadów jest zbyt wysoki. Status każdego pojemnika zbiorczego jest wskazywany wizualnie przez [System oświetlenia pojemnika zbiorczego \(BOND-III\) on page 34](#). Należy pamiętać, że system nie jest wyposażony w poprzedni moduł BOND; zamiast tego można korzystać z ikon na ekranie (zob. [5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego](#)).

Moduł BOND-III posiada miejsce na następujące pojemniki, na półkach wskazanych na [Postać 2-15](#), kolejno od lewej do prawej:

Stacja	Pojemnik	Pozycja	Rozmiar (L)	Kolor	Odczynnik
8	ER1	Górna półka	2	Fioletowy	BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9	ER2		2	Jasnofioletowy	BOND Epitope Retrieval Solution 2*
1	Dewax solution	Dolna półka	5	Czerwony	BOND Dewax Solution*
2	Woda dejonizowana		5	Niebieski	Woda dejonizowana
3	Bufor myjący		5	Zielony	BOND Wash Solution*
4	Alkohol		5	Pomarańczowy	Alkohol (odczynnikiowy)
5	Odpady zbiorcze		5	Szary	Odpady standardowe
6	Odpady zbiorcze		5	Szary	Odpady standardowe
7	Odpady niebezpieczne		5	Brązowy	Odpady niebezpieczne

\* Używać wyłącznie odczynników BOND – nie zastępować innymi produktami.

Jeśli laboratorium nie korzysta z pojemników na odczynniki Epitope Retrieval i/lub Dewax, można je wyłączyć w kliencie administracyjnym – zob. [10.6.1.1 - Wyłączanie zbiorczych pojemników na odczynniki](#).



Upewnić się, że kolor etykiety i nadrukowany opis pojemnika zbiorczego odpowiadają etykietce w przedziale urządzenia, bezpośrednio pod pojemnikiem.

Postać 2-15: Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-III we właściwym miejscu



## System oświetlenia pojemnika zbiorczego (BOND-III)

Moduły przetwarzania BOND-III są wyposażone w system oświetlenia pojemnika zbiorczego, jak przedstawiono na [Postać 2-16](#) poniżej.



Postać 2-16: System oświetlenia pojemnika zbiorczego

System oświetlenia pojemnika zbiorczego pomaga zobaczyć poziom cieczy w poszczególnych pojemnikach, a kontrolki świecą stałym białym światłem w trakcie normalnej pracy.

Kontrolki wskazują również obecny status każdego pojemnika zbiorczego:

- Gdy pojemnik zbiorczy jest prawie pusty lub pojemnik na odpady jest prawie pełny, białe kontrolki zaczynają migać.
- Gdy pojemnik zbiorczy jest pusty lub pojemnik na odpady jest pełny, a wpływa to na bieżący przebieg, kontrolki zmieniają kolor na czerwony.
- Po usunięciu pojemnika zbiorczego jego podświetlenie wyłącza się, a podświetlenie etykiety w przedziale urządzenia miga na biało.



System oświetlenia pojemnika zbiorczego działa wyłącznie z oprogramowaniem BOND 6.0 lub nowszym.


Zob. również: [5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki pojemniki zbiorcze są przedstawiane na ekranie **System status** (stan systemu).



### 2.2.7.2 BOND-MAX

System BOND-MAX wyposażony jest w pojedyncze drzwi otwierane w dół i umożliwiające dostęp do pojemników zbiorczych. Drzwi posiadają przezroczysty panel umożliwiający monitorowanie poziomów odczynników w pojemnikach zbiorczych (które są również przezroczyste).

Drzwi są przytrzymywane przez zatrzaski magnetyczne. Aby otworzyć drzwiczki w poprzednich modelach (bez uchwyty), należy pociągnąć za górną część każdego skrzydła drzwi.

 Drzwi przedziału na pojemniki zbiorcze muszą być zamknięte podczas barwienia. Jeśli drzwi są otwarte, na ekranie stanu systemu wyświetlony zostanie alarm (zob. [5.1.2 - Status urządzenia](#)), a wszystkie bieżące przebiegi mogą zostać przerwane.

Odpady z urządzenia są transportowane do pojemników na odpady standardowe lub niebezpieczne w zależności od stanu odczynnika w odpadach (jeśli to konieczne, należy określić niebezpieczne odczynniki – zob. [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)).

Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-MAX wyposażone są w czujniki poziomu cieczy, aby ostrzegać o niskim poziomie odczynnika; pojemniki również wyposażone są w czujniki poziomu cieczy, aby ostrzegać o zbyt wysokim poziomie odpadów. Zob. [12.2 - Pojemniki zbiorcze](#), aby uzyskać informacje na temat ponownego napełniania i opróżniania.

BOND-MAX ma miejsce na następujące pojemniki, w kolejności od lewej do prawej:

Stacja	Pojemnik	Rozmiar (L)	Kolor	Odczynnik
1	Odpady niebezpieczne	2	Brązowy	Odpady niebezpieczne
2	ER1	1	Fioletowy	BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3	ER2	1	Jasnofioletowy	BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4	Dewaxing solution	2	Czerwony	BOND Dewax Solution*
5	Woda dejonizowana	2	Niebieski	Woda dejonizowana
6	Bufor myjący	2	Zielony	BOND Wash Solution*
7	Alkohol	2	Pomarańczowy	Alkohol (odczynnikowy)

\* Używać wyłącznie odczynników BOND – nie zastępować innymi produktami.

Pojemniki z odczynnikiem Epitope Retrieval i/lub Dewax można wyjąć z urządzenia, jeśli nie są wykorzystywane – zob. [10.6.1.1 - Wyłączanie zbiorczych pojemników na odczynniki](#).



Upewnić się, że kolor etykiety i nadrukowany opis pojemnika zbiorczego odpowiadają etykietce w przedziale urządzenia, bezpośrednio pod pojemnikiem.

Postać 2-17: Zbiorniki na odczynniki BOND-MAX we właściwym miejscu

### Zewnętrzny pojemnik na odpady

Dziewięciolitrowy zewnętrzny pojemnik na odpady jest dostarczany wraz z BOND-MAX.

Dostarczony pojemnik ma dwie pokrywy – jedną dla złącza, a drugą do opróżniania odpadów. Nigdy nie zdejmować pokrywy złącza tego pojemnika.



Postać 2-18: Zewnętrzny pojemnik na odpady BOND-MAX

Przewód cieczy łączy się ze złączem wciskanym w prawym dolnym rogu modułu przetwarzania. Czujnik poziomu cieczy łączy się z 3-pinowym złączem w lewym górnym rogu osłony (zob. [Postać 2-26](#)).

Instrukcje dotyczące opróżniania i konserwacji zewnętrznego pojemnika znajdują się w części [12.2.4 - Zewnętrzny pojemnik na odpady \(tylko BOND-MAX\)](#)



Niektóre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ są niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynności należy odbyć odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas tej procedury.

- a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urządzenia należy nosić rękawiczki lateksowe lub nitrylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie środki ochronne.
- b. Odczynniki i kondensat należy transportować i utylizować zgodnie ze wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowiązującymi w laboratorium.



Niektóre z odczynników używanych w modułach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX są łatwopalne:


- Nie umieszczać płomienia ani źródła zapłonu w pobliżu modułów przetwarzania.
- Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.



Przed opróżnieniem zewnętrznego pojemnika na odpady należy zawsze odłączyć złącza czujnika i cieczy (w tej kolejności). Nie próbować nalewać cieczy z pojemnika, gdy przewód i rura są nadal podłączone.

## 2.2.8 Sonda aspiracyjna

Sonda aspiracyjna pobiera odczynniki z pojemników, dostarcza odczynniki do szkiełek w zespołach barwienia szkiełek i miesza chromogeny w stacji mieszania. Zawiera czujnik poziomu cieczy do wykrywania poziomu odczynnika (zob. [8.3.1 - Określanie objętości odczynnika](#)).

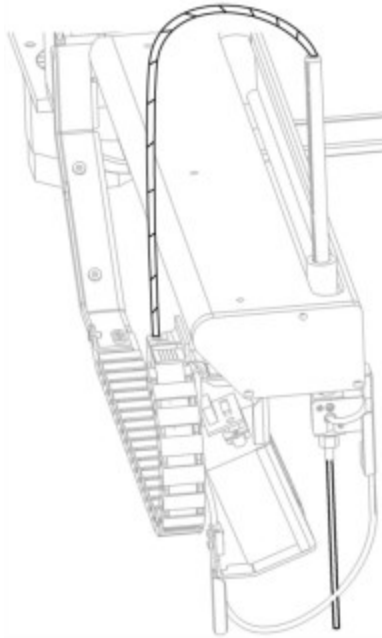


Postać 2-19: Sonda aspiracyjna w ramieniu robota

W każdym pojemniku znajduje się objętość resztkowa, której sonda nie jest w stanie pobrać. Objętość ta jest określana jako „objętość martwa”. Objętość martwa jest inna dla każdego typu pojemnika (zob. [18.5 - Dane dotyczące pracy](#) w [18 - Specyfikacje](#), aby uzyskać wartości objętości martwej).

Zob. [12.6 - Sonda aspiracyjna](#), aby uzyskać informacje na temat konserwacji sondy aspiracyjnej.

## 2.2.9 Blok myjący i stacja mieszania

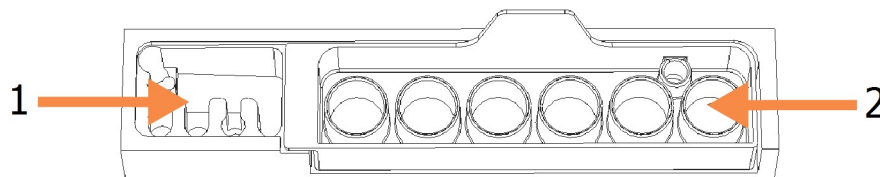

Postać 2-20: Blok myjący z włożoną stacją mieszania

Obszar mycia znajduje się po lewej stronie (pozycja 1), a stacja mieszania po prawej (pozycja 2)


Obszar mycia po lewej stronie zawiera małe otwory do mycia sondy aspiracyjnej.

Po prawej stronie bloku myjącego znajduje się stacja mieszania, która składa się z sześciu przedziałów. Są to fiołki do mieszania odczynników o krótkim okresie eksploatacji, które należy wymieszać tuż przed użyciem. Mieszanie odczynników jest określane przez oprogramowanie, w zależności od rodzaju odczynnika.

- i Oprogramowanie BOND monitoruje stan stacji mieszania i nie uruchamia BOND-III lub BOND-MAX, jeśli stan stacji jest inny niż czysta i pusta (zob. [5.1.2 - Status urządzenia](#)). Jeśli podczas inicjalizacji stacja mieszania jest brudna lub zawiera ciecz, należy upewnić się, że stacja jest czysta i pusta przed kliknięciem **OK** w oknie dialogowym powiadomienia. W przypadku kontynuowania mieszania w brudnej i/lub pełnej stacji mieszania może dojść do zanieczyszczenia odczynników lub przepełnienia fiołek do mieszania.
- i Zawsze upewniać się, że stacja mieszania jest obecna – moduł przetwarzania nie uruchamia się bez stacji. Podczas inicjalizacji system BOND skanuje etykietę stacji mieszania, aby sprawdzić, czy jest obecna. Jeśli oprogramowanie BOND nie wykrywa identyfikatora, pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie obecności stacji mieszania.

Instrukcje konserwacji stacji mieszania znajdują się w części [12.7 - Blok myjący i stacja mieszania](#).

## 2.2.10 Roboty odczynników zbiorczych (wyłącznie BOND-III)

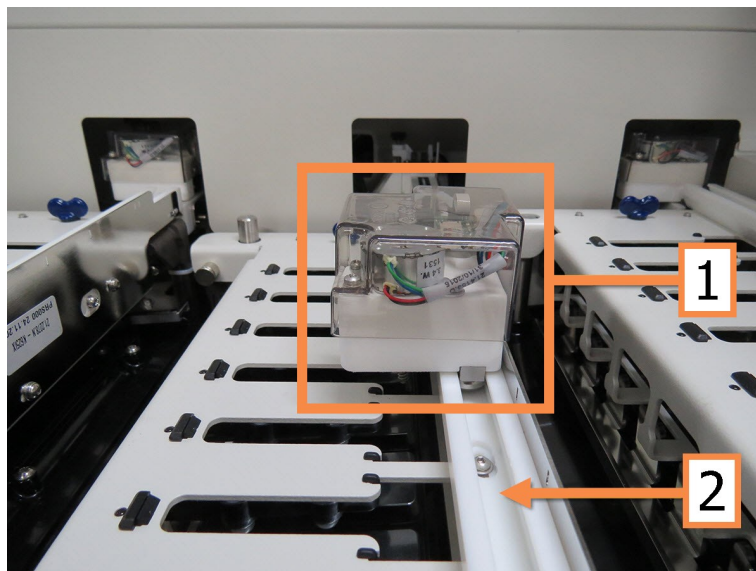

Postać 2-21: Robot odczynników zbiorczych BOND (1) przesuwa się wzdłuż szyny prowadzącej (2) do kolejnych zespołów barwienia szkiełek



Jeżeli robot główny i/lub roboty odczynników zbiorczych nadal działają przez ponad 5 sekund po otwarciu pokrywy modułu przetwarzania, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.

Urządzenie BOND wyposażone jest w trzy roboty odczynników zbiorczych, które przemieszczają się wzdłuż szyny prowadzącej do kolejnych zespołów barwienia szkiełek i dozują odczynniki na wszystkie załadowane szkiełka. Roboty dostarczają tylko odczynniki zbiorcze, natomiast sonda aspiracyjna dostarcza odczynniki z pojemników na platformie odczynników i niektóre odczynniki zbiorcze. Każdy robot odczynników zbiorczych posiada blok myjący do płukania i czyszczenia sondy dozującej.

### 2.2.10.1 Ręczne przywracanie robota odczynników zbiorczych do pozycji wyjściowej

Jeśli robot odczynników zbiorczych zatrzymał się i jest umieszczony wzdłuż zespołu barwienia szkiełek, należy nacisnąć przycisk Load/Unload (załaduj/wyładuj), aby przywrócić go do położenia wyjściowego. Jeśli znajduje się na zespole barwienia szkiełek, należy wykonać następujące czynności, aby ręcznie powrócić do pozycji wyjściowej i pobrać wszystkie szkiełka w zespole barwienia szkiełek.

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności i nie ma zaplanowanych ani trwających przebiegów, a następnie wyłączyć go.
2. Delikatnie podnieść blok dozujący na robocie odczynników zbiorczych (zob. [Figure 2-22](#)), tak aby sonda wysunęła się ponad górną płytę.
3. Przesunąć robota wzdłuż szyny do tylnej części zespołu barwienia szkiełek. Stosować powolny, stabilny ruch – nie przesuwać zbyt szybko.



Przesuwać do momentu, gdy robot znajdzie się w pobliżu szyny płyty górnej – **nie** przesuwać do końca.

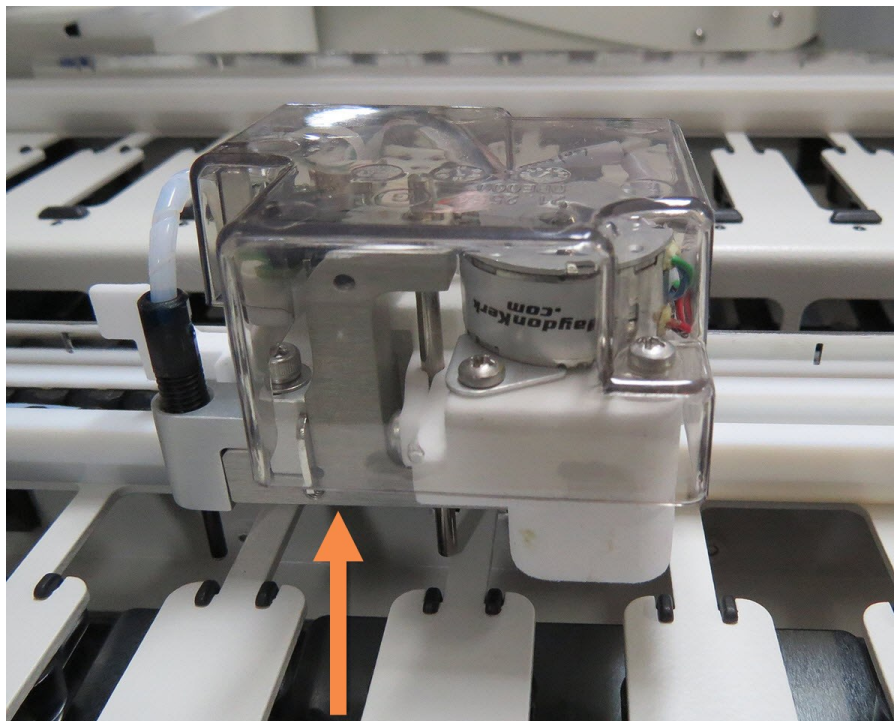


Figure 2-22: Podnieść wskazany blok dozujący i przesunąć robota odczynników zbiorczych wzdłuż szyny prowadzącej zespołu barwienia szkiełek

4. Gdy robot znajduje się za górną płytą, zamknąć pokrywę i ponownie włączyć moduł przetwarzania. Zespół barwienia szkiełek powinien zostać odblokowany w ramach procedury inicjalizacji. Jeśli zespół barwienia szkiełek nie odblokowuje się, zob. [12.4.1 - Ręczne odblokowanie zespołów barwienia szkiełek](#), aby uzyskać instrukcje dotyczące wyjmowania tac na szkiełka.
5. Pobrać tacę na szkiełka i szkiełka.



## 2.2.11 Strzykawki


Strzykawki pobierają i dozują dokładne ilości odczynnika wymagane przez system BOND. Zob. [12.13 - Strzykawki](#) instrukcji konserwacji strzykawek.



Upewnić się, że drzwi strzykawki są zamknięte (BOND-MAX) lub zamontowana jest pokrywa strzykawki (BOND-III) podczas normalnej pracy. Jeśli strzykawka lub złącze strzykawki ulegną poluzowaniu, odczynnik pod ciśnieniem może wydostać się ze strzykawki.

### 2.2.11.1 BOND-III

System BOND-III wyposażony jest w cztery pompy strzykawek znajdujące się pod osłoną przednią. Pierwsze trzy pompy strzykawek, od lewej, są używane przez roboty odczynników zbiorczych w SSA1, SSA2, SSA3 i wyżej. Czwartą, główną pompą strzykawki jest używana przez sondę aspiracyjną.

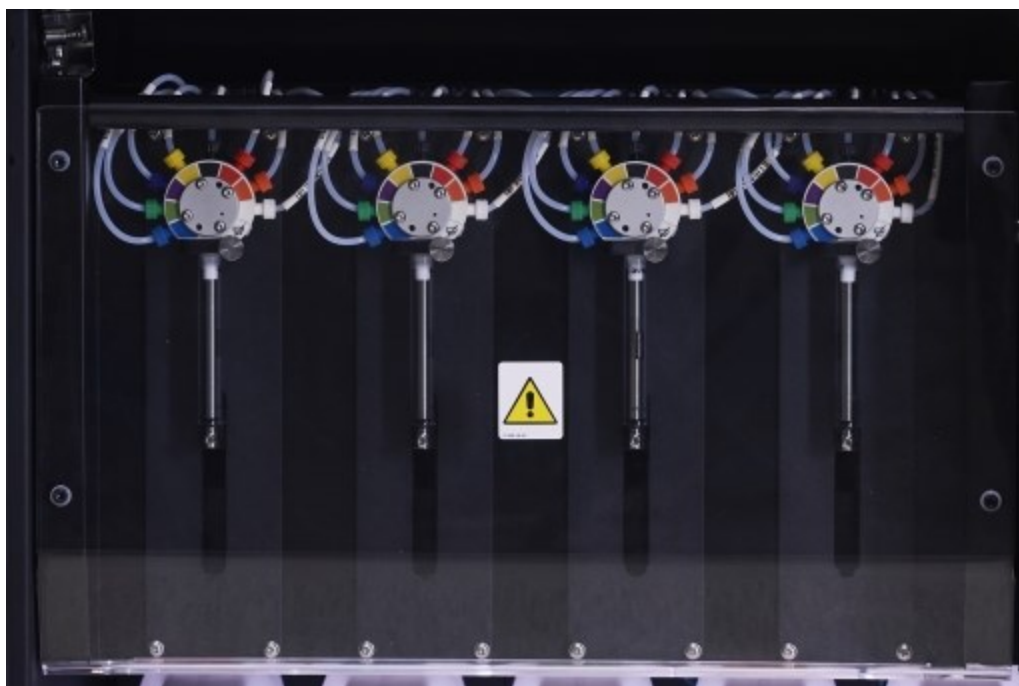

Postać 2-23: Strzykawki BOND



Upewnić się, że moduł strzykawki jest całkowicie zamknięty przed rozpoczęciem przebiegu lub inicjalizacją modułu przetwarzania (zob. [12.4.1 - Ręczne odblokowanie zespołów barwienia szkiełek](#)). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia strzykawek podczas pracy.



### 2.2.11.2 BOND-MAX

System BOND-MAX wyposażony jest w pojedynczą pompę strzykawkową umieszczoną w komorze po prawej stronie urządzenia. Jest to 9-portowy zawór strzykawkowy (jeden port nie jest używany) z przykręcaną tuleją strzykawkową i małym zaciskiem.



Postać 2-24: Strzykawka 9-portowa BOND-MAX

Aby sprawdzić stan strzykawki, należy otworzyć drzwi, naciskając i zwalniając okrągły element na środku drzwi.



Zawsze nosić odzież ochronną i rękawice ochronne.

Sprawdzać regularnie podczas inicjalizacji i wymieniać w razie potrzeby lub po otrzymaniu powiadomienia – zob. [12.13 - Strzykawki](#).

### 2.2.12 Wyłącznik zasilania

Jest to pojedynczy przełącznik umieszczony na prawej osłonie modułu przetwarzania. Służy to do włączania i wyłączenia modułu przetwarzania.

- Umieszczenie wyłącznika zasilania BOND-III przedstawiono na [Postać 2-3](#).
- Umieszczenie wyłącznika zasilania BOND-MAX przedstawiono na [Postać 2-5](#).


## 2.2.13 Osłona tylna



Nie zdejmować osłon modułu przetwarzania ani nie próbować uzyskać dostępu do wewnętrznych elementów. Wewnątrz modułu przetwarzania BOND znajduje się prąd o wysokim napięciu i wyłącznie wykwalifikowani serwisanci zatwierdzeni przez Leica Biosystems mogą wykonywać te czynności.

## 2.2.13.1 BOND-III

[Postać 2-25](#) przedstawia osłonę tylną modułu przetwarzania BOND.

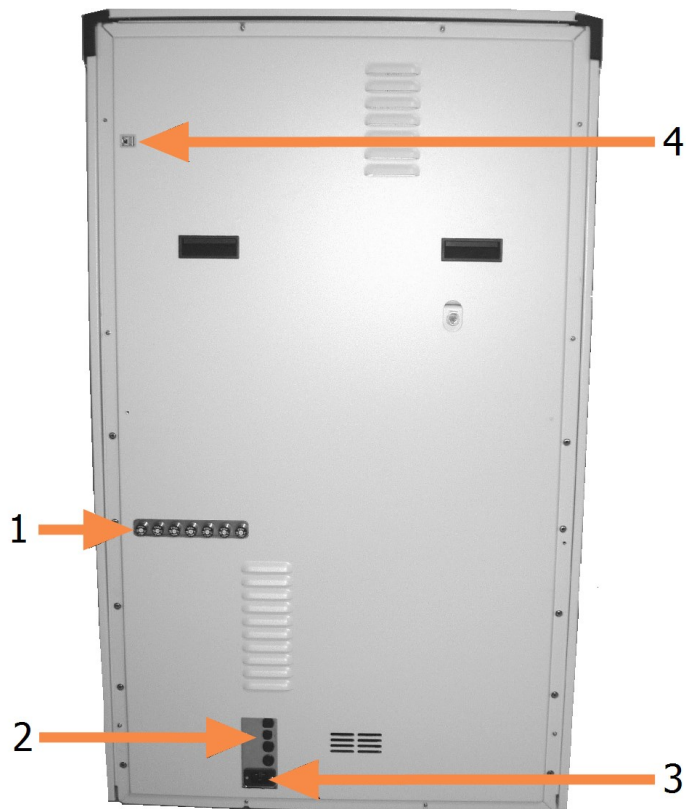

Postać 2-25: Osłona tylna BOND

Nr	Pozycja	Nr	Pozycja
1	Wyłączniki obwodów	3	Złącze zasilania sieciowego
2	Bezpieczniki	4	Połączenie Ethernet

Zob. [12.14 - Bezpieczniki zasilania](#) w celu uzyskania informacji na temat wymiany bezpieczników.



Nie używać dwóch czarnych uchwytów na tylnej osłonie BOND-III do podnoszenia urządzenia.

## 2.2.13.2 BOND-MAX

[Postać 2-26](#) przedstawia osłonę tylną modułu przetwarzania BOND-MAX. (Należy pamiętać, że poprzednie modele wyposażone są tylko w jeden wentylator zasilania).



Nr	Pozycja	Nr	Pozycja
1	Wyłączniki obwodów	5	Zewnętrzne przyłącze odpadów – dla przewodów (zob. <a href="#">12.2.4 - Zewnętrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)</a> )
2	Wentylatory zasilania	6	Zewnętrzne przyłącze odpadów – dla czujnika poziomu cieczy (zob. <a href="#">12.2.4 - Zewnętrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)</a> )
3	Bezpieczniki	7	Połączenie Ethernet
4	Złącze zasilania sieciowego		

Postać 2-26: Osłona tylna BOND-MAX

Zob. [12.14 - Bezpieczniki zasilania](#) w celu uzyskania informacji na temat wymiany bezpieczników.

### 2.2.13.3 Odłączanie modułu przetwarzania

Aby odłączyć moduł przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX od zasilania, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika po prawej stronie modułu przetwarzania.
2. Prześledzić przewód zasilający od złącza zasilania modułu przetwarzania (pozycja 3 na [Postać 2-25](#) i pozycja 4 na [Postać 2-26](#)) do ściany. Wyłączyć zasilanie sieciowe w gniazdku ściennym.
3. Odłączyć wtyczkę z tyłu modułu przetwarzania.

## 2.3 Kontroler i terminale BOND

Wszystkie systemy BOND zawierają kontroler BOND, w którym wykonuje się wszystkie procesy oprogramowania. W instalacjach jednostanowiskowych (zob. [3.1.1 - Konfiguracja jednostanowiskowa](#)), jeden kontroler z klawiaturą, myszą i monitorem jest używany do uruchamiania oprogramowania klienta. Instalacja jednostanowiskowa jest wystarczająca do obsługi maksymalnie pięciu modułów przetwarzania.

Laboratoria z instalacjami BOND-ADVANCE (zob. [3.1.2 - BOND-ADVANCE](#)) z więcej niż pięcioma modułami przetwarzania, dodatkowo wyposażone są w terminale BOND. W tych instalacjach większość interakcji użytkownika z oprogramowaniem BOND odbywa się poprzez terminale, z których każdy może sterować pojedynczymi lub wszystkimi modułami przetwarzania. Możliwe jest również sterowanie tymi samymi modułami przetwarzania z więcej niż jednego terminala.

Kontroler BOND nadal wykonuje wszystkie procesy oprogramowania. Kontrolery w instalacjach BOND-ADVANCE mają wyższą specyfikację niż modele stosowane w instalacjach jednostanowiskowych i zapewniają wiele poziomów redundancji, co zapewnia najwyższą niezawodność.

Niektóre instalacje BOND-ADVANCE wyposażone są w dodatkowy kontroler (zapasowy). Ten kontroler rejestruje wszystkie procesy na głównego kontrolera i może być użyty na wypadek awarii głównego kontrolera. Dodatkowe kontrolery nie powinny znajdować się w pobliżu głównego kontrolera, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia obu kontrolerów przez miejscowe zdarzenie.

Drukarka etykiet do szkiełek i ręczny skaner kodów kreskowych są podłączone do kontrolera w instalacjach jednostanowiskowych lub do każdego terminala w instalacji BOND-ADVANCE.



System operacyjny i oprogramowanie kontrolera BOND zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalną kontrolę nad systemem BOND. Aby uniknąć opóźnień lub zakłóceń w sterowaniu systemem, nie należy instalować dodatkowego oprogramowania na kontrolerze BOND lub terminalu.

---

## 2.4 Ręczny skaner kodów kreskowych



Postać 2-27: Ręczny skaner kodów kreskowych

Ręczne skanery kodów kreskowych USB są podłączane do kontrolera (instalacje jedno stanowiskowe) lub do terminali (instalacje BOND-ADVANCE). Są one używane do rejestracji odczytników; można je również wykorzystać do identyfikacji szkiełek, jeśli używane są kody kreskowe 1D lub 2D (zob. [6.5.6 - Ręczna identyfikacja szkiełka](#)).

- Jeśli system BOND został zaktualizowany z poprzedniej wersji, można nadal korzystać z istniejącego skanera kodów kreskowych. Poprzedni model nie obsługuje jednak kodów kreskowych 2D.

Ręczny skaner kodów kreskowych powinien być zainstalowany i sprawny po zamontowaniu systemu BOND. Zob. [13.1 - Ręczne skanery kodów kreskowych](#), aby uzyskać instrukcje konserwacji i konfiguracji.

### 2.4.1 Korzystanie z ręcznego skanera kodów kreskowych

- Poprzedni skaner kodów kreskowych Symbol emituje światło laserowe, natomiast nowszy skaner kodów kreskowych Honeywell emituje światło LED. Zapoznać się z ostrzeżeniem o zagrożeniu laserowym poniżej:



Niebezpieczeństwo związane z laserem. Możliwość poważnego urazu oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z laserem.

Aby odczytać kod kreskowy, należy skierować na niego skaner i nacisnąć przycisk. Wyrównać skaner tak, aby czerwona linia obejmowała pełną szerokość kodu kreskowego. Po rozpoznaniu kodu kreskowego skaner emituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zmienia kolor na zielony. W przypadku nierozpoznania kodu kreskowego skaner emituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zmienia kolor na czerwony.

- Nie trzymać kodów kreskowych zbyt blisko skanera. Jeśli skaner nie rozpoznaje kodu kreskowego, należy odsunąć kod dalej od skanera.

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, działa automatycznie i nie trzeba naciskać przycisku w celu odczytania kodu kreskowego.

## 2.5 Drukarka etykiet do szkiełek

Jednostanowiskowe systemy BOND wyposażone są w jedną drukarkę etykiet (nazywaną „drukarką etykiet do szkiełek”) podłączoną do kontrolera. W instalacjach BOND-ADVANCE oddzielne drukarki etykiet do szkiełek są podłączone do poszczególnych terminali.

Drukarki etykiet do szkiełek drukują naklejane etykiety, które nakleja się na szkiełka w celu ich identyfikacji. Wszystkie etykiety zawierają unikalny identyfikator szkiełka oznaczony jako kod kreskowy lub alfanumeryczny (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)). BOND używa identyfikatorów do automatycznego identyfikowania szkiełek po załadowaniu ich do modułów przetwarzania. Można skonfigurować inne informacje, a także identyfikatory, które mają być umieszczane na etykietach – zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#).

Niektóre laboratoria używają etykiet szkiełek wydrukowanych w systemie LIS, jednak drukarka etykiet do szkiełek BOND nadal stanowi część tego systemu dla wszystkich szkiełek tworzonych dla klienta klinicznego BOND.

Drukarki etykiet do szkiełek są ustawiane podczas standardowego montażu BOND. W przypadku dodania lub wymiany drukarki etykiet do szkiełek należy skonfigurować ją w na ekranie **Hardware** (urządzenie) klienta administracyjnego (zob. [10.6.3 - Slide Labelers \(drukarki etykiet do szkiełek\)](#)). W celu uzyskania informacji na temat wymiany etykiet i taśmy oraz czyszczenia drukarki należy zapoznać się z dostarczonymi wraz z drukarką dokumentów.



Używać wyłącznie etykiet szkiełek i taśmy do druku BOND. Etykiety te pozostają naklejone i czytelne podczas obróbki w urządzeniach BOND-III oraz BOND-MAX.

---

## 2.6 Wyposażenie pomocnicze

Ten rozdział opisuje wyposażenie pomocnicze używane w systemie BOND.

- [2.6.1 - Szkiełka](#)
- [2.6.2 - BOND Universal Covertiles](#)
- [2.6.3 - Systemy odczynników i pojemniki na odczynniki](#)

### 2.6.1 Szkiełka

W modułach przetwarzania BOND-III i BOND-MAX należy stosować wyłącznie szkiełka o odpowiednim rozmiarze. Szkiełka o niewłaściwym rozmiarze mogą nie układać się prawidłowo w tacach na szkiełka, a szkiełka nakrywkowe Covertile nie zostaną odpowiednio osadzone. Oba te czynniki mogą wpłynąć na jakość barwienia.

Leica Biosystems zaleca szkiełka Leica BOND Plus, które są przeznaczone do stosowania w systemie BOND. Poza optymalnym rozmiarem dla tacki na szkiełka BOND i szkiełek nakrywkowych Covertile, te dodatkowo naładowane szkiełka są oznaczone w celu wskazania obszarów, w których tkanki powinny być umieszczone dla dawek 100 µl i 150 µl (zob. [6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach](#)).

W przypadku korzystania z własnych szkiełek należy upewnić się, że spełniają następujące wymagania:

Wymiary	Szerokość: 24.64–26.0 mm (0.97–1.02 cala) Długość: 74.9–76.0 mm (2.95–2.99 cala) Grubość: 0.8–1.3 mm (0.03–0.05 cala)
Miejsce na etykietę	Szerokość: 24.64–26.0 mm (0.97–1.02 cala) Długość: 16.9–21.0 mm (0.67–0.83 cala)
Materiał	Szkleło, ISO 8037/1



Nie używać uszkodzonych szkiełek. Przed załadowaniem do modułu przetwarzania należy upewnić się, że wszystkie szkiełka są prawidłowo osadzone na tacach.




Nie używać szkiełek z zaokrąglonymi lub przyciętymi rogami. Szkiełka te mogą spaść przez otwory tacy na szkiełka i zmienić przepływ płynu pod szkiełkami nakrywkowymi Covertile, wpływając na jakość barwienia.


## 2.6.2 BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertiles to przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego, które znajdują się nad szkiełkami podczas barwienia. Zjawisko kapilarne pobiera odczynnik, który został dostarczony pomiędzy szkiełka nakrywkowe Covertile a szkiełka, zapewniając delikatne, równomierne pokrycie tkanki. Szkiełka nakrywkowe Covertile minimalizują ilość wymaganego odczynnika i chronią szkiełka przed wysuszeniem pomiędzy przebiegami. Szkiełka nakrywkowe Covertile to niezbędny element systemu barwienia BOND i należy ich zawsze używać.

Umieścić szkiełka nakrywkowe Covertile na szkiełkach po umieszczeniu szkiełek w tacach na szkiełka (zob. [4.1.3.5 - Ładowanie szkiełek](#)). Upewnić się, że szkiełka nakrywkowe Covertile są prawidłowo ustawione, tak aby klucz znajdował się w szyjce szkiełka nakrywkowego Covertile (zakreślone na zdjęciu, po prawej) w szczelinie tacy na szkiełka.

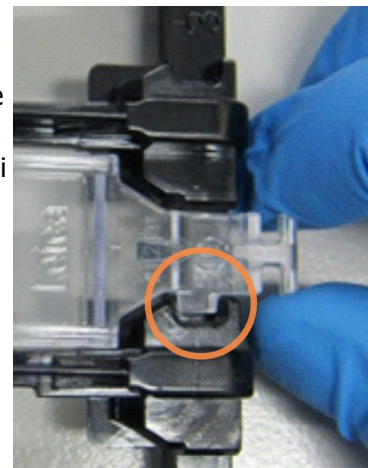


Dostępne są dwa rodzaje szkiełek nakrywkowych Covertile – można je stosować zamiennie. Nowa konstrukcja zawiera elementy (słowo **Leica**, mały okrągły znak i wystający element w lewej górnej części), aby lepiej wskazywać, gdy szkiełko nakrywkowe Covertile zostało nieprawidłowo umieszczone na szkiełku.

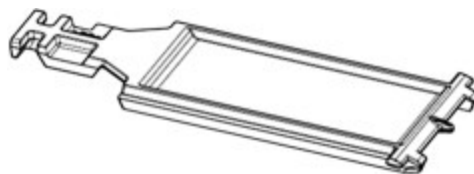


Postać 2-28: BOND Universal Covertile (oryginalna konstrukcja)



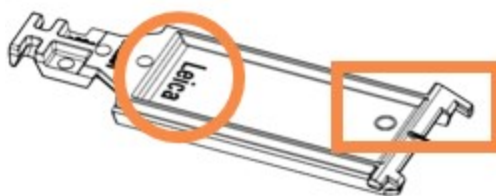

Postać 2-29: BOND Universal Covertile (nowa konstrukcja)


Szkiełka nakrywkowe Covertile mogą być używane wielokrotnie, do 25 razy, pod warunkiem, że nie są uszkodzone lub mocno odbarwione, a także pod warunkiem, że są prawidłowo czyszczone (zob. [12.3 - Szkiełka nakrywkowe Covertile](#)). Wyrzucić uszkodzone szkiełka nakrywkowe Covertile.

-  Niektóre systemy detekcji, na przykład Bond™ Oracle™ HER2 IHC System oraz Leica HER2 FISH, wymagają użycia nowych (tj. nieużywanych) szkiełek nakrywkowych Covertile. Należy wcześniej zapoznać się z odpowiednią Instrukcją obsługi.

### 2.6.2.1 Tace na szkiełka

Za pomocą tac na szkiełka przytrzymać szkiełka i szkiełka nakrywkowe Covertile w odpowiedniej pozycji podczas załadunku do modułu przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX. Każda taca może pomieścić dziesięć szkiełek.

Dostępne są dwa rodzaje tac na szkiełka – można je stosować zamiennie.

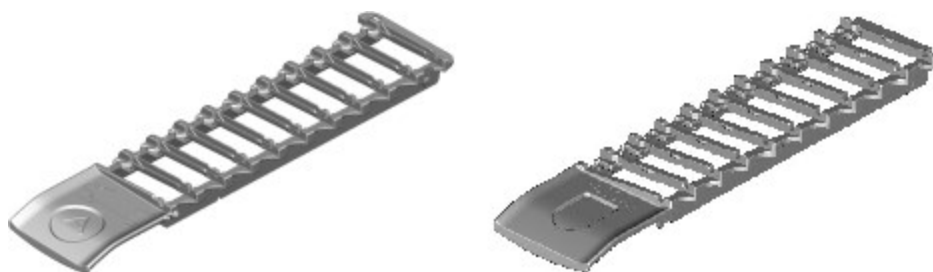


Postać 2-30: Taca na szkiełka (stara konstrukcja (po lewej) i nowa konstrukcja (po prawej))

Instrukcje dotyczące ładowania szkiełek i szkiełek nakrywkowych Covertile do modułu przetwarzania można znaleźć w części [4.1.3.5 - Ładowanie szkiełek](#).



### 2.6.2.2 Tace na odczynniki

Taca na odczynniki przechowuje pojemniki z odczynnikami BOND 7 ml i 30 ml oraz pojemniki do miareczkowania BOND 6 ml. Tace są ładowane do modułu przetwarzania na platformie odczynników (zob. [2.2.6.5 - Platforma odczynników](#)).

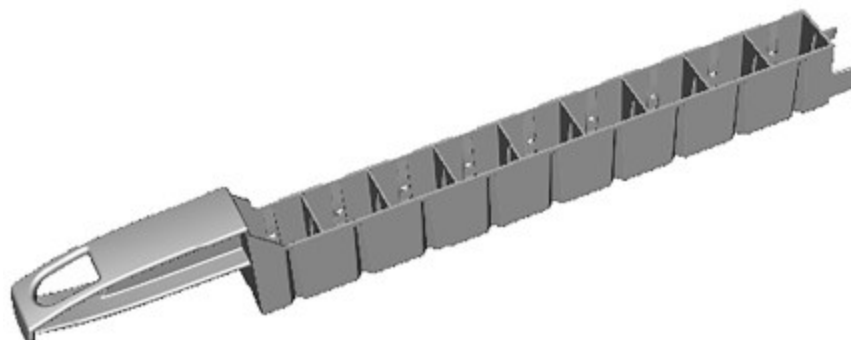

Postać 2-31: Taca na odczynniki

Pozycje pojemników na tacach na odczynniki są ponumerowane od strony przeciwnej do uchwytu (pozycja 1) do pozycji najbliższej uchwytu (pozycja 9).

Instrukcje dotyczące ładowania odczynników do modułu przetwarzania znajdują się w części [4.1.4 - Ładowanie odczynników](#).

## 2.6.3 Systemy odczynników i pojemniki na odczynniki

W tacach na odczynniki można używać różnych typów pojemników na odczynniki.

### 2.6.3.1 Systemy odczynników

Systemy odczynników to wstępnie zdefiniowane zestawy odczynników na tacy na odczynniki. System BOND wykorzystuje trzy rodzaje systemów odczynników:

- Systemy detekcji BOND
- Systemy teranostyczne Leica
- Systemy czyszczenia BOND

Zob. [8.1 - Przegląd zarządzania odczynnikami](#), aby dowiedzieć się więcej o każdym z tych systemów.

System odczynników jest rejestrowany przez zeskanowanie kodu kreskowego z boku tacy na odczynniki, a nie poprzez skanowanie kodów kreskowych poszczególnych pojemników. Pojemniki na odczynniki, które tworzą system, nie są zarejestrowane pojedynczo, są częścią tacy i nie powinny być usuwane ani ponownie układane. Po wyczerpaniu lub upływie terminu ważności systemu odczynników należy wyrzucić całą tacę i pojemniki.

### 2.6.3.2 Odczynniki gotowe do użycia BOND

Odczynniki gotowe do użycia BOND wykorzystują pojemniki, które pasują do tac na odczynniki. Odczynniki te są dostarczane w stężeniach zoptymalizowanych dla systemu BOND, dlatego przed użyciem należy je tylko zarejestrować i otworzyć.

Pojemniki przechowują różne ilości odczynnika, od 3.75 ml do 30 ml, w zależności od rodzaju odczynnika.

### 2.6.3.3 Otwarte pojemniki

Otwarte pojemniki to puste i czyste pojemniki do przechowywania odczynnika dostarczanego przez użytkownika (na przykład przeciwciała pierwszorzędowe). Są dostępne w rozmiarach 7 ml i 30 ml. Otwarte pojemniki mogą być używane tylko z jednym odczynnikiem i można je ponownie napełnić, tak aby każdy pojemnik mógł podawać maksymalnie 40 ml odczynnika (zob. [Ponowne napełnianie otwartego pojemnika na odczynnik \(Section 8.3.2.4 on page 183\)](#)).

Tylko otwarte pojemniki BOND mogą być używane w systemie BOND – nie używać innych pojemników (za wyjątkiem pojemników do miareczkowania) do przechowywania odczynników dostarczanych przez użytkownika.

### 2.6.3.4 Pojemniki do miareczkowania

Dostępne są również specjalne pojemniki do miareczkowania (zob. [14.2.1.4 - Zestaw do miareczkowania](#)). Obejmują one wyjmowaną płytkę 6 ml umożliwiającą łatwą wymianę odczynnika w pojemniku, na przykład podczas optymalizacji stężenia. Podobnie jak w przypadku otwartych pojemników, każdy pojemnik do miareczkowania może zostać uzupełniony i użyty do podania do 40 ml odczynnika bez ograniczeń co do liczby użytych płytek. Dziesięć płytek jest dostarczanych wraz z pojemnikiem w zestawie do miareczkowania BOND z Leica Biosystems.

## 2.7 Przeniesienie urządzenia



Skontaktować się z działem obsługi klienta w celu transportu modułu roboczego na dużą odległość lub w celu naprawy lub utylizacji. Moduł przetwarzania jest bardzo ciężki i nie jest przeznaczony do przenoszenia przez użytkownika.



Nie należy blokować otworów wentylacyjnych znajdujących się na tylnej osłonie urządzenia. Nie należy również zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się na drzwiach strzykawki (BOND-MAX).

W przypadku przenoszenia urządzenia BOND na niewielką odległość należy rozważyć następujące punkty przed kontynuowaniem:

- Przed przeniesieniem upewnić się, że podłoga jest w stanie wytrzymać ciężar urządzenia, zob. [18.2 - Dane fizyczne](#) w części [18 - Specyfikacje](#), aby uzyskać wymiary, oraz przestrzegać lokalnych wymagań.
- Przed uruchomieniem modułu przetwarzania należy ocenić środowisko elektromagnetyczne pod kątem zakłóceń.
- Nie używać urządzenia BOND w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego. Na przykład nieekranowane celowe źródła fal radiowych, które mogą zakłócać prawidłowe działanie.
- Nie podnosić urządzenia BOND za pomocą wózka widłowego.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego i upewnić się, że operator ma dostęp do złącza zasilania, do którego podłączony jest przewód.
- Przed przeniesieniem upewnić się, że przewód zasilający i kabel Ethernet są odłączone.
- Zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przed przeniesieniem opróżnić pojemniki na odpady.
- Odblokować wszystkie cztery kółka urządzenia BOND (lub wózka w przypadku BOND-MAX) przed przeniesieniem i ponownie zablokować w nowej lokalizacji.

## 2.8 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urządzenia

Przyrządu tego, w tym jego części i używanych nim akcesoriów, należy pozbyć się zgodnie z obowiązującymi miejscowymi procedurami i przepisami. Używane wraz z tym przyrządem odczynniki należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed zwrotem lub pozbyciem się tego przyrządu lub jego części i akcesoriów należy je wyczyścić i odkazić zgodnie z miejscowymi procedurami i przepisami.

W UE wszystkie odpady elektroniczne należy utylizować zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Poza UE należy przestrzegać miejscowych procedur i przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.

Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy kontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica Biosystems.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 3. Przegląd oprogramowania (Kontroler BOND )

Ten rozdział ma pomóc użytkownikowi zapoznać się z ogólnymi funkcjami oprogramowania BOND. Aby uzyskać instrukcje użycia oprogramowania do uruchamiania modułów przetwarzania i zarządzania szkiełkami, przypadkami i odczynnikami, należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami. Zob. [10 - Klient administracyjny \(w kontrolerze BOND \)](#), aby uzyskać instrukcje dla klienta administracyjnego.

- [3.1 - Architektura systemu](#)
- [3.2 - Uruchamianie i wyłączanie oprogramowania BOND](#)
- [3.3 - Role użytkownika](#)
- [3.4 - Przegląd interfejsu klienta klinicznego](#)
- [3.5 - BOND Dashboard](#)
- [3.6 - Powiadomienia, ostrzeżenia i alarmy](#)
- [3.7 - Raporty](#)
- [3.8 - Pomoc](#)
- [3.9 - O systemie BOND](#)
- [3.10 - Definicje danych BOND](#)
- [3.11 - Aktualizacje oprogramowania](#)

## 3.1 Architektura systemu

Oprogramowanie BOND w wersji 6.0 jest podobne do poprzednich wersji BOND w zakresie codziennego użytku, ale wygląd interfejsu został znacznie zmieniony.


Użytkownicy obsługują oprogramowanie BOND za pomocą dwóch „klientów” – dwa osobne programy. To klient kliniczny (lub po prostu „klient”) i klient administracyjny. Klient kliniczny jest przeznaczony do codziennej pracy – do konfiguracji odczytników, protokołów i przypadków oraz szkiełek przygotowywanych do przetwarzania, a następnie monitorowania i kontrolowania przebiegu modułu przetwarzania. Klient administracyjny jest używany do konfiguracji ustawień zaawansowanych, które rzadko ulegają zmianie po wstępnej konfiguracji. Obejmują one konfiguracje etykiet szkiełek, połączeń urządzenia i kont użytkowników (zob. [10 - Klient administracyjny \(w kontrolerze BOND \)](#)).

- [3.1.1 - Konfiguracja jedno stanowiskowa](#)
- [3.1.2 - BOND-ADVANCE](#)

### 3.1.1 Konfiguracja jedno stanowiskowa

Instalacje jedno stanowiskowe posiadają tylko jeden „kontroler BOND”, który jest jedynym punktem interakcji użytkownika z oprogramowaniem BOND (a przez to kontroli nad modułami przetwarzania). Kontroler BOND obsługuje oprogramowanie systemu i zarządza bazą danych, w której przechowywane są informacje o przypadkach i szkiełkach. Wyposażony jest w klawiaturę, mysz i monitor, a także drukarkę etykiet do szkiełek i skaner.

Istnieje limit pięciu modułów przetwarzania w systemie jedno stanowiskowym. Jeśli potrzebnych jest więcej modułów przetwarzania, należy przejść na wersję BOND-ADVANCE.

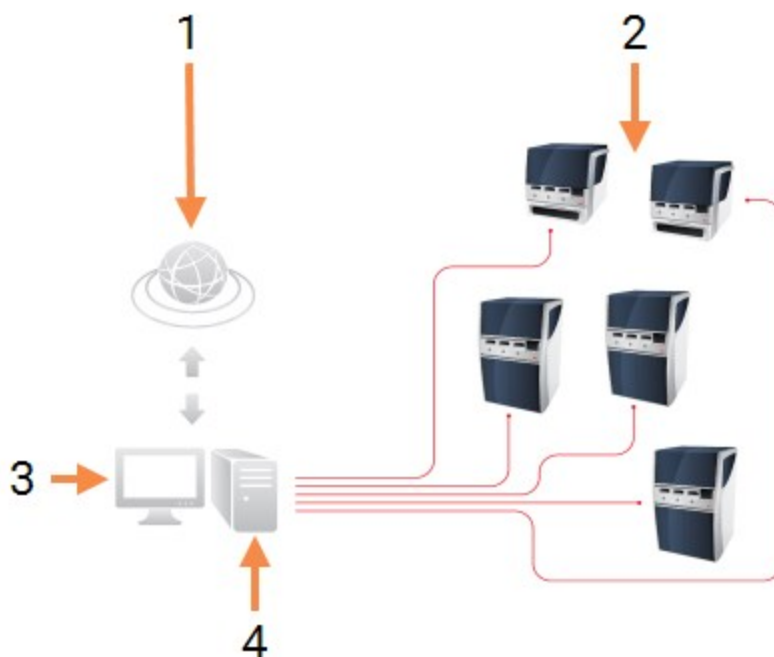

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 3-1</a> )
1	Połączenie LIS
2	Moduły przetwarzania (maksymalnie pięć)
3	Klient kliniczny/Klient administracyjny
4	BONDKontroler


Postać 3-1: Schemat instalacji jedno stanowiskowej

### 3.1.2 BOND-ADVANCE

Instalacje BOND z więcej niż pięcioma modułami przetwarzania są skonfigurowane jako wielostanowiskowe instalacje BOND-ADVANCE. Kontroler BOND nadal kontroluje oprogramowanie całego systemu, ale większość danych wejściowych pochodzi z terminali BOND-ADVANCE znajdujących się w pobliżu grup roboczych modułów przetwarzania (zwanymi „grupami” w oprogramowaniu BOND), które kontrolowane są przez terminale. Grupy są zdefiniowane w kliencie administracyjnym.

Monitor podłączony do kontrolera wyświetla komunikat „BOND Dashboard”, który zawiera podsumowanie stanu w czasie rzeczywistym dla każdego modułu przetwarzania w systemie (zob. [3.5 - BOND Dashboard](#)). Jeśli jest to konieczne, panel ten można również podłączyć do dedykowanego terminala. Klient administracyjny może zostać uruchomiony z dowolnego terminalu.

Niektóre laboratoria mogą posiadać dodatkowy kontroler, który wykonuje kopie zapasowe wszystkich danych BOND w czasie rzeczywistym i może zostać aktywowany na wypadek awarii głównego kontrolera. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [16.2 - Przełączenie na kontroler dodatkowy](#).

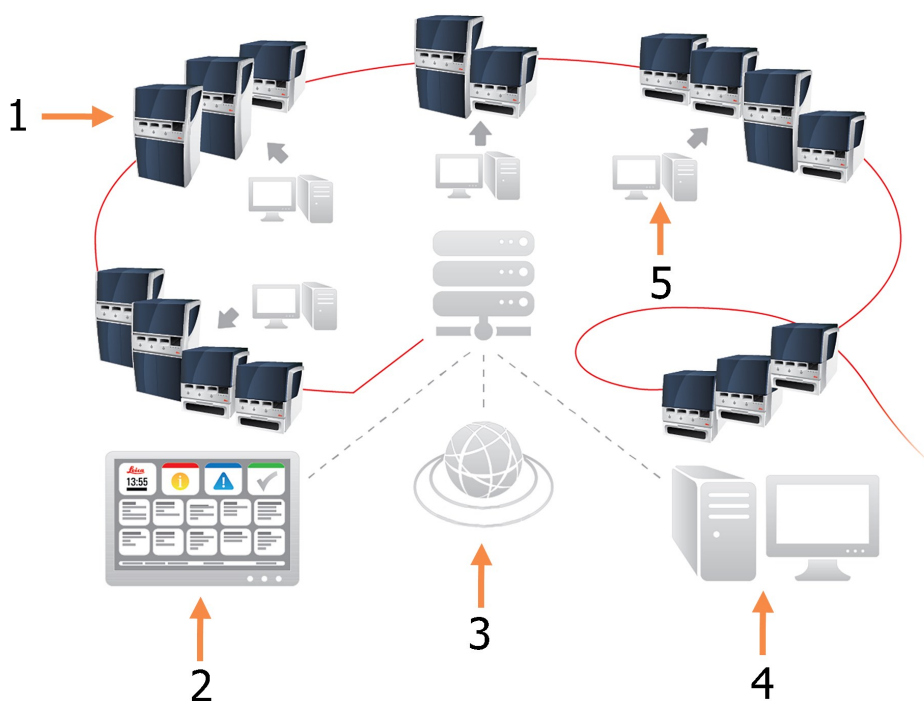

Postać 3-2: Schemat instalacji BOND-ADVANCE – terminale BOND-ADVANCE sterują modułami przetwarzania w grupach poprzez kontroler BOND-ADVANCE.

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 3-2</a> )
1	Moduły przetwarzania w grupach
2	BOND-ADVANCE Dashboard
3	Połączenie LIS
4	Kontroler BOND-ADVANCE
5	Terminale BOND-ADVANCE



## 3.2 Uruchamianie i wyłączanie oprogramowania BOND

### Uruchamianie

Oprogramowanie BOND można uruchomić przed lub po uruchomieniu dowolnego podłączonego modułu przetwarzania. Aby uruchomić oprogramowanie:

1. **Konfiguracja jednostanowiskowa:** w razie potrzeby uruchomić kontroler BOND i zalogować się do systemu Windows® jako użytkownik „BONDUser”. W celu uzyskania hasła należy skontaktować się z kierownikiem laboratorium. Uwaga: gdy system jest nowy, początkowe hasło nie jest skonfigurowane.

**BOND-ADVANCE:** w razie potrzeby uruchomić kontroler BOND-ADVANCE. Pulpit powinien zostać otwarty automatycznie (jeśli nie, dwukrotnie kliknąć skrót **BOND Dashboard** na pulpicie Windows. Naciśnąć <F11>, aby ustawić przeglądarkę Internet Explorer w trybie pełnoekranowym).

Uruchomić potrzebny terminal i zalogować się do systemu Windows jako użytkownik „BONDUser”. W celu uzyskania hasła należy skontaktować się z kierownikiem laboratorium. Uwaga: gdy system jest nowy, początkowe hasło nie jest skonfigurowane.



Hasło BONDUser wygasa okresowo, wtedy po zalogowaniu konieczna jest zmiana hasła.

2. Dwukrotnie kliknąć odpowiednią ikonę pulpitu, aby uruchomić klienta klinicznego lub klienta administracyjnego (oba te elementy mogą również być uruchomione jednocześnie).
3. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło BOND.  
W przypadku otwierania klienta klinicznego w systemie BOND-ADVANCE można wybrać grupę do połączenia.



Klient kliniczny BOND-ADVANCE pamięta ostatnio wybraną grupę.

Hasło można zmienić w oknie dialogowym logowania w dowolnym momencie. Należy przestrzegać procedur laboratoryjnych dotyczących częstotliwości zmian hasła i siły hasła. Oprogramowanie BOND wymaga, aby hasło miało od 4 do 14 znaków i zawierało co najmniej jedną cyfrę.

4. Kliknąć **Log on** (zaloguj się).

System wyświetli ekran klienta klinicznego lub ekran klienta administracyjnego, zależnie od wyboru. Pasek tytułu wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika. W przypadku użytkownika po innym użytkowniku należy wylogować tego użytkownika i zalogować się na własne konto. W przypadku BOND-ADVANCE pasek tytułu wyświetla również obecnie wybraną grupę.




Ponieważ oprogramowanie BOND kontroluje ważne urządzenia i przechowuje dane wrażliwe, nie uruchamiać innych aplikacji na kontrolerze BOND – spowoduje to unieważnienie gwarancji urządzenia. Nie używać kontrolera BOND do ogólnych zastosowań komputerowych.

#### Tła pulpitu

Różne tła pulpitu systemu Windows są używane do rozróżniania typów aktualnie zalogowanych użytkowników systemu Windows oraz roli aktualnie podłączonego kontrolera lub terminala.

#### Konfiguracja jedno stanowiskowa

Zazwyczaj można zobaczyć tło „Kontroler BONDUser”, ale w przypadku obsługi przez serwisanta wyświetlone zostanie tło „Kontroler BONDService”. Zob. [Postać 3-3](#).

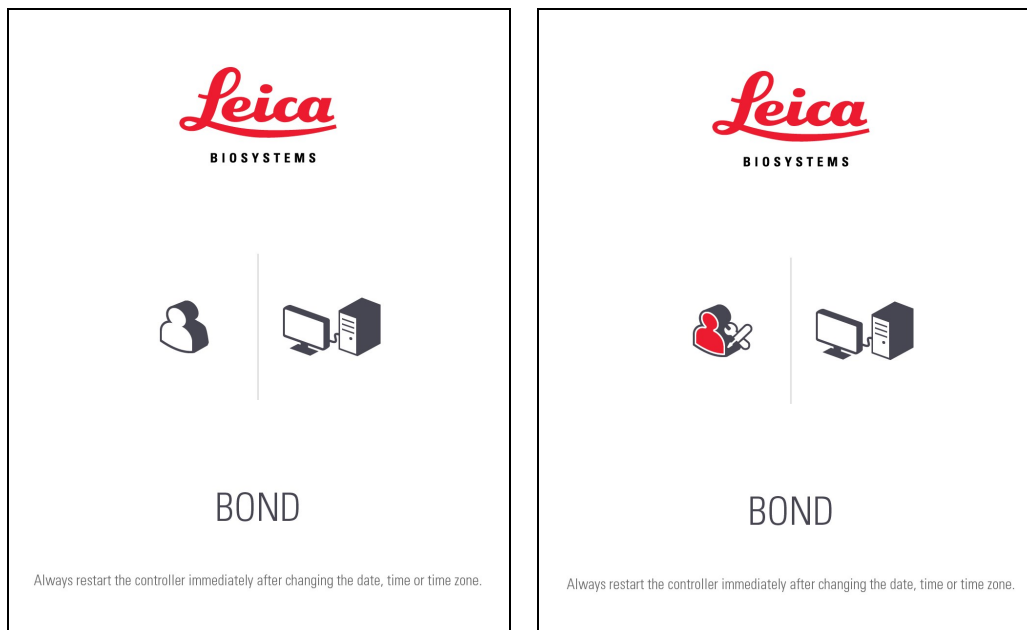

Postać 3-3: Tła pulpitu BOND: „Kontroler BONDUser” i „Kontroler BONDService”

#### BOND-ADVANCE

W tłach pulpitu BOND-ADVANCE ikony podłączonego kontrolera lub terminala zmieniają się zgodnie z wybraną rolą. Zob. przykłady na [Postać 3-4](#).



Postać 3-4: Ikony terminala, samodzielnego kontrolera, głównego sterownika i dodatkowego sterownika

Wyświetlane są również różne ikony reprezentujące typ użytkownika. Zob. [Postać 3-5](#).



Postać 3-5: Ikony BONDUser, BONDService, BONDControl i BONDDashboard

## Wyłączanie

Aby wyłączyć klienta klinicznego lub klienta administracyjnego, należy kliknąć **Log out** (wyloguj się) na pasku funkcji. W przypadku całkowitego wyłączenia systemu BOND oprogramowanie można wyłączyć przed lub po wyłączeniu modułów przetwarzania.



Można wyłączyć klienta klinicznego w trakcie przebiegu, jeżeli konieczna jest zmiana użytkownika. Nie należy pozostawiać działającego modułu przetwarzania bez otwartego klienta, gdyż alarmy i ostrzeżenia nie będą generowane. Nigdy nie wyłączać kontrolera BOND podczas przebiegu.

## 3.3 Rola użytkownika

Istnieją trzy role użytkownika w systemie BOND:

- Operator: może aktualizować stan odczynników, tworzyć przypadki i szkiełka, rozpoczynać i kontrolować przebieg barwienia, tworzyć i edytować lekarzy oraz generować raporty.
- Przełożony: tworzenie i edytowanie protokołów, odczynników i paneli.
- Administrator: ma dostęp do klienta administracyjnego w celu zarządzania użytkownikami BOND i konfigurowania ustawień całego systemu.

Użytkownicy mogą mieć wiele ról. Przełożeni automatycznie otrzymują rolę operatora. Wyłącznie użytkownicy o roli administratora mogą obsługiwać klienta administracyjnego oraz tylko użytkownicy o roli operatora lub przełożonego mogą obsługiwać klienta klinicznego.

Użytkownicy i ich role są konfigurowani w kliencie administracyjnym na ekranie **Users** (użytkownicy) (zob. [10.1 - Users \(użytkownicy\)](#)).



Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika jest wyświetlana na pasku tytułowym okna klienta.


## 3.4 Przegląd interfejsu klienta klinicznego

Na górze i po lewej stronie ekranu klienta klinicznego znajdują się funkcje wspólne dla wszystkich stron oprogramowania. Ten rozdział opisuje te funkcje oraz ogólne funkcje oprogramowania.

- [3.4.1 - Pasek funkcji](#)
- [3.4.2 - Karty modułów przetwarzania](#)
- [3.4.3 - Sortowanie tabel](#)
- [3.4.4 - Format daty](#)







### 3.4.1 Pasek funkcji






Pasek funkcji znajduje się na górze ekranu oprogramowania BOND i zapewnia szybki dostęp do głównych elementów oprogramowania BOND.



Kliknąć ikonę na pasku funkcji, aby przejść do ekranu lub wykonać określoną funkcję zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

### 3. Przegląd oprogramowania (Kontroler BOND )

Ikona	Wyświetlany ekran (lub wykonywana funkcja)	Cel
	Konfiguracja szkiełek	<p>Tworzenie przypadków i ustawienia szkiełek w oprogramowaniu BOND.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">6 - Konfiguracja szkiełek (kontroler BOND)</a>.</p>
	Konfiguracja protokołów	<p>Edytowanie protokołów i zarządzanie nimi.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">7 - Protokoły (kontroler BOND)</a>.</p>
	Konfiguracja odczynników, zapasy odczynników i panele odczynników (3 zakładki)	<p>Konfiguracja nowych odczynników, zarządzanie zapasami odczynników i tworzenie paneli odczynników (zestawy markerów używane do szybszego tworzenia szkiełek).</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">8 - Zarządzanie odczynnikami (kontroler BOND)</a>.</p>
	Historia szkiełek	<p>Wyświetlanie szczegółów szkiełek, które zostały użyte w systemie BOND, przeglądanie szczegółów poszczególnych szkiełek, przebiegów i przypadków.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">9 - Historia szkiełek (kontroler BOND)</a>.</p>
	Wyszukiwanie	<p>Identyfikowanie szkiełek, pojemników na odczynniki i systemów odczynników poprzez skanowanie kodów kreskowych lub ręczne wprowadzanie identyfikatorów szkiełka lub odczynnika. Wspólne okno dialogowe wyszukiwania jest używane, gdy wyszukiwany element (szkiełko lub odczynnik) jest automatycznie identyfikowany przez system.</p> <p>Zob. <a href="#">6.5.6 - Ręczna identyfikacja szkiełka</a> lub <a href="#">8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika</a>, aby uzyskać więcej informacji.</p>
	Pomoc	Otwarcie niniejszej instrukcji obsługi.

Ikona	Wyświetlany ekran (lub wykonywana funkcja)	Cel
	Wyloguj się	Wylogowanie z klienta.
	Kopia zapasowa nie powiodła się	Kopia zapasowa bazy danych nie powiodła się. Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">10.5.3 - Kopie zapasowe bazy danych</a> .
	Moduł LIS nie jest podłączony	Moduł LIS jest zamontowany, ale obecnie nie jest podłączony. Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS</a> .
	Moduł LIS podłączony	Moduł LIS jest zamontowany i podłączony. Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS</a> .
	Powiadomienia LIS	Liczba oczekujących powiadomień LIS. Więcej informacji można znaleźć w części <a href="#">11.4 - Powiadomienia LIS</a> .

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się logo Leica Biosystems. Kliknąć logo, aby wyświetlić okno dialogowe **About BOND** (o systemie BOND). Zob. [3.9 - O systemie BOND](#).

W prawym górnym rogu ekranu można wyświetlić ikony ostrzeżeń i statusu. Zob. [11 - Pakiet integracji LIS \(kontroler BOND\)](#) oraz [10.4.2 - Dziennik audytu](#).

## 3.4.2 Karty modułów przetwarzania

Karty po lewej stronie interfejsu: **System status** (stan systemu), **Protocol status** (status protokołu) oraz **Maintenance** (konserwacja) dla każdego modułu przetwarzania w grupie, do której podłączony jest klient. Na kartach znajdują się informacje o bieżącym statusie poszczególnych modułów przetwarzania (zob. [5.1.1 - Karty modułów przetwarzania](#)).



Postać 3-6: Karta modułu przetwarzania (BOND-MAX)

Ekran **System status** (stan systemu) wyświetla stan poszczególnych modułów przetwarzania, podczas gdy ekran **Protocol status** (status protokołu) pokazuje postęp przebiegu protokołów. Na ekranie **Maintenance** (konserwacja) dostępne są polecenia odpowiadające czynnościom konserwacyjnym.

## 3.4.3 Sortowanie tabel

Wiele ekranów w oprogramowaniu BOND wyświetla dane w tabelach. Kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować według wartości w tej kolumnie. Trójkąt w górę pojawia się obok nagłówka, aby wskazać, że tabela jest sortowana w kolejności rosnącej (0–9, A-Z). Kliknąć ponownie, aby posortować według kolejności malejącej; trójkąt skierowany jest wtedy w dół.

Aby posortować dwie kolumny, kliknąć pierwszą kolumnę, która ma być posortowana, a następnie przytrzymać <Shift> i kliknąć drugą kolumnę. Kolejność wartości w pierwszej kolumnie nie ulegnie zmianie, ale w przypadku wielu wierszy o tej samej wartości w kolumnie pierwszej, wiersze są uporządkowane według wartości w drugiej kolumnie.

Można również zmieniać szerokość kolumn i przeciągnąć kolumny do nowych pozycji w tabeli.


Wszelkie zmiany w sortowaniu tabeli, również szerokości kolumn i pozycji są przechowywane do momentu wylogowania.

## 3.4.4 Format daty

W przypadku instalacji jednostanowiskowej daty i godziny w oprogramowaniu i raportach wykorzystują formaty ustawione w systemie operacyjnym kontrolera BOND. Dla instalacji BOND-ADVANCE używane są formaty ustawione w terminalach. Formaty krótkiej i długiej daty powinny mieć maksymalnie odpowiednio 12 i 28 znaków.

## 3.5 BOND Dashboard

Dla instalacji BOND-ADVANCE panel wyświetlany jest na monitorze podłączonym do kontrolera lub terminala. Zapewnia podsumowanie statusu wszystkich modułów przetwarzania w systemie w czasie rzeczywistym.

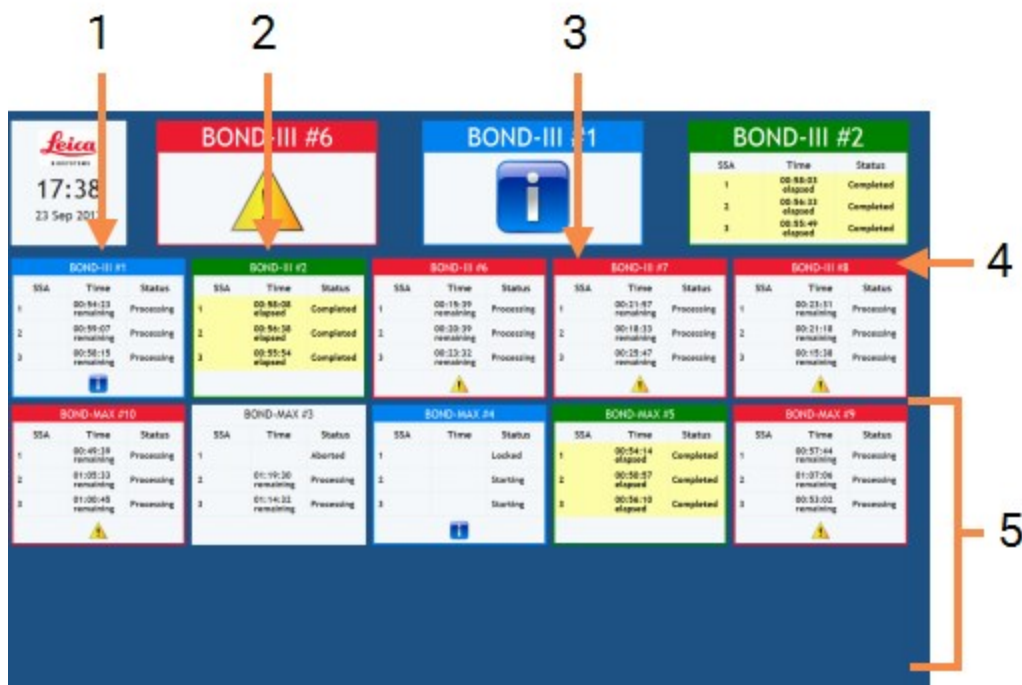




Postać 3-7: BOND Dashboard

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 3-7</a> )
1	Godzina i data
2	Moduły przetwarzania pokazujące ostrzeżenia
3	Moduły przetwarzania pokazujące powiadomienia
4	Moduły przetwarzania z zakończonymi przebiegami
5	Poszczególne okna modułu przetwarzania pokazujące status zespołów barwienia szkielek

W górnej części ekranu po prawej stronie okna daty i godziny znajdują się trzy okienka pokazujące moduły przetwarzania z ostrzeżeniami (po lewej), powiadomieniami (w środku) i zakończonymi przebiegami (po prawej). Jeśli w danej kategorii znajduje się więcej niż jeden moduł przetwarzania, okienka zmieniają się zgodnie z kolejnością.

Pod górnym rzędem znajdują się okienka dla każdego modułu przetwarzania w systemie, uporządkowane alfabetycznie według nazw (określanych w kliencie administracyjnym). Okienka przedstawiają status każdego z trzech zespołów barwienia szkiełek w modułach przetwarzania oraz wszystkich ogólnych wskaźników statusu, które mają zastosowanie do wszystkich modułów:

- Moduły przetwarzania z ostrzeżeniami wyświetlane są z ikoną ostrzeżenia  i mają kolor czerwony.
- Moduły przetwarzania z powiadomieniami wyświetlane są z ikoną powiadomienia  i mają kolor niebieski.
- Moduły przetwarzania z ukończonymi przebiegami mają kolor zielony i wyświetlane są ze statusem „Completed” (zakończono) dla odpowiednich zespołów barwienia szkiełek.
- Odłączone moduły przetwarzania wyświetlane są z ikoną odłączenia .

Moduły przetwarzania z ostrzeżeniami, powiadomieniami lub zakończonymi przebiegami są wyświetlane w odpowiedniej pozycji u góry ekranu, a poszczególne okienka w kolejności alfabetycznej poniżej.

#### 3.5.1 Stan zespołu barwienia szkiełek

Stan każdego zespołu barwienia szkiełek jest wyświetlany w oknach modułów roboczych. Istnieją trzy kategorie stanu:

- **Locked** (zablokowany) – wyświetlany po zablokowaniu tacy na szkiełka. Czas nie jest wyświetlany.
- **Processing** (przetwarzanie) – rozpoczęto przetwarzanie tacy. Kolumna **Time** (czas) pokazuje pozostały czas przebiegu w godzinach, minutach i sekundach.
- **Completed** (ukończone) – przetwarzanie zakończone. Kolumna **Time** (czas) pokazuje czas od zakończenia przebiegu w godzinach, minutach i sekundach.

Jeśli żadna taca nie jest zablokowana, wiersz jest pusty.

Nie ma możliwości interakcji z pulpitem. Jeśli pulpit wyświetla komunikat mówiący, że moduł wymaga uwagi, użytkownik musi użyć terminala BOND.






## 3.6 Powiadomienia, ostrzeżenia i alarmy

System BOND ma trzy poziomy alertów: powiadomienie, ostrzeżenie i alarm. Każdy alert jest oznaczony ikoną, która pojawia się na ekranie **System status** (stan systemu) lub obok elementu, którego dotyczy alert. Odpowiednia ikona alertu może również pojawić się na karcie modułu przetwarzania, wskazując alert niezależnie od wyświetlanego ekranu (zob. [5.1.1 - Karty modułów przetwarzania](#)). W BOND-ADVANCE alerty wyświetlane są również na panelu BOND Dashboard ([3.5 - BOND Dashboard](#)).

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony alertu i wybór **Attention message** (komunikat informacyjny) uruchamia okno dialogowe opisujące alert.

Poniżej opisano trzy poziomy alertów i powiązane z nimi ikony.

	<b>powiadomienie</b>
Stałe	Dostarcza informacji o statusie, który może wymagać podjęcia działań teraz lub później w celu rozpoczęcia przebiegu lub uniknięcia późniejszego opóźnienia przetwarzania.
	<b>Ostrzeżenie</b>
Stałe	Działanie jest wymagane teraz, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu. Opóźnienia w przetwarzaniu mogą negatywnie wpłynąć na barwienie.
	<b>alarm</b>
Migający	Wymagane jest pilne działanie. Jeśli urządzenie było w trakcie przetwarzania szkiełek, przetwarzanie zostało wstrzymane i nie można go wznowić do momentu usunięcia stanu alarmowego. Opóźnienia w przetwarzaniu mogą negatywnie wpłynąć na barwienie.



Należy zawsze czytać komunikaty ostrzeżeń i alarmów zaraz po wyświetleniu ikony (zwłaszcza w trakcie przebiegu). Szybka reakcja może pomóc uniknąć negatywnego wpływu na barwienie szkiełek.

Zaleca się również bezzwłoczne działanie w przypadku powiadomień, które wyświetlane są w trakcie przebiegu.

## 3.7 Raporty

Oprogramowanie BOND generuje wiele raportów. Są one otwierane w „BOND Report Viewer” (przeglądarka raportów) w nowym oknie. Informacje ogólne, takie jak czas, miejsce i urządzenie, do którego odnosi się raport, znajdują się w nagłówkach raportu. Stopki stron raportu wskazują godzinę i datę wygenerowania raportu oraz numery stron.



Niektóre raporty, zwłaszcza te zawierające informacje o przypadkach, szkiełkach lub odczynnikach, mogą być generowane przez kilka minut, zwłaszcza w laboratoriach z wieloma modułami przetwarzania i/lub dużym obrocie.

Przeglądarka BOND oferuje niewielki zakres opcji nawigacji, wyświetlania i udostępniania. Oprócz otwierania standardowego okna dialogowego drukowania w celu wyboru i konfiguracji drukarki lub wyboru stron do drukowania, można również eksportować raporty w różnych formatach, w tym PDF, XLS, CSV i plik tekstowy.

Można użyć różnych skrótów klawiaturowych do nawigacji, np. **Page Up**, **Page Down**, **Home** (pierwsza strona) i **End** (ostatnia strona). Inne funkcje są również dostępne za pomocą skrótów klawiaturowych, na przykład **Ctrl-F** wyświetla okno wyszukiwania, **Ctrl-S** otwiera okno zapisywania, a **Ctrl-P** otwiera okno drukowania.

Raporty BOND są dokumentowane w następujących częściach:

- [5.3.1 - Raport dot. konserwacji](#)
- [6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkiełka](#)
- [7.5 - Raporty dot. protokołów](#)
- [8.3.4 - Raport dot. szczegółów rejestru](#)
- [8.3.5 - Raport dot. użycia odczynnika](#)
- [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)
- [9.5 - Raport dot. szczegółów przebiegu](#)
- [9.6 - Raport dla przypadku](#)
- [9.8 - Podsumowanie szkiełek](#)
- [9.10 - Krótka historia szkiełek](#)

Możliwy jest również eksport informacji o szkiełkach w formacie CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Zob. [9.9 - Eksport danych](#).

#### 3.7.1 Starsze raporty

Jeśli system BOND został uaktualniony z wersji oprogramowania 4.0, dane przypadku i szkiełka sprzed aktualizacji nie zostaną przeniesione do bieżącej bazy danych. Nadal dostępne są poprzednie dane (tzw. „stare” dane). Aby uzyskać do nich dostęp, otworzyć **Start > All programs > Leica > BOND Legacy Report Viewer** (start > wszystkie programy > Leica > przeglądarka starszych raportów). Otwierana jest wersja 4.0 oprogramowania BOND. Wyświetlanie przetworzonych szkiełek na ekranie **Slide history** (historia szkiełek) i tworzenie raportów w taki sam sposób, jak w wersji 4.0.. Podobnie jak w wersji 4.0, można drukować raporty z okna raportu lub zapisać je w formacie PDF. W tym celu należy wybrać **File > Print** (plik > drukuj) a następnie **Leica PDF Printer** (drukarka PDF Leica) jako drukarkę.



Nie tworzyć przypadków ani szkiełek w przeglądarce Legacy Report Viewer BOND. Używać jej tylko do przeglądania starych danych i tworzenia raportów.


## 3.8 Pomoc

Ikona **Help** (pomoc) na pasku funkcji, zarówno w przypadku klientów klinicznych, jak i administracyjnych, otwiera niniejszą instrukcję obsługi.



## 3.9 O systemie BOND

Kliknąć logo Leica Biosystems w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić okno dialogowe **About BOND** (o systemie BOND) z informacjami o systemie.

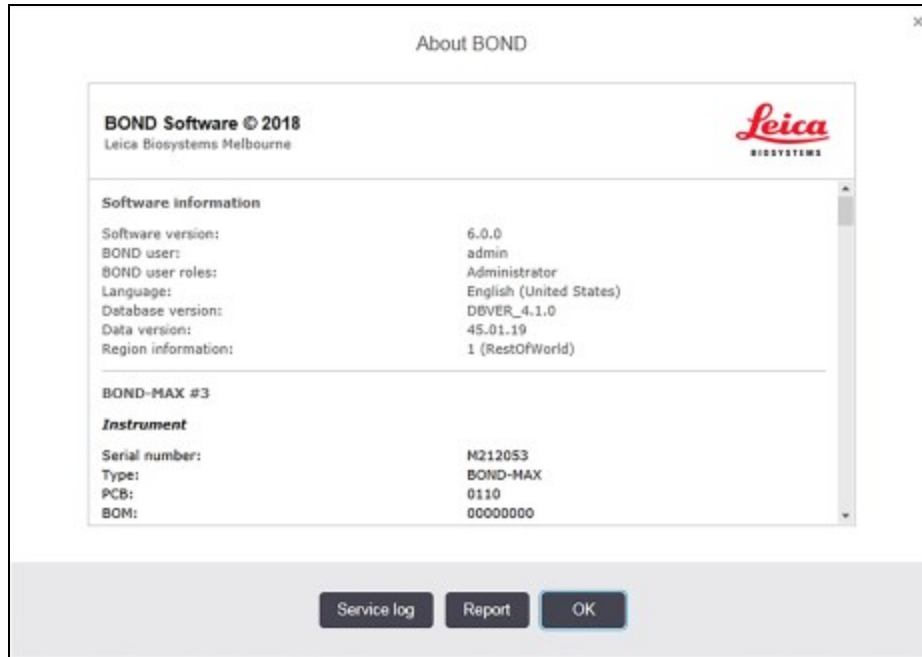

Postać 3-8: Okno dialogowe O systemie BOND

Większość informacji w oknie **About BOND** (o systemie BOND) jest przeznaczona dla personelu serwisowego, jednak personel laboratorium może skorzystać z pierwszej części, szczególnie podczas rozmowy z działem obsługi klienta.

Informacje zawarte w pierwszej części:

- Wersja oprogramowania: numer wersji oprogramowania.
- Użytkownik BOND: nazwa bieżącego użytkownika.
- Rola użytkownika BOND: nazwa bieżącej roli użytkownika.
- Język: bieżący język.
- Wersja bazy danych: wersja bazy danych (dotyczy struktury bazy danych).
- Wersja danych: wersja danych wczytanych do bazy danych.
- Informacje o regionie: region wybrany w systemie (ustawiany podczas instalacji).

Informacje z okna dialogowego można zapisać w pliku tekstowym – kliknąć **Report** (raport) i wybrać lokalizację, aby zapisać plik.

#### Dziennik serwisowy

W kliencie administracyjnym można wygenerować raporty dziennika serwisowego w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND). Zazwyczaj wykonywane jest to na żądanie serwisanta. Aby utworzyć dziennik serwisowy:

1. Kliknąć **Service log** (dziennik serwisowy) w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND).
2. Wybrać moduł przetwarzania, **\*System\*** (system) w celu utworzenia raportu zdarzeń związanych z oprogramowaniem lub kontrolerem w systemie BOND lub **\*LIS\*** (LIS) dla zdarzeń związanych z systemem LIS.
3. Wybrać przedział czasowy raportu lub kliknąć **Last seven days** (ostatnie siedem dni).
4. Kliknąć **Generate** (generuj), aby wygenerować raport.
5. Raport pojawi się w przeglądarce raportów – zob. [3.7 - Raporty](#).

## 3.10 Definicje danych BOND

Kontroler BOND przechowuje definicje danych, które zawierają wszystkie szczegóły odczynnika i protokołu dla całego systemu. Przechowywane są tam również domyślne protokoły oraz szczegóły odczynników i systemów odczynników Leica Biosystems.

### 3.10.1 Aktualizacje definicji danych

Leica Biosystems okresowo publikuje aktualizacje definicji danych na stronie internetowej, np. w celu dodania nowo wprowadzonych odczynników. Zob. [10.4 - BDD](#) w celu aktualizacji definicji danych.



Podczas aktualizacji definicji danych należy korzystać wyłącznie z plików aktualizacji w formacie **.bdd**.

Aktualna wersja danych wyświetlana jest w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND). Aby wyświetlić te okno dialogowe, należy kliknąć logo Leica Biosystems w prawym górnym rogu ekranu oprogramowania BOND. Zob. również [3.9 - O systemie BOND](#) (o systemie BOND).

## 3.11 Aktualizacje oprogramowania

Leica Biosystems może udostępniać aktualizacje oprogramowania, ponieważ system BOND jest stale rozwijany. Aktualizacje mogą dotyczyć oprogramowania głównego lub bazy danych zawierającej protokoły domyślne, odczynniki i systemy odczynników.

Numer aktualnej wersji oprogramowania można znaleźć w części **About BOND** (o systemie BOND) (zob. [3.9 - O systemie BOND](#)). Wersja danych jest również wyświetlana w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND).

# 4. Szybkie uruchamianie

Ten rozdział ma na celu opisanie pierwszego przebiegu przy użyciu systemu BOND. Utworzony zostanie przykładowy przypadek, skonfigurowane i przetworzone zostaną cztery szkiełka oraz wykonane zostaną testy gotowych do użycia przeciwciał BOND \*CD5, \*CD3, \*CD10 i \*Bcl-6. W przypadku tych przeciwciał stosowane są domyślny protokół i system wykrywania: \*Protokół IHC F i BOND Polymer Refine. Opisane procedury dotyczą również sond i protokołów ISH (wystarczy zamienić przeciwciało na sondę i protokół IHC na ISH).

## 4.1 BOND-III oraz BOND-MAX

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z odpowiednimi częściami rozdziałów [2 - Urządzenie](#) oraz [3 - Przegląd oprogramowania \(Kontroler BOND\)](#) w niniejszej instrukcji.

- [4.1.1 - Kontrole wstępne i uruchomienie](#)
- [4.1.2 - Kontrole protokołu i odczynników](#)
- [4.1.3 - Konfigurowanie szkiełek](#)
- [4.1.4 - Ładowanie odczynników](#)
- [4.1.5 - Uruchamianie protokołu](#)
- [4.1.6 - Kończenie przebiegu](#)

### 4.1.1 Kontrole wstępne i uruchomienie

Przed rozpoczęciem przebiegu należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest czysty i że wszystkie zadania konserwacyjne zostały wykonane (zob. [12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwacji](#)).

Codzienne zadania przed uruchomieniem to:

- i. Sprawdzić, czy zbiorcze pojemniki na odpady są maksymalnie w połowie pełne; w bieżącym modelu BOND-MAX, należy użyć białej poziomej linii na etykiecie pojemnika jako wskaźnika połowy poziomu – zob. [Postać 12-3](#).
  - ii. Sprawdzenie, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki są przynajmniej w połowie pełne oraz czy zawierają odpowiedni odczynnik.
2. Sprawdzić bloki myjące i stację mieszania – w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić.
  3. Upewnienie się, że drukarka etykiet do szkiełek ma odpowiedni zapas etykiet.
  4. Jeśli moduł przetwarzania i kontroler (oraz terminal w przypadku BOND-ADVANCE) nie są włączone, należy je włączyć.
  5. Gdy kontroler lub terminal jest uruchomiony, należy uruchomić klienta klinicznego.
  6. Po uruchomieniu oprogramowania należy sprawdzić ekrany **Status** (status), aby upewnić się, że nie ma powiadomień z modułu przetwarzania. Przed próbą wykonania przebiegu szkiełek należy usunąć powiadomienia.
  7. Włączyć drukarkę etykiet do szkiełek.

## 4.1.2 Kontrole protokołu i odczynników

Należy sprawdzić, czy protokoły i odczynniki, które mają być wykorzystywane w przebiegu, są skonfigurowane w oprogramowaniu.

Aby sprawdzić protokoły:

1. Wybrać opcję **Protocol setup** (konfiguracja protokołu) (po prawej stronie) na pasku funkcji.
2. Sprawdzić, czy w tabeli znajduje się „\*IHC Protocol F”.




Jeżeli protokół nie znajduje się na liście, należy wybrać opcję **All** (wszystkie) w filtrze **Preferred status** (preferowany status) u dołu ekranu (zob. [7.2 - Ekran konfiguracji protokołów](#))

3. Wybrać protokół z tabeli, kliknąć **Open** (otwórz) i zanotować preferowany system detekcji w oknie dialogowym **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu); **BOND Polymer Refine Detection**.

Upewnić się, że protokół został wybrany jako **Preferred** (preferowany) w górnej części okna dialogowego (jeśli protokół nie jest ustawiony jako preferowany, zmienić to może użytkownik zalogowany jako przełożony).

Aby sprawdzić odczynniki:

Ta kontrola zakłada posiadanie zapasu wymaganych przeciwciał i systemu detekcji, oraz że zostały one zarejestrowane w rejestrze odczynników BOND. Zob. [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#).



1. Wybrać opcję **Reagent setup** (konfiguracja odczynników) (po prawej stronie) na pasku funkcji.
2. Na karcie **Setup** (konfiguracja) wybrać **Primaries** (pierwszorzędowe) dla opcji **Reagent type** (typ odczynników), **Leica Microsystems** dla opcji **Supplier** (dostawca) oraz **All** (wszystkie) dla opcji **Preferred status** (preferowany status) w filtrach u dołu ekranu.
3. Zlokalizować wszystkie potrzebne przeciwciała (\*CD5, \*CD3, \*CD10 i \*Bcl-6) i kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe **Edit reagent properties** (edytuj właściwości odczynnika):
  - i. Kliknąć **Restore factory default protocols** (przywróć domyślne protokoły) (aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy zalogować się jako przełożony). Dzięki temu ustawiany jest domyślny protokół barwienia \*protokół IHC F i domyślne protokoły obróbki wstępnej.
  - ii. Upewnić się, że odczynnik jest sprawdzany jako **Preferred** (preferowany) (należy zalogować się w roli przełożonego, aby ustawić odczynnik jako preferowany).
  - iii. Kliknąć **Save** (zapisz).

4. Następnie przejść do karty **Inventory** (rejestr) i wybrać **Reagent containers** (pojemniki na odczynniki) dla opcji **Package type** (typ pakietu), **Primaries** (pierwszorzędowe) dla opcji **Reagent type** (typ odczynnika), **In stock** (w rejestrze) dla opcji **Inventory status** (status rejestru), **Leica Microsystems** dla opcji **Supplier** (dostawca) oraz **Preferred** (preferowany) dla opcji **Preferred status** (preferowany status) w filtrach u dołu ekranu.

Wszystkie potrzebne przeciwciała powinny pojawić się wraz z dostępnymi objętościami.

Upewnić się, że dla każdego przeciwciała dostępna jest wystarczająca objętość.

5. Na tej samej karcie wybrać **BOND detection systems** (systemy detekcji BOND) jako **Package type** (typ pakietu) oraz **In stock** (w rejestrze) dla **Inventory status** (status rejestru). Sprawdź,

czy preferowany system detekcji, **BOND Polymer Refine Detection** znajduje się w tabeli i że dostępna jest wystarczająca objętość (zob. [8.3.1.1 - Raportowanie objętości w przypadku systemów detekcji](#)).

### 4.1.3 Konfigurowanie szkiełek

W tej części opisano procesy wprowadzania do systemu BOND szczegółów koniecznych do barwienia szkiełek oraz fizycznego umieszczenia szkiełek w module przetwarzania.



Działania oprogramowania opisane w tej części są wykonywane na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Aby wyświetlić ten ekran, należy kliknąć ikonę **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) na pasku funkcji.

Zob. części:

- [4.1.3.1 - Wprowadzanie szczegółów przypadku](#)
- [4.1.3.2 - Wprowadzanie szczegółów szkiełka](#)
- [4.1.3.3 - Próbki kontrolne](#)
- [4.1.3.4 - Etykietowanie szkiełek](#)
- [4.1.3.5 - Ładowanie szkiełek](#)

#### 4.1.3.1 Wprowadzanie szczegółów przypadku

Najpierw należy w oprogramowaniu utworzyć „przypadek” dla próbki pacjenta. Dla przykładu imię i nazwisko pacjenta to A. Edward, identyfikator przypadku 3688, a lekarz prowadzący to dr Smith.

1. Kliknąć **Add case** (dodaj przypadek) na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Add case** (dodaj przypadek).

Figure 4-1: Okno dialogowe **Add case** (dodaj przypadek)

2. Kliknąć **Case ID** (ID przypadku) i wpisać „3688”.
3. Kliknąć **Patient name** (imię i nazwisko pacjenta) i wpisać „Edward, A”.
4. Kliknąć **Manage doctors** (zarządzanie lekarzami), aby otworzyć okno dialogowe **Manage doctors** (zarządzanie lekarzami). Następnie kliknąć **Add** (dodaj), aby otworzyć okno dialogowe **Add doctor** (dodaj lekarza) i wpisać „Smith” w polu **Name** (imię i nazwisko). Upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru **Preferred** (preferowany). Kliknąć **Save** (zapisz).
5. Wybrać „Smith” i kliknąć **OK** w oknie dialogowym **Manage doctors** (zarządzanie lekarzami).
6. Wybrać dawkę 150 µl jako domyślną. Ustawienie to może zostać zastąpione podczas konfiguracji szkiełka, jeśli to konieczne.



- Wybrać \*Dewax (odparafinowanie) lub \*Bake and Dewax (podgrzewanie i odparafinowanie) w polu **Preparation protocol** (protokół przygotowania) w celu ustawienia domyślnego sposobu przygotowywania szkiełek w przypadku. Ustawienie to może zostać zastąpione podczas konfiguracji szkiełka, jeśli to konieczne.
- Kliknąć **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Add case** (dodaj przypadek) – w tabeli po lewej stronie ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) wyświetlany jest nowy przypadek.

Więcej informacji na temat pracy z przypadkami można znaleźć w części [6.3 - Praca z przypadkami](#).

#### 4.1.3.2 Wprowadzanie szczegółów szkiełka

W następnym etapie należy w oprogramowaniu utworzyć „szkiełka” dla każdego z czterech fizycznych szkiełek:

- Wybrać ID nowego przypadku 3688 z listy przypadków po lewej stronie ekranu.
- Kliknąć **Add slide** (dodaj szkiełko), aby wyświetlić okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko).

Figure 4-2: Okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko)

- Opcjonalnie dodać komentarz dotyczący tego szkiełka.
- Upewnić się, że wybrano **Test tissue** (tkanka testowa) jako typ tkanki.
- Wybrać objętość dozowania odpowiednią dla modułu przetwarzania i rozmiaru tkanki (zob. [6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach](#)).  
Zakładamy, że szkiełka będą przetwarzane w urządzeniu BOND, dlatego należy ustawić objętość dozowania na 150 µl.
- Wybrać opcje **Single** (pojedynczy) oraz **Routine** (rutynowy) w menu **Staining mode** (tryb barwienia).
- Kliknąć **IHC**, aby określić proces IHC.
- Wybrać \*CD5 (4C7) z listy **Marker** (marker).

Na karcie **Protocols** (protokoły) oprogramowanie automatycznie wprowadza zestaw protokołów przygotowywania dla przypadku oraz domyślne protokoły barwienia i odsłaniania dla \*CD5.

9. Kliknąć przycisk **Add slide** (dodaj szkiełko).  
Szkiełko zostanie dodane do listy szkiełek po prawej stronie ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko) pozostaje otwarte.
10. Powtórzyć kroki [8](#) – [9](#) trzy razy i wybrać \*CD3 (LN10), \*CD10 (56C6) i \*Bcl-6 (LN22) jako markery w kroku [8](#).
11. Po dodaniu wszystkich szkiełek kliknąć **Close** (zamknij), aby zamknąć okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko).
12. Szczegóły można przejrzeć na liście szkiełek.

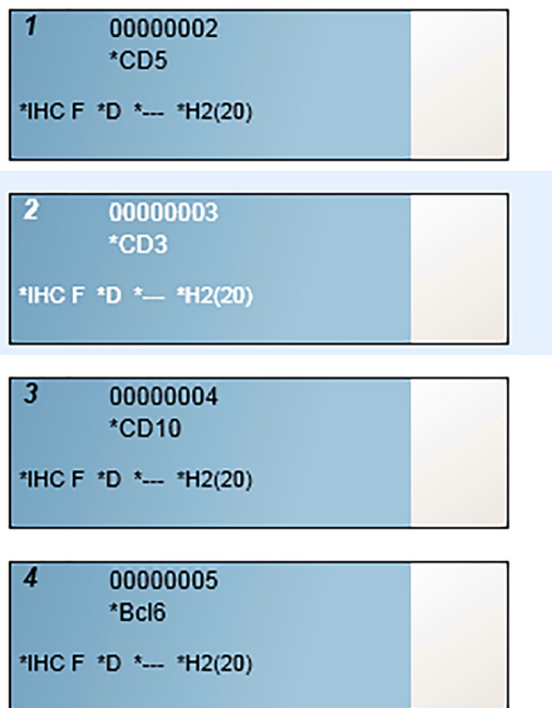




Figure 4-3: Cztery szkiełka skonfigurowane na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek)

Aby zmienić szczegóły szkiełka, należy kliknąć dwukrotnie szkiełko, aby utworzyć okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka), zmienić szczegóły, a następnie kliknąć przycisk **OK**.

Więcej informacji na temat pracy ze szkiełkami można znaleźć w części [6.5 - Praca ze szkiełkami](#).

-  Można użyć **paneli**, aby szybko dodać kilka często używanych szkiełek. Opis paneli i sposobu ich tworzenia i wykorzystywania znajduje się w części [8.4 - Ekran paneli odczynników](#).

#### 4.1.3.3 Próbki kontrolne

-  Zawsze używać próbek kontrolnych w systemie BOND. Zalecamy umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tych samych szkiełkach, na których umieszczona jest tkanka pacjenta. Dodatkowo można utworzyć oddzielne badanie specjalnie dla szkiełek kontrolnych. Więcej informacji w części [6.2 - Praca z próbkami kontrolnymi](#).

#### 4.1.3.4 Etykietowanie szkiełek

Można teraz wydrukować etykiety do szkiełek i nakleić je na szkiełka:

1. Kliknąć **Print labels** (drukuj etykiety) na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek).
2. Kliknąć **All slide labels not yet printed** (wszystkie niewydrukowane etykiety szkiełek), a następnie **Print** (drukuj).  
Etykiety są drukowane.
3. Upewnić się, że matowa powierzchnia szkiełka, gdzie naklejana będzie etykieta, jest sucha, a następnie nakleić etykietę z ID lub kodem kreskowym szkiełka ustawionym równolegle względem krawędzi szkiełka. Etykieta powinna znajdować się po właściwej stronie szkiełka, kiedy szkiełko jest przytrzymywane, tak aby etykieta była u góry.



Figure 4-4: Prawidłowo naklejona etykieta

Więcej informacji można znaleźć w części [6.6 - Etykietowanie szkiełek](#).

#### 4.1.3.5 Ładowanie szkiełek

Szkiełka załadować w następujący sposób:

1. Trzymać szkiełko za koniec etykiety z próbką na górze.
2. Ustawić szkiełko w pustej pozycji na tacy na szkiełka, tak aby koniec szkiełka znajdował na wgłębieniu tacy (zob. [Figure 4-5](#)). Umieścić szkiełko tak, aby znalazło się w zagłębieniu na tacy.

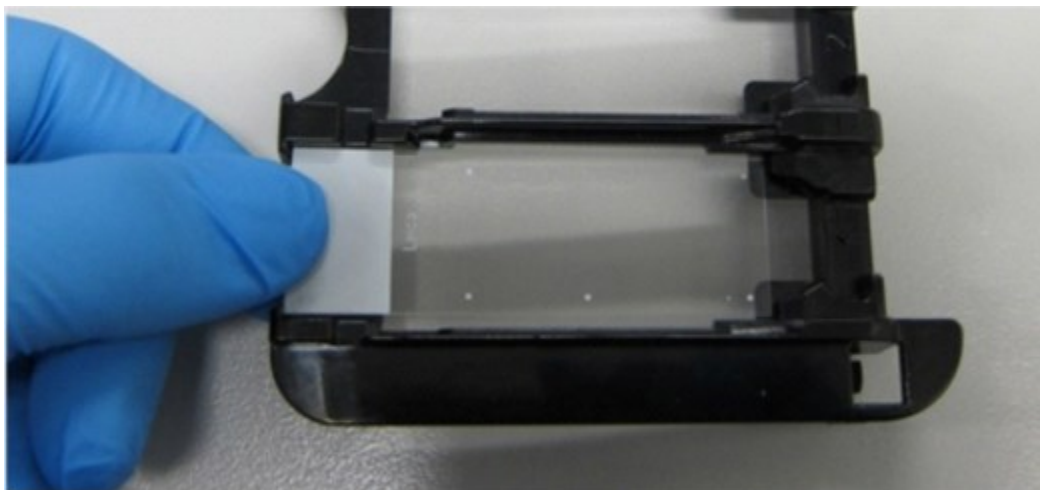


Figure 4-5: Ustawianie szkiełka na tacy na szkiełka

#### 4. Szybkie uruchamianie

---

3. Przytrzymać szkiełko nakrywkowe Covertile za koniec i umieścić je na szkiełku, dopasowując szyjkę Covertile do zagłębienia na tacy na szkiełku (zaznaczone na [Figure 4-6](#)). Dzięki nowej konstrukcji szkiełek nakrywkowych Covertile słowo „Leica” nadrukowane na szkiełku powinno być czytelne, co potwierdza, że szkiełko nakrywkowe Covertile jest ułożone prawidłowo.



Figure 4-6: Ustawianie szkiełek nakrywkowych Covertile na szkiełku

4. Po załadowaniu wszystkich szkiełek i szkiełek nakrywkowych Covertile na tacę, należy unieść tacę i ustawić koniec na początku zespołu barwienia szkiełek. Wsunąć tacę do samego końca modułu. Taca powinna łatwo się wsunąć i kliknąć, gdy znajdzie się na właściwym miejscu.

### 4.1.4 Ładowanie odczynników

System detekcji (BOND Polymer Refine) i pojemniki na markery (dla \*CD5, \*CD3, \*CD10 i \*Bcl-6) należy umieścić w module przetwarzania.



Pojemniki na odczynniki mogą przewrócić się podczas transportu, pozostawiając resztki odczynnika wokół pokrywy. Podczas otwierania pojemników na odczynniki należy zawsze nosić zatwierdzone środki ochrony oczu, rękawice i odzież ochronną.

Aby załadować odczynniki do modułu przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX, należy wykonać następujące czynności:

1. Umieścić pojemniki na markery w tacach na odczynniki, wyrównując rowki na pojemnikach z wgłębieniami w komorze tacy. Dociskać pojemniki w dół do usłyszenia kliknięcia. W razie potrzeby pojemniki na markery można umieścić w zapasowych komorach tacy systemu detekcji.


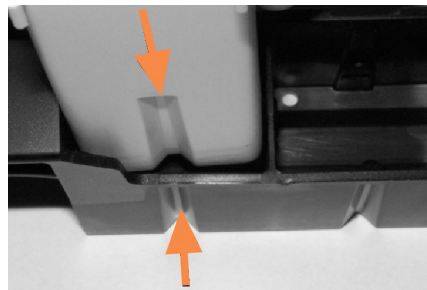


Figure 4-7: Pojemnik na odczynniki na tacy na odczynniki  
(Strzałki wskazują rowki w pojemniku na odczynniki i na tacy na odczynniki)

2. Otworzyć wszystkie pojemniki na markery i pojemniki systemu detekcji. Otworzyć pokrywy i cofnąć je tak, aby zablokowały się z tyłu pojemników.
3. Upewnić się, że etykiety z kodami kreskowymi są dokładnie przyklejone do pojemników – docisnąć wszystkie unoszące się etykiety.

4. Załadować tace na odczynniki do platformy odczynników modułu przetwarzania. Użyć prowadnic platformy, aby prawidłowo wsunąć tace.  
Gdy taca dotrze do końca platformy, powinna zostać zablokowana. Dioda LED tacy zmieni kolor na zielony, wskazując na prawidłowe położenie tacy.

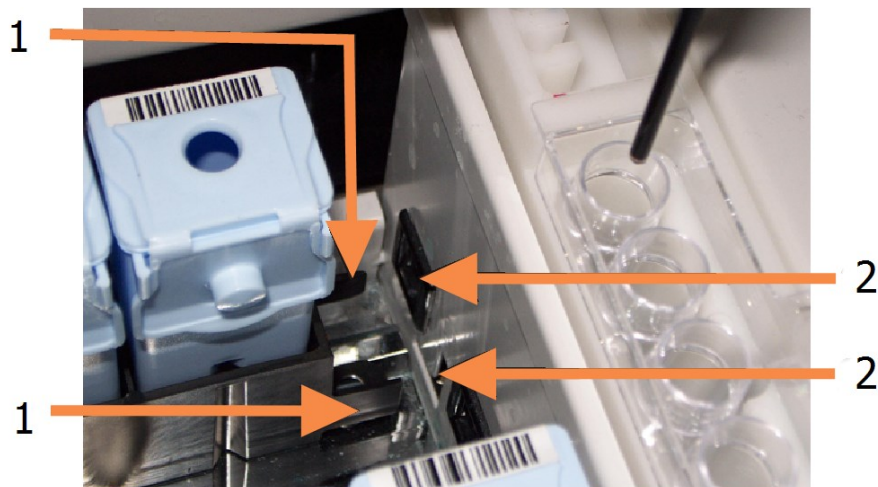

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 4-8</a> )
1	Mechanizm blokujący tacy
2	Port blokujący modułu przetwarzania

Postać 4-8: Wkładanie tacy na odczynniki

5. W oprogramowaniu kliknąć kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).

Kolumna odczynnika jest wyświetlana w jaśniejszym kolorze z ciemną obwódką, co wskazuje, że taca będzie obrazowana. System BOND odczytuje identyfikatory na odczynnikach zaraz po udostępnieniu głównego robota, a następnie aktualizuje ikony odczynników.

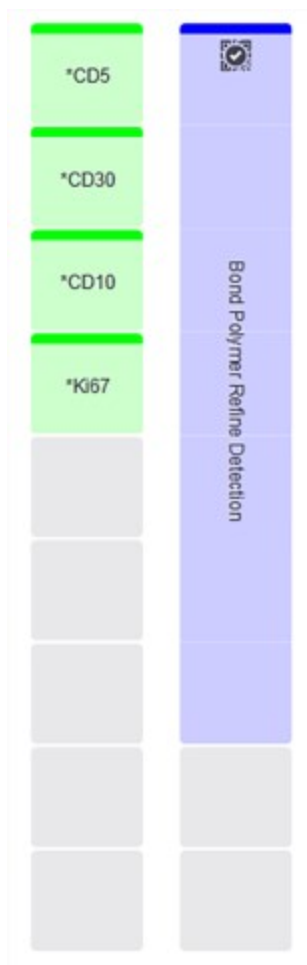


Figure 4-9: Status tacy na odczynniki przedstawiony na ekranie stanu systemu


W przypadku jakichkolwiek problemów z odczynnikami oprogramowanie wyświetla ikonę ostrzeżenia na tym ekranie. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę, aby uzyskać więcej informacji (zob. [5.1.3.4 - Rozwiązywanie problemów z odczynnikami](#)).


**i** Należy zauważyć, że tace na odczynniki można wyjąć w dowolnym momencie, gdy dioda LED tacy świeci na zielono. Jeśli odczynnik na tacy będzie wymagany w ciągu 2 minut, dioda LED zmieni kolor na czerwony, wskazując że taca jest zablokowana (zob. [2.2.6.5 - Platforma odczynników](#)).

## 4.1.5 Uruchamianie protokołu


Po skonfigurowaniu i załadowaniu szkiełek i odczynników do modułu przetwarzania można rozpocząć przetwarzanie.

1. Upewnić się, że pokrywa modułu przetwarzania jest zamknięta.
2. Nacisnąć przycisk Load/Unload (załaduj/wyładuj) na osłonie przedniej pod załadowaną tacą na szkiełka.  
BOND-III lub BOND-MAX blokuje tacę, a dioda LED tacy na szkiełka powinna zmienić kolor na pomarańczowy.

 Zwrócić uwagę na dźwięk blokady tacy na szkiełka – jeśli występują jakiegokolwiek głośne pęknięcia lub kliknięcia, prawdopodobnie szkiełka nakrywkowe Covertile są ułożone nieprawidłowo. W takim przypadku należy odblokować tacę, wyjąć i sprawdzić szkiełka oraz szkiełka nakrywkowe Covertile.

3. Gdy tylko główny robot jest dostępny, system BOND obrazuje szkiełka.  
Jeśli którykolwiek z wymaganych odczynników nie jest dostępny, oprogramowanie wyświetla ikonę ostrzeżenia pod listą szkiełek. Kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać więcej informacji.
4. Jeśli brak nierozpoznanych lub niekompatybilnych szkiełek, są one gotowe do rozpoczęcia przebiegu barwienia. Pasek postępu będzie znajdował się w fazie początkowej (zob. [5.1.6.2 - Postęp przebiegu](#)) a status przebiegu zmieni się na **Slides ready** (szkiełka gotowe) (zob. [5.1.6.1 - Status przebiegu](#)).  
Kliknąć , aby uruchomić protokół (można też wybrać uruchomienie urządzenia później; patrz [5.1.8 - Opóźnione uruchomienie](#)).

System zaplanuje przebieg, pasek postępu zmieni się na fazę przetwarzania, a status przebiegu zmieni się na **Proc (OK)** (przetw. (OK)).

 Uruchamiać należy tylko jeden przebieg naraz, a następnie odczekać 1–2 minuty przed rozpoczęciem kolejnego przebiegu. Odczekać chwilę po rozpoczęciu każdego przebiegu, aby upewnić się, że został on pomyślnie uruchomiony. Jeśli nie, status przebiegu zostanie zmieniony na **Rejected/Slides ready** (odrzucone/szkiełka gotowe). Zob. [5.1.6.1 - Status przebiegu](#).

Podczas przetwarzania przebiegu przycisk Load/Unload (załaduj/wyładuj) dla zespołu barwienia szkiełek nie zwalnia tacy na szkiełka.

Kliknąć  pod tacą na ekranie **System status** (status systemu), aby anulować przebieg (zob. [5.1.7 - Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu](#)).



## 4.1.6 Kończenie przebiegu


Po zakończeniu przebiegu przetwarzania ikona modułu przetwarzania miga (zob. [5.1.1 - Karty modułów przetwarzania](#)). Jeśli podczas przebiegu wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia, tekst wyświetlany jest na czerwono, a symbol powiadomienia wyświetlany jest pod tacą i na szkiełkach. W takim przypadku należy sprawdzić ekran **System status** (stan systemu), aby wyświetlić ikony ostrzeżeń i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić ich szczegóły. Należy również sprawdzić raport dot. zdarzeń podczas przebiegu (zob. [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)), aby zobaczyć inne informacje dotyczące problemów podczas przebiegu.

Po zakończeniu przebiegu:


1. Wyjąć tace na odczynniki.

Szczelnie zamknąć pokrywy pojemników na odczynniki, aby zapobiec wyparowaniu odczynników i przechowywać odczynniki natychmiast po użyciu zgodnie z zaleceniami na etykiecie lub karcie charakterystyki odczynnika.

2. Nacisnąć przycisk Load/Unload (załaduj/wyładuj) i wyjąć tace z modułu przetwarzania.

 Nasłuchiwać dźwięku pęknięć lub kliknięć podczas wyładowywania tacy. W takim przypadku należy sprawdzić zespół barwienia szkiełek i pobliskie elementy pod kątem uszkodzonych szkiełek. W mało prawdopodobnym przypadku zgniecenia nieprawidłowo wyrównanego szkiełka należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

3. Umieścić tacę na szkiełku na płaskiej, stabilnej powierzchni. Zdjąć szkiełko nakrywkowe Covertile, przytrzymując etykietę szkiełka, a następnie ostrożnie naciskając na szyjkę szkiełka Covertile, aby zdjąć koniec szkiełka nakrywkowego Covertile ze szkiełka.

 Nie przesuwaj szkiełka nakrywkowego Covertile po powierzchni szkiełka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanki, co utrudnia odczyt szkiełka.

4. Podnieść szkiełko nakrywkowe Covertile ze szkiełek i wyczyścić je zgodnie z opisem w części [12.3 - Szkiełka nakrywkowe Covertile](#).
5. Wyjąć szkiełka i wykonać następny krok procesu przetwarzania zgodnie z procedurami laboratorium.

Można wybrać ponownie wszystkie szkiełka (zob. [9.3 - Właściwości szkiełka i ponowny przebieg](#)).

Na tym kończy się pierwszy przebieg systemu BOND.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

W kliencie klinicznym do każdego modułu przetwarzania przypisane są dwa ekrany statusu oraz jeden ekran konserwacji, otwierane z poziomu kart w lewym górnym rogu okna dostępnych po wybraniu modułu przetwarzania z kart po lewej stronie. Ekran **System status** (stan systemu) umożliwia sterowanie systemem z poziomu okna przedstawiającego rozmieszczenie szkiełek i odczynników w module. Ekran **Protocol status** (status protokołu) zawiera informacje na temat postępu protokołu dla poszczególnych szkiełek. Na ekranie **Maintenance** (konserwacja) dostępne są polecenia odpowiadające czynnościom konserwacyjnym.

- [5.1 - Ekran stanu systemu](#)
- [5.2 - Ekran statusu protokołu](#)
- [5.3 - Ekran konserwacji](#)

## 5.1 Ekran stanu systemu

Ekran ten umożliwia kontrolowanie przetwarzania i wyświetla szczegóły załadowanych tac na szkiełka i odczynników, jak również wskazuje status odczynników, odpadów i blokad w systemie.



Postać 5-1: Ekran **System status** (stan systemu) urządzenia BOND-III

Karty modułów przetwarzania dostępne po lewej stronie ekranów statusu zawierają wizualne podsumowanie statusów powiązanych modułów przetwarzania. Kliknąć daną kartę, aby wyświetlić szczegóły statusu wybranego modułu przetwarzania.

Więcej informacji można znaleźć w częściach:

- [5.1.1 - Karty modułów przetwarzania](#)
- [5.1.2 - Status urządzenia](#)
- [5.1.3 - Status odczynników](#)
- [5.1.4 - Informacje o szkiełkach](#)
- [5.1.5 - Identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#)
- [5.1.6 - Wskaźnik postępu przebiegu](#)
- [5.1.7 - Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu](#)
- [5.1.8 - Opóźnione uruchomienie](#)

## 5.1.1 Karty modułów przetwarzania

Oprogramowanie wyświetla po lewej stronie ekranu osobną kartę dla każdego modułu przetwarzania w systemie (model samodzielny) lub w grupie, do której podłączony jest klient (BOND-ADVANCE). Jeśli ilość miejsca nie jest wystarczająca, aby wyświetlić wszystkie moduły przetwarzania, pojawiają się przyciski strzałek umożliwiające przewijanie w górę i w dół (po prawej pokazano strzałkę w górę).



Postać 5-2: Karta modułu przetwarzania (BOND-III)

Każda karta zawiera nazwę modułu przetwarzania i prostokątne ikony wskazujące stan zespołów barwienia szkiełek (zob. poniżej). Kliknąć kartę, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu) dla danego modułu przetwarzania. Wybrana karta modułu przetwarzania otoczona jest niebieskim konturem ze strzałką skierowaną w prawo (zob. powyżej).

### 5.1.1.1 Stany zespołu barwienia szkiełek

Poniżej znajdują się przykłady stanów zespołu szkiełek, które można zobaczyć na karcie modułu przetwarzania.

#### Przed rozpoczęciem przebiegu:



Pusty prostokąt: brak tacy lub taca nie jest zablokowana.




Animowane numery ID i świecące paski: trwa obrazowanie tacy.




Ikona tacy na szkiełka: zobrazowano etykiety szkiełek, taca jest gotowa do rozpoczęcia przebiegu.

#### Podczas przebiegu:




Godzina wyświetlana na czarno, z ruchomymi kropkami po lewej: trwa przetwarzanie tacy, brak nieoczekiwanych zdarzeń. Wyświetlany czas to szacowany czas zakończenia przetwarzania tacy.




Godzina wyświetlana na czerwono, z ruchomymi kropkami po lewej: trwa przetwarzanie tacy, wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia. Wyświetlany czas to szacowany czas zakończenia przetwarzania tacy.

#### Po zakończeniu przebiegu:



Migająca godzina wyświetlana na czarno, z nieruchomymi kropkami po lewej: przebieg został zakończony o wskazanej godzinie, nie wystąpiły żadne nieoczekiwane zdarzenia.









Migająca godzina wyświetlana na czerwono, z nieruchomymi kropkami po lewej: przebieg został zakończony o wskazanej godzinie, ale wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia.






Przebieg został anulowany.

5.1.1.2 Stany modułu przetwarzania

Oprogramowanie stale monitoruje stan systemu i wyświetla następujące ikony na karcie modułu przetwarzania:

<b>Ikona</b>	<b>Znaczenie</b>	<b>Ikona</b>	<b>Znaczenie</b>
	Moduł przetwarzania nie jest podłączony.		<b>Ostrzeżenie:</b> Oprogramowanie BOND wykryło nieoczekiwany stan.
	(Miga) Trwa inicjalizacja modułu przetwarzania.		<b>Alarm (miga):</b> Do kontynuowania pracy moduł przetwarzania wymaga interwencji użytkownika.
	Trwa serwisowanie modułu przetwarzania.		Moduł przetwarzania jest poddawany konserwacji.


## 5.1.2 Status urządzenia

Ikony w prawym dolnym rogu ekranu wskazują ostrzeżenie  lub alarm  (w przypadku problemów z dowolnym podzespołem systemu BOND) bądź komunikat informacyjny  (w przypadku ogólnego powiadomienia dotyczącego systemu). Kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać więcej informacji.



Ogólna usterka systemu lub przypomnienie o zadaniu konserwacyjnym.



Pojawia się, jeśli pokrywa lub (tylko BOND-MAX) drzwiczki przedziału pojemników zbiorczych są otwarte podczas przebiegu barwienia. Aby wznowić pracę modułu przetwarzania, należy je zamknąć. Jeśli przebieg barwienia nie jest w toku, wyświetlony zostanie wskaźnik informacyjny .



Brak lub niewystarczający poziom odczytnika.



Moduł przetwarzania rozpoczął inicjalizację i jeszcze nie podjął próby przeskanowania stacji mieszania.



Podczas inicjalizacji nie wykryto stacji mieszania. Stacja może nie być obecna lub może być obecna, ale jej kod kreskowy nie został rozpoznany. W razie potrzeby umieścić czystą stację mieszania w urządzeniu. Kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i postępować zgodnie z monitami, aby poinformować system o umieszczeniu stacji mieszania.



Podczas inicjalizacji wykryto zanieczyszczenie stacji mieszania (np. stacja przy ostatnim wyłączeniu modułu przetwarzania nie została wyczyszczona). Upewnić się, że na miejscu znajduje się czysta stacja mieszania, a następnie kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i potwierdzić.



Czyszczenie stacji mieszania nie powiodło się. Nadal można kontynuować pracę z użyciem pozostałych czystych fiolek. W przeciwnym razie konieczne będzie ponowne uruchomienie modułu przetwarzania, aby usunąć powiadomienie. Jeśli powiadomienie wystąpi ponownie, może wskazywać na problem z układem płynów – w takim przypadku skontaktować się z działem obsługi klienta.



Brak dostępnych czystych fiolek do mieszania.


Odczekać, aż moduł przetwarzania wyczyści kilka fiolek, a następnie postępować zgodnie z normalną procedurą.

Jeśli fiołki nie zostały wyczyszczone, może być konieczne ponowne uruchomienie modułu przetwarzania. Jeśli powiadomienie wystąpi ponownie, może wskazywać na problem z układem płynów – w takim przypadku skontaktować się z działem obsługi klienta.

 Stację mieszania można wyczyścić ręcznie. Zob. [12.7 - Blok myjący i stacja mieszania](#).

### 5.1.2.1 Błędy podgrzewacza

Każdy z podgrzewaczy szkiełek BOND-III i BOND-MAX jest monitorowany niezależnie i oznaczany jako uszkodzony w razie wystąpienia błędu temperatury (zob. [Postać 5-3](#)). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podgrzewacza należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Postać 5-3: Błąd pojedynczego podgrzewacza

Nie należy próbować uruchamiać przebiegu dla szkiełka wymagającego ogrzewania w pozycji oznaczonej jako wadliwa. Jeśli podczas przebiegu podgrzewacz działa nieprawidłowo, może spowodować uszkodzenie szkiełka znajdującego się na tej pozycji. Jeśli usterka podgrzewacza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, ogrzewanie wszystkich szkiełek w module przetwarzania może zostać wyłączone (zob. [Postać 5-4](#)).



Postać 5-4: Szare symbole podgrzewaczy we wszystkich pozycjach oznaczają całkowite wyłączenie podgrzewania

Po wyłączeniu podgrzewania szkiełek należy wyłączyć, a następnie ponownie uruchomić moduł przetwarzania, aby usunąć blokadę podgrzewacza. Można nadal używać pozycji z wadliwymi podgrzewaczami, o ile przetwarzane szkiełka nie wymagają ogrzania.



### 5.1.2.2 Wskaźnik temperatury

Gdy temperatura zespołu barwienia szkiełek przekracza temperaturę otoczenia, w dolnej części ekranu **System status** (stan systemu) pojawia się wskaźnik temperatury.

Wskazuje on, że zespół barwienia szkiełek jest ciepły lub gorący.



Postać 5-5: Wskaźnik temperatury – zespół barwienia ciepły (po lewej) i gorący (po prawej)

Obramowanie tac na szkiełka na ekranie **System status** (stan systemu) również zmienia kolor odpowiednio do temperatury: jest niebieskie, gdy taca ma temperaturę otoczenia, pomarańczowe, gdy taca jest ciepła i czerwone, gdy taca jest gorąca.



Postać 5-6: Obramowanie wskazujące temperaturę tac na szkiełka: taca ciepła (po lewej) i taca gorąca (po prawej)




**OSTRZEŻENIE:** Unikać kontaktu z zespołami barwienia szkiełek i podzespołami znajdującymi się w ich pobliżu. Mogą one być bardzo gorące i powodować poważne oparzenia. Po wyłączeniu odczekać dwadzieścia minut, aż zespoły barwienia szkiełek i ich otoczenie ostygną.

### 5.1.3 Status odczynników


Po prawej stronie ekranu **System status** (stan systemu) wyświetlany jest status wykrytych odczynników. W poniższych częściach opisano stosowane ikony i sposoby usuwania niektórych wskazanych na ekranie problemów z odczynnikami.

- [5.1.3.1 - Systemy odczynników](#)
- [5.1.3.2 - Pojemniki na odczynniki](#)
- [5.1.3.3 - Poziomy odczynników](#)
- [5.1.3.4 - Rozwiązywanie problemów z odczynnikami](#)
- [5.1.3.5 - Rozwiązywanie problemów z niewykrytymi odczynnikami](#)
- [5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego](#)

#### 5.1.3.1 Systemy odczynników

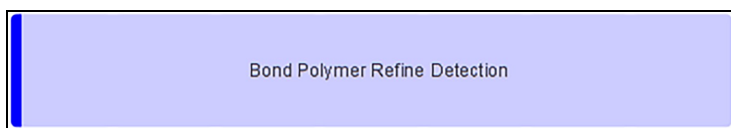



System detekcji BOND lub system teranostyczny Leica

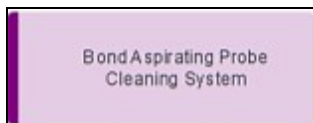

System czyszczenia BOND


#### 5.1.3.2 Pojemniki na odczynniki

 Na ikonach pojemników na odczynniki przed nazwami odczynników dostarczanych przez BOND znajduje się gwiazdka (\*).




Gotowe do użycia przeciwciała pierwszorzędowe BOND.

Szczegóły dla tych odczynników są automatycznie wprowadzane przez oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.



Gotowa do użycia sonda ISH BOND.

Szczegóły dla tych odczynników są automatycznie wprowadzane przez oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.



Dostarczane przez użytkownika przeciwciała pierwszorzędowe w pojemniku otwartym lub pojemniku do miareczkowania BOND.

Szczegóły dla tych odczynników należy wprowadzić ręcznie na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) przed rejestracją, wraz z numerem partii i terminem ważności. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.




Dostarczana przez użytkownika sonda ISH w pojemniku otwartym lub pojemniku do miareczkowania BOND.

Szczegóły dla tych odczynników należy wprowadzić ręcznie na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) przed rejestracją, wraz z numerem partii i terminem ważności. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.




Gotowe do użycia odczynniki pomocnicze BOND.

Szczegóły dla tych odczynników są automatycznie wprowadzane przez oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.



Enzym BOND w pojemniku otwartym BOND lub pojemniku do miareczkowania.

Enzym BOND musi zostać przygotowany przez użytkownika i umieszczony w otwartych pojemnikach, jednak szczegóły konfiguracji tego odczynnika są już wstępnie zdefiniowane w oprogramowaniu BOND. Podczas rejestracji wymagane są tylko numer partii i termin ważności.



Dostarczany przez użytkownika odczynnik pomocniczy w pojemniku otwartym lub pojemniku do miareczkowania BOND.

Szczegóły dla tych odczynników należy wprowadzić ręcznie na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) przed rejestracją, wraz z numerem partii i terminem ważności. Wyświetlana jest skrócona nazwa odczynnika.



Oprogramowanie nie wykryło odczynnika na tej pozycji.

Jeśli odczynnik jest obecny, rozwiązać problem zgodnie z opisem w części [5.1.3.5 - Rozwiązywanie problemów z niewykrytymi odczynnikami](#). Jeśli czytnik ID często nieprawidłowo odczytuje ID, należy wyczyścić okno obrazowania (zob. [12.9 - Czytnik ID](#)).



Oprogramowanie BOND wykryło problem z odczynnikiem. Kliknąć symbol powiadomienia prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać więcej informacji.

Być może oprogramowanie BOND nie rozpoznało odczynnika. W takim przypadku należy za pomocą skanera ręcznego zeskanować odczynnik i dodać go do rejestru. Jeśli ID jest uszkodzone, wprowadzić je ręcznie. Więcej informacji znajduje się w części [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#).



Oprogramowanie BOND wykryło problem z odczynnikiem lub systemem odczynników. Kliknąć symbol informacji prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać więcej informacji.

### 5.1.3.3 Poziomy odczynników

Ikony systemów odczynników na ekranie **System status** (stan systemu) wskazują tylko trzy poziomy objętości:



Pełny do około 20% objętości




Niski (od około 20% do prawie pustego)



Pusty

Ikony odczynników gotowych do użycia i ikony otwartych pojemników bardziej dokładnie wskazują poziom odczynników.




Postać 5-7: Przykłady poziomów odczynników gotowych do użycia na ekranie **System status** (stan systemu)

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o rejestrze odczynników lub systemów odczynników, kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Inventory...** (rejestr...) z menu podręcznego. Pojawi się ekran **Reagent inventory details** (szczegóły rejestru odczynników). Zob. [8.3.2 - Szczegóły odczynnika lub systemu odczynników](#).

### 5.1.3.4 Rozwiązywanie problemów z odczynnikami

Jeśli oprogramowanie BOND jeszcze przed rozpoczęciem przebiegu wykryje problem z odczynnikiem wymaganym do przetwarzania, wyświetli ikonę informacyjną przy symbolu pojemnika na odczynniki poniżej tacy na szkiełka na ekranie **System status** (stan systemu). Jeśli problem wystąpi podczas przebiegu, ikona informacyjna zostanie wyświetlona nad ikoną statusu odczynnika, jak opisano powyżej w tej części. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemu, kliknąć ikonę informacyjną prawym przyciskiem myszy.


Jeśli konieczna jest wymiana lub dodanie odczynnika, należy wyjąć tacę na odczynniki zawierającą odczynnik powodujący problem, wymienić lub dodać wymagany odczynnik, a następnie ponownie załadować tacę.

 Należy zauważyć, że jeśli przetwarzanie jest w toku, a odczynnik na określonej tacy będzie wymagany w ciągu następnych 2 minut, wyjście tej tacy bez anulowania przebiegu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji wskaźnik tacy na odczynniki będzie świecić na czerwono.

### 5.1.3.5 Rozwiązywanie problemów z niewykrytymi odczynnikami

Jeśli odczynnik nie zostanie wykryty, wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy:
  - Pojemnik na odczynniki jest prawidłowo umieszczony na tacy na odczynniki.
  - Korek pojemnika na odczynniki jest otwarty i przymocowany z tyłu pojemnika.
  - W górnej przedniej części pojemnika znajduje się nieuszkodzony kod kreskowy z ID odczynnika.
2. Sprawdzić, czy odczynnik jest zarejestrowany w rejestrze.
  - Jeśli odczynnik nie jest zarejestrowany, należy zarejestrować go zgodnie z opisem w części [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#)
3. W tym momencie można:
  - i. wyjąć tacę na odczynniki (a następnie zanotować unikalny identyfikator UPI danego odczynnika) i ponownie załadować tacę, aby system ponownie automatycznie ją zidentyfikował, lub
  - ii. jeśli ponowne załadowanie tacy na odczynniki nie przyniosło rezultatu, ręcznie zidentyfikować odczynnik – kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę pojemnika na ekranie **System status** (stan systemu) i kliknąć opcję **Select ...** (wybierz...) w podmenu. Wprowadzić identyfikator UPI odczynnika wskazanego powyżej i kliknąć **OK**.

Na oznaczeniu odczynnika pojawi się symbol  wskazujący, że odczynnik został zidentyfikowany ręcznie, zob. [Postać 5-8](#) poniżej. Symbol (i ręcznie zidentyfikowany odczynnik) zniknie, kiedy taca na odczynniki zostanie wyjęta.



Postać 5-8: Ręcznie wprowadzony odczynnik

### 5.1.3.6 Status pojemnika zbiorczego

W dolnej prawej części ekranu **System status** (stan systemu) znajdują się ikony pojemników zbiorczych na zużyty płyn i pojemników na odczynniki. Każdy pojemnik jest oznaczony etykietą i kolorem dopasowanym do zainstalowanych pojemników. Położenie ikon pojemników zbiorczych na ekranie stanu systemu odzwierciedla fizyczne położenie odpowiednich przedziałów na pojemniki zbiorcze w module przetwarzania.

Rzeczywiste rozmieszczenie pojemników dla każdego typu modułu przetwarzania przedstawiono w części [2.2.7 - Przedział na pojemniki zbiorcze](#).



Postać 5-9: Pojemniki zbiorcze (rozmieszczenie w urządzeniu BOND-III)



Postać 5-10: Pojemniki zbiorcze (rozmiszczenie w urządzeniu BOND-MAX).

Ikona z prawej strony przedstawia zewnętrzny pojemnik na odpady

Poniżej znajdują się opisy zawartości każdego z powyższych pojemników zbiorczych.








Etykieta pojemnika zbiorczego	Zawartość pojemnika zbiorczego
*Dewax	BOND Dewax Solution
*DI	Woda dejonizowana
*BWash	BOND Wash Solution
*Alcohol	Alkohol (odczynnikowy)
*BlkWast	Odpady zbiorcze
*HazWast	Odpady niebezpieczne
*ER1	BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2	BOND Epitope Retrieval Solution 2

### BOND-III

Oprogramowanie wyświetla poziom płynu w pojemnikach zbiorczych na odczynniki i pojemnikach na odpady płynne urządzenia BOND-III. Jeśli zapas odczynnika jest niski lub poziom odpadów jest wysoki, oprogramowanie generuje powiadomienie, alarm (migająca ikona) lub ostrzeżenie w zależności od wagi problemu. Kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić komunikat informacyjny i podjąć działania niezbędne do rozwiązania problemu – zob. [12.2.2 - Uzupelnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych](#).

**Uwaga:** Jeśli pojawi się symbol ostrzeżenia, przetwarzanie zostanie wstrzymane do momentu usunięcia problemu.

System BOND-III wskazuje stan pojemników zbiorczych przy użyciu kombinacji następujących symboli:

Pojemniki zbiorcze	Znaczenie
	Pojemnik jest pełny.
	Poziom w pojemniku jest większy niż 1/2.
	Poziom w pojemniku jest mniejszy niż 1/2.
	Pojemnik jest prawie pusty lub pusty.
	<p>Pojawia się w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemnik na odpady jest prawie pełny i należy go natychmiast opróżnić</li> <li>• Poziom odczynnika jest niski i należy go natychmiast uzupełnić</li> <li>• Brak pojemnika</li> <li>• Niewystarczająca objętość do rozpoczęcia przebiegu</li> </ul> <p>Zob. <a href="#">12.2.2 - Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych</a>.</p>
 lub 	<p>Pojawia się, jeśli przebieg został wstrzymany z powodu wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemnik na odpady jest pełny i należy go pilnie opróżnić (ostrzeżenie)</li> <li>• Poziom odczynnika jest niski i należy go pilnie uzupełnić (ostrzeżenie)</li> <li>• Brak pojemnika wymaganego do rozpoczęcia przetwarzania (alarm)</li> </ul> <p>Zob. <a href="#">12.2.2 - Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych</a>.</p>

 Stan pojemnika zbiorczego na ekranie **System status** (stan systemu) jest zsynchronizowany z systemem oświetlenia opisanym w części [System oświetlenia pojemnika zbiorczego \(BOND-III\) on page 34](#).

#### BOND-MAX

Oprogramowanie wyświetla ikonę informacyjną (jak powyżej) nad danym pojemnikiem zbiorczym, gdy wykryje problem (na przykład niski poziom w pojemniku na odczynnik lub wysoki poziom w pojemniku na odpady). Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę powiadomienia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

## 5.1.4 Informacje o szkiełkach

W poniższych częściach opisano ikony używane do reprezentowania informacji o szkiełkach na ekranie **System status** (stan systemu). Omówiono również opcje dostępne w menu podręcznym szkiełek.

- [5.1.4.1 - Ikony szkiełek](#)
- [5.1.4.2 - Menu podręczne tacy na szkiełka](#)
- [5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkiełek](#)
- [5.1.4.4 - Rozwiązywanie problemu z niezgodną konfiguracją szkiełek](#)


### 5.1.4.1 Ikony szkiełek

Na ekranie **System status** (stan systemu) wyświetlana jest graficzna reprezentacja każdej z trzech tac na szkiełka z ikoną dla każdego szkiełka. Ikony szkiełek wskazują stan każdego szkiełka.


System można skonfigurować tak, aby używać funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) na etykietach alfanumerycznych lub czytnika kodów kreskowych. W obu przypadkach ikony szkiełek można opcjonalnie skonfigurować tak, aby zawierały również przechwycone obrazy etykiet szkiełek. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany istniejących ustawień, skontaktować się z działem obsługi klienta.

W poniższych tabelach przedstawiono przykłady ikon szkiełek.

#### Ikony szkiełek z etykietami po OCR

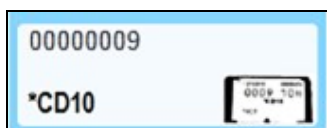


Zobrazowane i automatycznie zidentyfikowane szkiełko (zob. [5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkiełek](#))

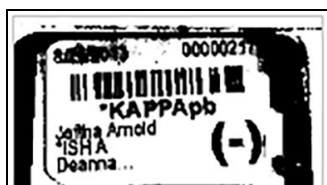

Zobrazowane szkiełko, ale nie zidentyfikowane przez system (ikona przedstawia obraz obszaru etykiety)




Zobrazowane i ręcznie zidentyfikowane szkiełko – zwrócić uwagę na symbol (zakreślony na czerwono) na szkiełku (zob. [5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#))

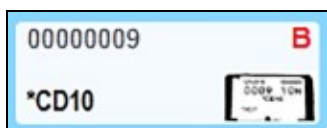

Szkiełko jest niezgodne z jednym lub kilkoma innymi szkiełkami na tacy (zob. [5.1.4.4 - Rozwiązywanie problemu z niezgodną konfiguracją szkiełek](#))



Brak szkiełka na tej pozycji

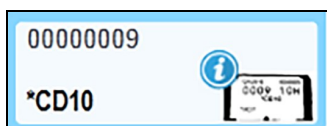


Szkiełko z powiadomieniem o zdarzeniu podczas przetwarzania (zob. [5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkiełek](#))



## Ikony szkiełek z etykietami z kodem kreskowym




Brak szkiełka na tej pozycji lub szkiełko zostało zobrazowane, ale system nie jest w stanie go zidentyfikować

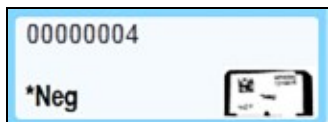

Zobrazowane i automatycznie zidentyfikowane szkiełko (zob. [5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkiełek](#))



Zobrazowane i ręcznie zidentyfikowane szkiełko – zwrócić uwagę na symbol (zakreślony na czerwono) na szkiełku (zob. [5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#))

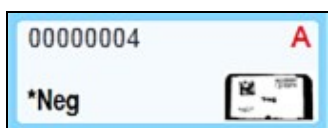

Szkiełko jest niezgodne z jednym lub kilkoma innymi szkiełkami na tacy (zob. [5.1.4.4 - Rozwiązywanie problemu z niezgodną konfiguracją szkiełek](#))



Szkiełko z powiadomieniem o zdarzeniu podczas przetwarzania (zob. [5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkiełek](#))

Kliknąć dwukrotnie szkiełka, które zostały rozpoznane przez system BOND, aby otworzyć okno dialogowe **Slide properties** (Właściwości szkiełka). Jeśli przebieg nie został zainicjowany, można dokonać edycji szczegółów szkiełka w tym oknie dialogowym, jednak konieczne będzie wydrukowanie nowej etykiety dla szkiełka, wyjęcie tacy i naklejenie tej etykiety na szkiełko, a następnie ponowne załadowanie tacy.


### 5.1.4.2 Menu podręczne tacy na szkiełka

Kliknąć prawym przyciskiem myszy szkiełka na grafice tacy na szkiełka na ekranie **System status** (stan systemu), aby wyświetlić opcje dostępne dla szkiełka lub tacy.

Polecenie	Opis
Select manually... (wybierz ręcznie...)	<p>Opcja dostępna, jeśli szkiełko nie zostało automatycznie zidentyfikowane.</p> <p>Wybrać tę opcję, otworzyć okno dialogowe <b>Slide identification</b> (identyfikacja szkiełek) umożliwiające dopasowanie szkiełka do szkiełka skonfigurowanego w systemie (zob. <a href="#">5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu</a>).</p> <p>Tę opcję można również wybrać, klikając dwukrotnie niezidentyfikowane szkiełko.</p>
Attention message... (komunikat informacyjny...)	Wyświetla komunikat informacyjny, jeśli dla szkiełka wygenerowano powiadomienie o zdarzeniu (zob. <a href="#">5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkiełek</a> ).

Polecenie	Opis
Run events (zdarzenia podczas przebiegu)	Generuje raport dot. zdarzeń podczas przebiegu (zob. <a href="#">9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu</a> ).
Delayed start (opóźnione uruchomienie)	Ustawia opóźnienie uruchomienia przebiegu (zob. <a href="#">5.1.8 - Opóźnione uruchomienie</a> ).

### 5.1.4.3 Powiadomienia o zdarzeniach dla szkiełek

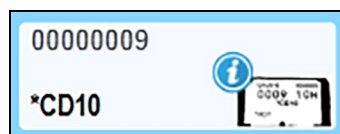

Postać 5-11: Szkiełko z powiadomieniem o zdarzeniu

Jeśli podczas przetwarzania wystąpi nieoczekiwane zdarzenie, na ikonie szkiełka pojawi się symbol alertu. To powiadomienie nie musi oznaczać, że barwienie było w jakikolwiek sposób nieprawidłowe. Gdy pojawi się symbol powiadomienia, operator systemu lub kierownik laboratorium muszą wykonać dodatkowe kroki, aby potwierdzić, że szkiełko nadaje się do diagnostyki.

1. Kliknąć szkiełko prawym przyciskiem myszy i wybrać **Run events** (zdarzenia podczas przebiegu), aby wygenerować raport dot. zdarzeń podczas przebiegu (zob. [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)).

Wszystkie zdarzenia, które spowodowały wystąpienie powiadomienia, są wyróżnione **pogrubieniem**. Operator systemu lub kierownik laboratorium powinni dokładnie rozpatrzyć wymienione na liście powiadomienia o zdarzeniach, ponieważ zawierają one ważne szczegóły dotyczące zdarzeń dla szkiełek.


2. Dokładnie skontrolować barwioną tkankę.
3. Dokładnie skontrolować wszystkie szkiełka z próbkami kontrolnymi.

Jeżeli laboratorium nie jest w stanie potwierdzić jakości barwienia, należy poinformować patologa o powiadomieniu lub powtórzyć test.

W jednym raporcie dot. zdarzeń podczas przebiegu może znajdować się wiele powiadomień. Jeśli przebieg kończy się statusem **Done (notification)** (gotowe (powiadomienie)), sprawdzić cały raport. Jeśli status to **Done (OK)** (gotowe OK), nie ma potrzeby sprawdzania raportu.

#### 5.1.4.4 Rozwiązywanie problemu z niezgodną konfiguracją szkiełek

Jeśli system BOND wykryje niezgodne szkiełko, w prawym górnym rogu wszystkich szkiełek na tacy pojawiają się czerwone pogrubione litery. Szkiełka z tą samą literą są zgodne.

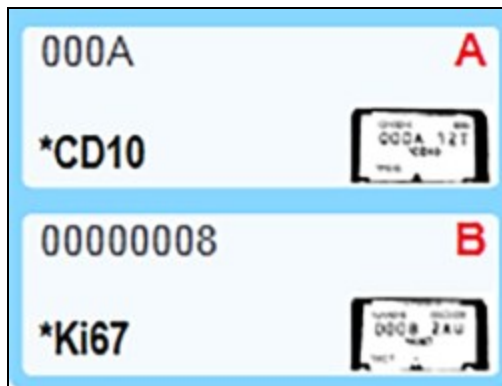

Postać 5-12: Niezgodne szkiełka

Wyjąć tacę na szkiełka i usunąć niezgodne szkiełka lub zmienić właściwości szkiełek (jeśli to w nich tkwi problem), aby zapewnić zgodność. W przypadku zmiany właściwości szkiełek należy ponownie wydrukować etykiety dla zmienionych szkiełek i zamocować je przed ponownym załadowaniem tacy.

Więcej szczegółów na temat zgodności szkiełek znajduje się w części [6.9 - Zgodność szkiełek](#).

### 5.1.5 Identyfikacja szkiełek w urządzeniu

W najbardziej standardowym przebiegu pracy szkiełka z etykietami pochodzącymi z systemu BOND lub systemu LIS są ładowane do modułu przetwarzania, a następnie automatycznie identyfikowane. Identyfikacja polega na odczytywaniu kodów kreskowych na etykietach lub, w przypadku korzystania z alfanumerycznych ID, na optycznym rozpoznawaniu znaków (OCR). Jeśli etykieta jest zamazana lub z jakiegoś innego powodu nie można odczytać, można ją zidentyfikować ręcznie w oprogramowaniu BOND. W niektórych przebiegach pracy identyfikowanie ręczne jest standardem (zob. [6.8 - Ręczne tworzenie slajdów i przypadków](#)).

#### 5.1.5.1 Automatyczna identyfikacja szkiełek

System BOND może automatycznie identyfikować standardowe etykiety z kodem kreskowym BOND lub alfanumerycznym utworzone przy użyciu drukarki BOND (jak opisano w części [6.6 - Etykietowanie szkiełek](#)) i szkiełka z nadrukiem LIS wykorzystującym rozpoznawalny format kodu kreskowego (zob. część [11.3 - Podłączenie i inicjalizacja LIS](#)). Gdy taca na szkiełka zostanie zablokowana, system próbuje zidentyfikować każdą etykietę i dopasować ją do listy wydrukowanych etykiet szkiełek. Jeśli system jest w stanie dopasować etykietę do listy wydrukowanych etykiet, szkiełko jest automatycznie identyfikowane i nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie ze strony operatora.

Jeśli system korzysta z układu OCR (lub ustawienia domyślne kodu kreskowego zostały zmienione przez technika serwisowego Leica Biosystems), podczas procesu identyfikacji szkiełka przechwytuje obraz każdej etykiety. Obrazy te pojawiają się w następujących raportach celem udokumentowania dopasowania szkiełka:

- [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)
- [9.5 - Raport dot. szczegółów przebiegu](#)
- [9.6 - Raport dla przypadku](#)

Jeśli system nie jest w stanie zidentyfikować etykiety, należy ręcznie zidentyfikować szkiełko, korzystając z procedury ręcznej identyfikacji szkiełek (zob. następna część).

### 5.1.5.2 Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu

W systemach skonfigurowanych do przechwytywania obrazu każdej etykiety szkiełka (systemy OCR i niektóre systemy kodów kreskowych), jeśli automatyczna identyfikacja nie powiedzie się, szkiełka można zidentyfikować ręcznie bez konieczności ich wyładowania z modułu przetwarzania. Do ręcznego identyfikowania załadowanych szkiełek służy poniższa procedura.

1. Kiedy system nie jest w stanie automatycznie zidentyfikować szkiełka, oprogramowanie wyświetli obraz etykiety.




Figure 5-13: Szkiełko, które nie zostało automatycznie zidentyfikowane

2. Aby uruchomić okno dialogowe funkcji wspomaganie wykrywania ID, wykonać jedną z następujących czynności:
  - i. Dwukrotnie kliknąć obraz szkiełka; lub
  - ii. Kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Select manually** (wybierz ręcznie) z menu podręcznego.
3. Pojawi się okno dialogowe **Slide identification** (identyfikacja szkiełek).

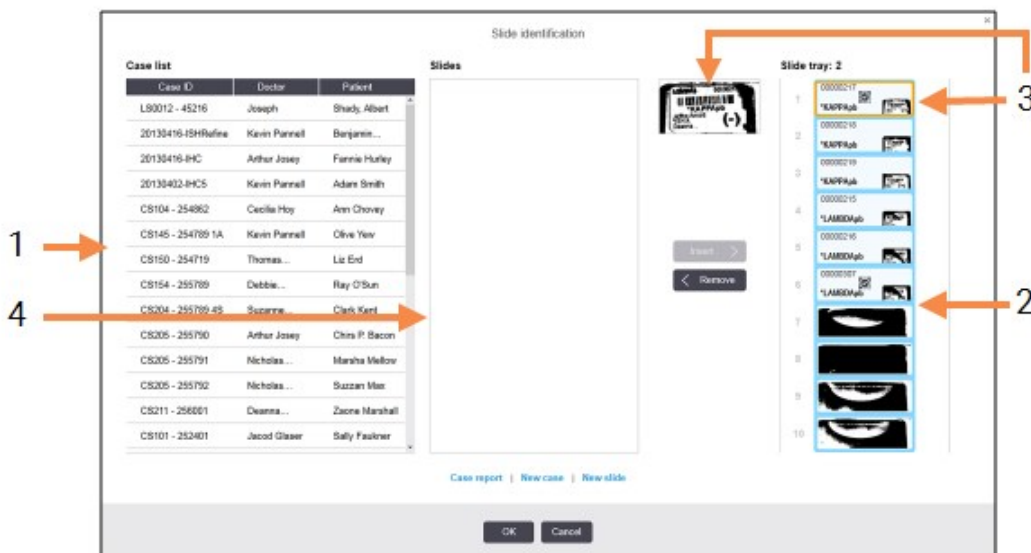


Figure 5-14: Okno dialogowe identyfikacji szkiełek

W lewym okienku (element 1) znajduje się lista wszystkich przypadków z nieprzetworzonymi szkiełkami. W przypadku ustawień domyślnych wyświetlane są tylko przypadki ze szkiełkami, dla których wydrukowane zostały etykiety (ustawienia te można zmienić tak, aby uwzględnić przypadki ze szkiełkami, dla których etykiety nie zostały wydrukowane – zob. [6.8.2.2 - Zewnętrzne etykiety szkiełek](#)).

Etykiety szkiełek w bieżącym zespole barwienia szkiełek są pokazane w okienku po prawej stronie (element 2).

Szkiełko wybrane po otwarciu okna dialogowego zostanie podświetlone (element 3) w powiększeniu w okienku po prawej stronie. Przytrzymać kursor nad szkiełkiem w prawym okienku, aby jeszcze bardziej powiększyć obraz.


Środkowe okienko (element 4) zawiera szkiełka skonfigurowane dla przypadku wybranego w okienku po lewej, gdzie szkiełka nie zostały jeszcze dopasowane do szkiełek obrazowanych w module przetwarzania. Ponownie, domyślnie wyświetlane są tylko szkiełka, dla których zostały wydrukowane etykiety, jednak ustawienie to można zmienić, aby wyświetlić wszystkie szkiełka skonfigurowane dla przypadku (zob. [6.8.2.2 - Zewnętrzne etykiety szkiełek](#)).

W tym momencie w razie potrzeby można utworzyć nowe przypadki i szkiełka za pomocą poleceń **New case** (nowy przypadek) oraz **New slide** (nowe szkiełko) (więcej informacji znajduje się w części [6.8 - Ręczne tworzenie slajdów i przypadków](#)). Poniższe instrukcje zakładają, że wszystkie wymagane szkiełka zostały już skonfigurowane w urządzeniu BOND.

4. Na podstawie informacji widocznych na wybranym obrazie etykiety po prawej stronie określić przypadek, do którego przynależy szkiełko. Wybrać ten przypadek z okienka z przypadkami (element 1).

Lista szkiełek (element 4) zostanie wypełniona niedopasowanymi szkiełkami skonfigurowanymi dla tego przypadku.

5. Dopasować niezidentyfikowane szkiełko do szkiełka na liście szkiełek (element 4). Wybrać szkiełko i kliknąć **Insert** (wstaw).

Szkiełko zostanie usunięte z listy szkiełek, a obraz w okienku po prawej stronie zostanie zaktualizowany, informując o zidentyfikowaniu szkiełka. Symbol  oznacza, że szkiełko zostało wybrane ręcznie.

Teraz na potrzeby identyfikacji podświetlona zostanie kolejna niezidentyfikowana etykieta szkiełka, jeśli taka jest.


6. Dopasować wszystkie niezidentyfikowane szkiełka, powtarzając powyższe kroki.
7. Po zidentyfikowaniu wszystkich szkiełek na tacy kliknąć **OK**, aby zamknąć okno dialogowe. Kliknięcie przycisku **Cancel** (anuluj) spowoduje utratę wszystkich zidentyfikowanych ręcznie szkiełek.
8. Na ekranie **System status** pojawią się teraz wszystkie znajdujące się na tacy szkiełka wraz ze szczegółami. Przy szkiełkach, które zostały zidentyfikowane ręcznie, wyświetlane są obraz etykiety i symbol  wskazujące, że szkiełko zostało wybrane ręcznie.



Figure 5-15: Ręcznie zidentyfikowane szkiełko przed przetwarzaniem

9. Ręcznie wybrane szkiełka są przetwarzane standardowo.

Obraz szkiełka pojawia się w następujących raportach celem udokumentowania dopasowania szkiełka:

- [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)
- [9.5 - Raport dot. szczegółów przebiegu](#)
- [9.6 - Raport dla przypadku](#)

#### 5.1.5.3 Systemy NIESKONFIGUROWANE do obrazowania wszystkich etykiet szkiełek

Szkiełka te można nadal identyfikować ręcznie, ale może to wymagać wyjęcia tacy na szkiełka.

Zanotować ID i numer pozycji tego szkiełka (wyłączone na tacy na szkiełka poniżej szyjki szkiełka nakrywkowego Covertile), które nie zostało automatycznie zidentyfikowane.

Ponownie załadować tacę na szkiełka i dwukrotnie kliknąć odpowiednią pozycję (licząc w dół od górnej pozycji zespołu barwienia szkiełek na ekranie **System status** (stan systemu)).

## 5.1.6 Wskaźnik postępu przebiegu

Wskaźniki postępu znajdują się poniżej każdej grafiki tacy na szkiełku. Pozwalają one szybko wzrokowo określić status i postęp przebiegu.

- [5.1.6.1 - Status przebiegu](#)
- [5.1.6.2 - Postęp przebiegu](#)
- [5.1.7.1 - Zatrzymywanie przebiegu](#)
- [5.1.8.1 - Ustawianie czasu opóźnionego uruchomienia](#)

### 5.1.6.1 Status przebiegu

U dołu każdego wskaźnika postępu wyświetlane są numer i status bieżącego przebiegu. Możliwe statusy przebiegu:

Status przebiegu	Opis
Unlocked (odblokowana)	Taca na szkiełku jest odblokowana.
Locked (zablokowana)	Taca na szkiełku jest zablokowana, ale rozpoczęcie przetwarzania nie jest jeszcze możliwe. Stan ten zazwyczaj występuje przed zakończeniem obrazowania szkiełek.
Slides ready (szkiełka gotowe)	Wszystkie szkiełka w zespole barwienia szkiełek zostały zobrazowane.
Starting (rozpoczynanie)	Naciśnięto przycisk Start, a system wykonuje wstępne kontrole i planowanie przed rozpoczęciem przebiegu.
Rejected/Slides ready (odrzucone/szkiełka gotowe)	System BOND próbował rozpocząć przebieg, ale operacja nie powiodła się. Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami odrzucenia są brakujące odczynniki, niski poziom odczynników zbiorczych lub pełny pojemnik na odpady. Wygenerować raport dot. zdarzeń podczas przebiegu, rozwiązać wszelkie problemy wskazane w raporcie, a następnie ponownie uruchomić przebieg.
Zaplanowane przebiegi	Przebieg został umieszczony w kolejce, ale nie rozpoczęto przetwarzania. Wskaźnik postępu przebiegu wskazuje zaplanowany czas rozpoczęcia.
Proc (OK) (przetwarzanie OK)	Przebieg jest przetwarzany, nie wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia.
Proc (notification) (przetwarzanie (powiadomienie))	Przebieg jest przetwarzany, jednak wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie dot. zdarzeń podczas przebiegu.
Abandoning (anulowanie)	Przebieg został anulowany. Ma to miejsce, gdy operator naciśnie przycisk zatrzymania.
Done (OK) (gotowe OK)	Przetwarzanie zostało zakończone, nie wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia.
Done (notification) (gotowe (powiadomienie))	Przetwarzanie zostało zakończone, jednak wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie dot. zdarzeń podczas przebiegu.




### 5.1.6.2 Postęp przebiegu

Pasek postępu poniżej każdej grafiki tacy na szkiełka przedstawia wizualnie postęp przebiegu. Pasek postępu wskazuje krytyczne godziny, wyświetla bieżący postęp w odniesieniu do tych godzin i wykorzystuje następujące kolory do przedstawiania czterech etapów postępu przebiegu:

- Niebieski – taca na szkiełka jest zablokowana, przetwarzanie nie zostało rozpoczęte
- Czerwony – przetwarzanie nie zostało rozpoczęte i przekroczone limit czasu rozpoczęcia
- Zielony – przetwarzanie
- Fioletowy – przebieg został zakończony, trwa uwadnianie


Umieszczając wskaźnik myszy nad wybranym fragmentem paska postępu przebiegu, można wyświetlić status przebiegu, np. „Time since locked” (czas od zablokowania), „Time to completion” (czas do ukończenia) czy „Time since completion” (czas od zakończenia), jak pokazano na [Postać 5-16](#).

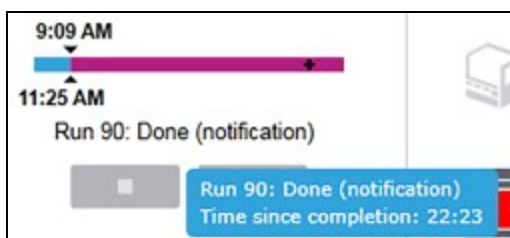

Postać 5-16: Wyświetlanie statusu przebiegu

### Szkiełka gotowe – uruchamianie

Po zakończeniu obrazowania szkiełek i przygotowaniu przebiegu do rozpoczęcia oraz przez krótki czas po naciśnięciu przycisku Start lub zainicjowaniu opóźnionego uruchomienia pasek składa się z poniższych elementów (numery elementów pokazano na [Postać 5-17](#)).

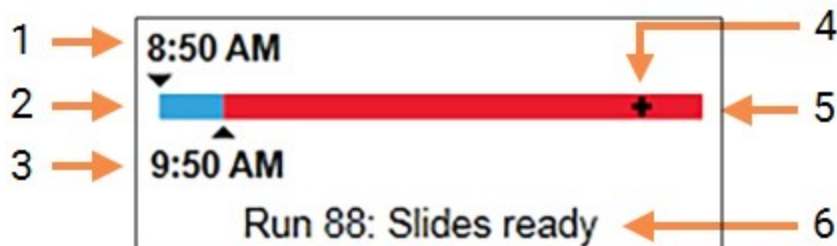

Postać 5-17: Postęp przebiegu (uruchamianie)

Nr	Opis
1	Godzina zablokowania tacy
2	Dopuszczalny okres rozpoczynania (niebieski pasek) (zob. <a href="#">Dopuszczalny okres rozpoczynania i alarmy on page 107</a> )
3	Dopuszczalny limit czasu rozpoczęcia
4	Bieżący postęp
5	Przekroczenie czasu rozpoczęcia (czerwony pasek)
6	Status przebiegu (zob. <a href="#">5.1.6.1 - Status przebiegu</a> )



### Dopuszczalny okres rozpoczynania i alarmy

Przetwarzanie należy rozpocząć jak najszybciej po zablokowaniu tac na szkiełka. Podczas okresu rozpoczynania (pomiędzy momentem zablokowania tacy a rozpoczęciem przetwarzania) szkiełka nie uwadniane, jeśli więc okres ten jest zbyt długi, może dojść do zniszczenia tkanek. Oprogramowanie BOND pomaga monitorować ten okres, śledząc czas od chwili zablokowania tac i pokazując maksymalny dopuszczalny okres rozpoczynania danego typu załadowanych szkiełek (zaparafinowane lub odparafinowane). Dopuszczalne okresy rozpoczynania są wyświetlane jako niebieski pasek na pasku postępu „Slides ready” (szkiełka gotowe) (zob. powyżej). W przypadku szkiełek odparafinowanych, jeśli przetwarzanie nie rozpocznie się niedługo po upływie dopuszczalnego okresu rozpoczynania, wygenerowany zostanie alarm.

Poniżej przedstawiono okresy rozpoczynania i czas generowania alarmów dla szkiełek odparafinowanych. Wszystkie wartości są liczone od momentu zablokowania tacy:


Dopuszczalny okres rozpoczynania lub alarm	Czas (min) pd chwili zablokowania tacy
Dopuszczalny okres rozpoczęcia przetwarzania szkiełek odparafinowanych	15
Czas, po którym generowany jest alarm dla szkiełek odparafinowanych	25
Dopuszczalny okres rozpoczęcia przetwarzania szkiełek zaparafinowanych	60

Jeśli przetwarzanie nie rozpoczęło się w okresie rozpoczynania, można wyjąć tace, aby ręcznie uwodnić szkiełka. Po ponownym włożeniu tacy oprogramowanie BOND uruchomi nowy przebieg, przydzieli nowy numer ID przebiegu i ponownie rozpocznie odliczanie okresu.

Dopuszczalne limity czasu rozpoczęcia mają zastosowanie tylko do przebiegów uruchamianych od razu; nie dotyczą one przebiegów uruchamianych z opóźnieniem.

### Zaplanowane przebiegi

Po zainicjowaniu przebiegu za pomocą przycisku Start lub zainicjowaniu opóźnionego uruchomienia przebieg zostaje umieszczony w kolejce. W okresie między umieszczeniem w kolejce a rozpoczęciem przetwarzania (okres ten może być długi w przypadku opóźnionego uruchomienia) pasek postępu składa się z poniższych elementów (numery elementów pokazano na [Postać 5-18](#)).

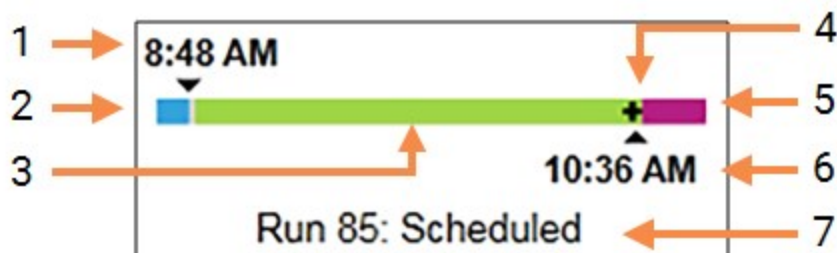


Postać 5-18: Postęp przebiegu (opóźnione uruchomienie)

## 5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Nr	Opis
1	Planowany czas rozpoczęcia przebiegu
2	Opóźnienie przed rozpoczęciem (niebieski pasek)
3	Okres przetwarzania (zielony pasek)
4	Bieżący postęp
5	Okres uwadniania po zakończeniu przetwarzania (fioletowy pasek)
6	Przybliżony czas zakończenia przebiegu
7	Status przebiegu (zob. <a href="#">5.1.6.1 - Status przebiegu</a> )

### Podczas przetwarzania

W trakcie fazy przetwarzania pasek składa się z poniższych elementów (numery elementów pokazano na [Postać 5-19](#)).

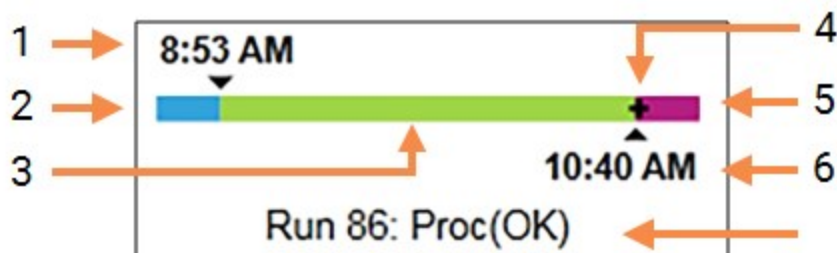

Postać 5-19: Postęp przebiegu (przetwarzanie)


Nr	Opis
1	Zaplanowany czas rozpoczęcia
2	Okres rozpoczynania – niebieski: rozpoczęto, czerwony: przekroczony limit czasu rozpoczęcia
3	Okres przetwarzania (zielony pasek)
4	Bieżący postęp
5	Okres uwadniania po zakończeniu przetwarzania (fioletowy pasek)
6	Przybliżony czas zakończenia przebiegu
7	Status przebiegu (zob. <a href="#">5.1.6.1 - Status przebiegu</a> )

## 5.1.7 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu

Przebieg rozpoczyna się od załadowania i zablokowania tacy na szkiełka. Taca jest obrazowana, po czym przed rozpoczęciem przebiegu system sprawdza czy:

- Wszystkie szkiełka są zgodne.
- Wszystkie odczynniki są dostępne.

Po zobrazowaniu szkiełek status przebiegu jest zmieniany na **Slides ready** (szkiełka gotowe) (zob. [5.1.6.1 - Status przebiegu](#)) i pojawia się pasek postępu w fazie początkowej (zob. [5.1.6.2 - Postęp przebiegu](#)). Po rozwiązaniu wszelkich niezgodności szkiełek, zidentyfikowaniu wszystkich szkiełek i sprawdzeniu, czy wszystkie wymagane odczynniki są dostępne, można uruchomić przebieg.


- Aby jak najszybciej rozpocząć przebieg, kliknąć przycisk . Aby ustawić opóźnienie uruchomienia, kliknąć tacę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Delayed start** (opóźnione uruchomienie) z menu podręcznego. Dalsze wskazówki znajdują się w części [5.1.8 - Opóźnione uruchomienie](#)
  1. Po zakończeniu kontroli wstępnych i planowania status przebiegu zostanie zmieniony na **Starting** (rozpoczynanie). Pasek postępu pozostaje w fazie początkowej.
  2. Po zakończeniu planowania status zmieni się na **Scheduled** (zaplanowano). Pasek postępu przejdzie do fazy przetwarzania. Po lewej stronie paska wyświetlone zostaną zaplanowana godzina rozpoczęcia i status (OK lub przekroczony limit czasu).
  3. Jeśli przetwarzanie rozpocznie się o zaplanowanej godzinie, status zmieni się na **Proc (OK)** (przetwarzanie OK). Jeśli przekroczono limit czasu rozpoczęcia, ostrzeżenie lub alarm znikną po rozpoczęciu przetwarzania. Jednak część początkowa paska postępu pozostanie czerwona.
  4. Należy pamiętać, że stany **Starting** (rozpoczynanie) oraz **Scheduled** (zaplanowano) mogą trwać pewien czas i spowodować przekroczenie limitu czasu rozpoczęcia. W takim przypadku należy odblokować tacę na szkiełka i ręcznie uwodnić szkiełka przed ponownym uruchomieniem przebiegu. Jeśli taca zostanie odblokowana przed rozpoczęciem przetwarzania, przebieg nie zostanie uznany za anulowany i będzie można uruchomić go ponownie.




Uruchamiać należy tylko jeden przebieg naraz, a następnie odczekać 1–2 minuty przed rozpoczęciem kolejnego przebiegu. Odczekać chwilę po rozpoczęciu każdego przebiegu, aby upewnić się, że został on pomyślnie uruchomiony. Jeśli nie, status przebiegu zostanie zmieniony na **Rejected/Slides ready** (odrzucone/szkiełka gotowe). Zob. [5.1.6.1 - Status przebiegu](#).

### 5.1.7.1 Zatrzymywanie przebiegu


Po naciśnięciu przycisku Start (lub aktywowaniu opóźnionego uruchomienia) aż do rozpoczęcia przetwarzania – kiedy przebieg ma status **Starting** (rozpoczynanie) lub **Scheduled** (zaplanowano) – przetwarzanie może zostać wstrzymane bez konieczności jego anulowania. Aby anulować żądanie przetwarzania w tym czasie, należy odblokować tacę na szkiełka w module przetwarzania (przyciski uruchamiania i anulowania są wówczas niedostępne). Informacje o szkiełkach pozostają w systemie, a przebieg można ponownie uruchomić w późniejszym czasie. Do listy **Slide history** (historia szkiełek) dodawany jest pojedynczy wiersz informujący o anulowaniu przebiegu.

Aby anulować przebieg po rozpoczęciu przetwarzania, kliknąć przycisk . Moduł przetwarzania przerwie przebieg po zakończeniu bieżącego kroku. Status szkiełek na ekranie **Slide history** (historia szkiełek) zmieni się na **Done (notification)** (gotowe (powiadomienie)).

-  Należy starannie rozważyć anulowanie przebiegu – anulowanego przebiegu nie można uruchomić ponownie, a wszystkie szkiełka, których przetwarzanie nie zostało zakończone, mogą zostać uszkodzone.

### 5.1.8 Opóźnione uruchomienie

System BOND może uruchamiać przebiegi ze szkiełkami z preparatami zatopionymi w parafinie w określonym czasie w przyszłości (do jednego tygodnia od aktualnego czasu). Przykładowo przebiegi nocne można zaplanować tak, aby kończyły się tuż przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy. Szkiełka pozostają bezpiecznie zaparafinowane do momentu rozpoczęcia przetwarzania, dzięki czemu okres uwadniania po zakończeniu przetwarzania jest możliwie najkrótszy.

-  Niektóre odczynniki producentów innych niż Leica Biosystems mogą ulec degradacji, jeśli będą przetrzymywane przez dłuższy czas w modułach przetwarzania w oczekiwaniu na opóźnione uruchomienie. Informacje o stosowaniu i przechowywaniu odczynników znajdują się w ich kartach charakterystyki. Jak zawsze, Leica Biosystems zaleca umieszczenie tkanki kontrolnej na szkiełkach z tkanką testową.


#### 5.1.8.1 Ustawianie czasu opóźnionego uruchomienia

Aby uruchomić przebieg z opóźnieniem, przygotować szkiełka jak zwykle i zablokować tacę na szkiełka. Gdy status przebiegu zmieni się na **Slides ready** (szkiełka gotowe), wybrać opcję **Delayed start** (opóźnione uruchomienie) z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy tacy na ekranie **System status** (stan systemu).

W oknie dialogowym **Delayed start** (opóźnione uruchomienie) ustawić datę i godzinę rozpoczęcia przebiegu i kliknąć **OK** (zob. [Korzystanie z pól wyboru daty i godziny on page 193](#)). System przejdzie do stanu **Starting** (uruchamianie) i ustawi przebieg w kolejce zgodnie z innymi zaplanowanymi działaniami. Taca będzie znajdować się w stanie **Scheduled** (zaplanowana), a nadejście ustawiona godzina rozpoczęcia normalnego przetwarzania.

## 5.2 Ekran statusu protokołu

Na tym ekranie wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące statusu poszczególnych szkiełek. Aby wyświetlić ekran **Protocol status** (status protokołu), należy przejść do ekranu **System status** (stan systemu) i kliknąć kartę **Protocol status** (status protokołu).

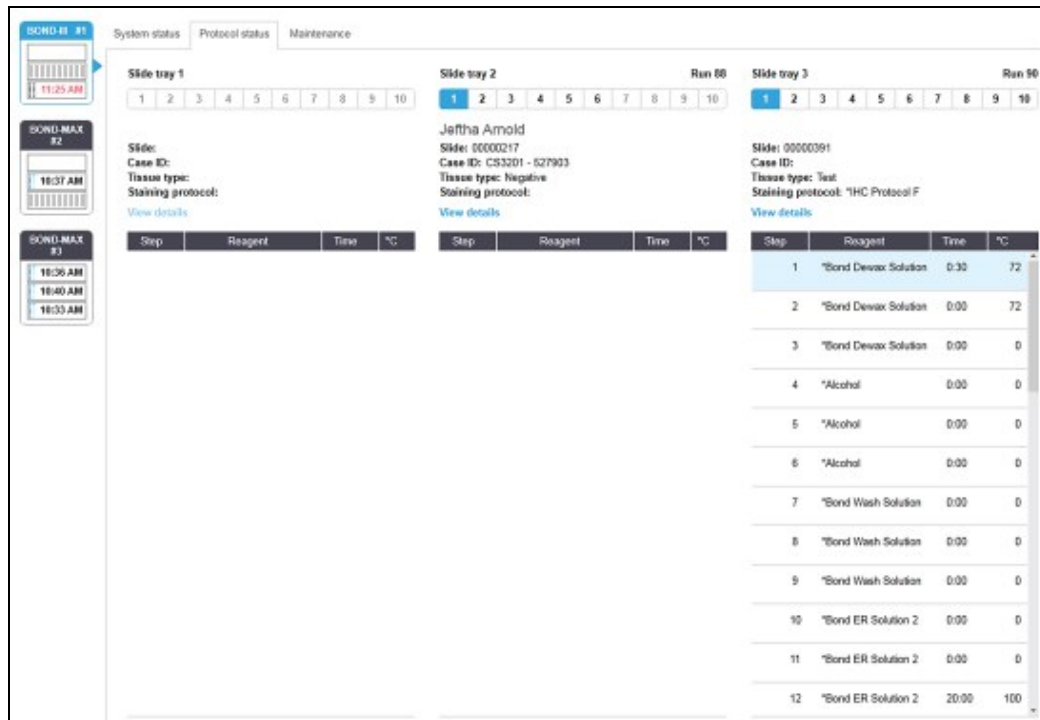

Postać 5-20: Ekran **Protocol status** (status protokołu)

Aby wyświetlić postępowanie przebiegu analizy szkiełka, kliknąć odpowiedni przycisk pozycji szkiełka w górnej części ekranu. Przyciski opcji dla pozycji bez szkiełek są wyszarzone i nie można ich wybrać.



Jeśli imię i nazwisko pacjenta są zbyt długie, aby zmieścić się w dostępnym miejscu (taca na szkiełka 1, 2 i 3), nazwa jest skracana za pomocą wielokropka „...” dostawianego na końcu. Aby wyświetlić pełne imię i nazwisko pacjenta w wyskakującym polu, należy najechać kursorem myszy na skróconą nazwę.

Po wybraniu pozycji szkiełka oprogramowanie wyświetli określone szczegóły szkiełka i postępowanie realizacji protokołu. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły szkiełka, kliknąć **View details** (pokaż szczegóły). Pojawi się okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka).


Pod szczegółami szkiełka pokazane są poszczególne kroki protokołu dla wybranego szkiełka. Bieżący krok jest podświetlony na niebiesko. Obok zakończonych kroków wyświetlany jest symbol zaznaczenia w zielonym okręgu lub, jeśli wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia, ikona .

Jeśli wszystkie działania wymagane dla bieżącego kroku zostały wykonane, ale przed rozpoczęciem kolejnego etapu wymagany jest okres oczekiwania, symbol zaznaczenia lub ikona są szare. Pozostają takie aż do rozpoczęcia kolejnego kroku, kiedy to zmieniają kolor na normalny.

Zdarzenia, jakie wystąpiły podczas przebiegu można przeglądać, klikając prawym przyciskiem myszy listę kroków i wybierając opcję **Run events** (zdarzenia podczas przebiegu) z menu podręcznego. Z poziomu menu podręcznego można wyświetlić również okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka).

## 5.3 Ekran konserwacji

Aby wyświetlić ekran **Maintenance** (konserwacja), przejść do ekranu **System status** (stan systemu) i kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja).

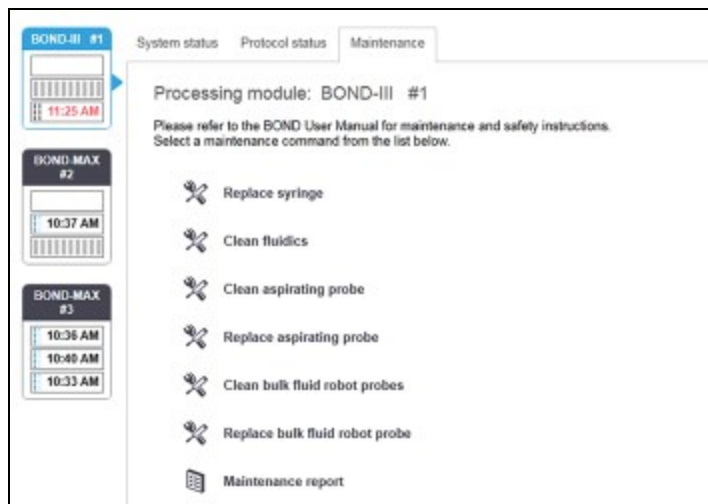

Postać 5-21: Ekran **Maintenance** (konserwacja) zawiera przyciski poleceń dla różnych zadań konserwacyjnych:

Polecenie	Opis
Replace syringe (wymień strzykawkę)	Sterowanie modulem przetwarzania podczas wymiany strzykawki lub strzykawek. Zob. <a href="#">12.13 - Strzykawki</a> .
Clean fluidics (wyczyść układ płynów)	Zalanie układu płynów. Zob. <a href="#">Czyszczenie układu płynów on page 279</a> .
Clean aspirating probe (wyczyść sondę aspiracyjną)	Czyszczenie sondy aspiracyjnej za pomocą systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System. Zob. <a href="#">12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej</a> .
Replace aspirating probe (wymień sondę aspiracyjną)	Sterowanie modulem przetwarzania podczas wymiany sondy aspiracyjnej. Zob. <a href="#">12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej</a> .
Clean bulk fluid robot probes (wyczyść sondy robota odczynników zbiorczych)	Przemieszczanie robotów odczynników zbiorczych (tylko BOND-III) do położenia czyszczenia sond. Zob. <a href="#">12.12.1 - Czyszczenie sond robota odczynników zbiorczych</a> .
Replace bulk fluid robot probes (wymień sondy robota odczynników zbiorczych)	Przemieszczanie robotów odczynników zbiorczych (tylko BOND-III) do położenia wymiany sond. Zob. <a href="#">12.12.2 - Wymiana sond robota odczynników zbiorczych</a> .
Maintenance report (raport dot. konserwacji)	Generowanie raportu dotyczącego konserwacji wybranego modułu przetwarzania. To polecenie jest zawsze dostępne. Zob. <a href="#">5.3.1 - Raport dot. konserwacji</a> .

Na ekranie **Maintenance** (konserwacja) wyświetlane są nazwa aktualnie wybranego modułu przetwarzania oraz powiązane przyciski poleceń konserwacji. Instrukcje wykonania wybranego zadania konserwacyjnego są wyświetlane w postaci serii okien dialogowych.

Jeśli dane zadanie konserwacyjne jest niedostępne, na przykład gdy konserwacja jest już w toku, przycisk polecenia jest wyłączony. Gdy dany moduł przetwarzania jest odłączony, wszystkie przyciski poleceń (z wyjątkiem przycisku **Maintenance report** (raport dot. konserwacji)) są niedostępne.

### 5.3.1 Raport dot. konserwacji

Raport dot. konserwacji zawiera informacje dotyczące określonego modułu przetwarzania z wybranego przedziału czasowego.

1. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
2. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie kliknąć przycisk **Maintenance report** (raport dot. konserwacji).

Postać 5-22: Okno dialogowe raportu dot. konserwacji

Wybrać moduł przetwarzania z listy rozwijanej, a następnie w polach **From** (od) oraz **To** (do) ustawić żądany przedział czasowy. Można też kliknąć opcję **Last twelve months** (ostatnie dwanaście miesięcy), aby ustawić taki przedział czasowy.

Kliknąć **Generate** (generuj), aby wygenerować raport dot. konserwacji.



Raport zostanie wyświetlony w nowym oknie. W prawym górnym rogu raportu znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
Placówka	Nazwa placówki wprowadzona w polu <b>Facility</b> (placówka) na ekranie <b>Laboratory settings</b> (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego – zob. <a href="#">10.5.1 - Ustawienia laboratorium</a>
Przedział czasu	Daty „Od” i „Do” okresu ujętego w raporcie
Moduł przetwarzania	Unikatowa nazwa modułu przetwarzania wprowadzona w polu <b>Name</b> (nazwa) na ekranie <b>Hardware configuration</b> (konfiguracja urządzenia) klienta administracyjnego – zob. <a href="#">10.6.1 - Processing Modules (moduły przetwarzania)</a>
Numer seryjny modułu przetwarzania	Unikalny numer seryjny modułu przetwarzania

Poniżej opisano dotyczące raportu kwestie, na które należy zwrócić uwagę:

- Nad ikoną modułu przetwarzania na ekranie stanu systemu pojawi się ikona informacyjna (jak opisano w części [5.1.2 - Status urządzenia](#)) z wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy powiadomieniem o konieczności przeprowadzenia wymaganych czynności konserwacyjnych (szacowana data zostanie wyświetlona z komunikatem „Due now” (teraz)).
- Szacowane daty kolejnych działań konserwacyjnych są obliczane na podstawie liczby przetwarzanych szkiełek i/lub zalecanego okresu pomiędzy działaniami.
- Jeśli w danym okresie ujętym w raporcie nie wystąpiły żadne zdarzenia, zamiast tabeli historii pojawi się komunikat informujący o braku zdarzeń.
- Pierwsza data w tabeli historii to początek okresu objętego raportem lub data oddania modułu przetwarzania do eksploatacji, jeśli data ta jest późniejsza. Wartości w powiązanych kolumnach „Slides since last maintenance/replacement” (szkiełka przetworzone od ostatniej konserwacji/wymiany) zawsze wskazują 0 szkiełek.
- Ostatnia data w tabeli historii to koniec okresu objętego raportem.
- Każdy zespół barwienia szkiełek posiada osobny licznik szkiełek, dostępny jest również łączny licznik szkiełek dla wszystkich 3 zespołów. Licznik szkiełek jest resetowany do wartości 0 po każdym zakończonym działaniu konserwacyjnym.
- Do każdej sondy robota odczytników zbiorczych w zespole barwienia szkiełek przypisany jest osobny licznik szkiełek.
- Do każdej strzykawki zespołu barwienia szkiełek przypisany jest osobny licznik szkiełek.
- Do strzykawki głównej przypisany jest osobny licznik szkiełek.
- W przypadku systemu BOND w wersji 5.0 lub wcześniej w kolumnie „Completion status” (status ukończenia) zakończonych czynności konserwacyjnych może być wyświetlany komunikat „Unknown” (nieznany).
- W przypadku systemu BOND w wersji 4.0 lub wcześniej zakończone czynności konserwacyjne nie są wyświetlane.



# 6. Konfiguracja szkiełek (kontroler BOND )

Standardowy przebieg pracy w przypadku tworzenia szkiełek do przetwarzania przez system BOND obejmuje następujące podstawowe kroki:

1. Przygotowanie skrawków na szkiełkach.
2. Utworzenie przypadku dla szkiełek w oprogramowaniu BOND (lub zaimportowanie przypadku z systemu LIS).
3. Dodanie lub edytowanie szczegółów lekarza, jeśli jest to konieczne.
4. Wprowadzenie szczegółów szkiełek (lub ich importowanie z systemu LIS).
5. Utworzenie szkiełek kontrolnych zgodnie ze standardowymi praktykami laboratorium.
6. Naklejenie etykiet na szkiełka (chyba że zostały już oznaczone etykietami LIS).
7. Załadowanie szkiełek na tace na szkiełka i umieszczenie tac w module przetwarzania.

Po rozpoczęciu przetwarzania szkiełek, z poziomu ekranu **Slide history** (historia szkiełek) można wygenerować raporty dotyczące szkiełek, przypadków i przebiegów. Więcej szczegółów znajduje się w części [9 - Historia szkiełek \(kontroler BOND \)](#).

Jeśli standardowy przebieg pracy nie jest zgodny ze standardami stosowanymi w danym laboratorium, dostępne są alternatywne przebiegi pracy.

Ten rozdział zawiera następujące części:

- [6.1 - Ekran konfiguracji szkiełek](#)
- [6.2 - Praca z próbkami kontrolnymi](#)
- [6.3 - Praca z przypadkami](#)
- [6.4 - Zarządzanie lekarzami](#)
- [6.5 - Praca ze szkiełkami](#)
- [6.6 - Etykietowanie szkiełek](#)
- [6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkiełka](#)
- [6.8 - Ręczne tworzenie slajdów i przypadków](#)
- [6.9 - Zgodność szkiełek](#)

## 6.1 Ekran konfiguracji szkiełek

Na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) wyświetlane są przypadki i szkiełka wprowadzone do systemu BOND, ale jeszcze nieprzetworzone. W przypadku systemów zintegrowanych z systemem LIS ekran ten zawiera przypadki i szkiełka zaimportowane z systemu LIS. W przypadku systemów innych niż LIS ekran ten pozwala tworzyć i – w razie potrzeby – edytować przypadki i szkiełka. Szkiełka muszą być przypisane do przypadku, dlatego należy utworzyć przypadek przed utworzeniem szkiełek.

Aby wyświetlić ekran **Slide setup** (konfiguracja szkiełek), kliknąć przycisk **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) na pasku funkcji.

Slide setup



**Slide setup**

Buttons: Add case, Edit case, Delete case, Copy case

Case ID	Patient name	Doctor name	Slides
LS0012 - 45216	Shady, Albert	Joseph	1
20130416-ISHRefine	Benjamin Hightower	Kevin Pannell	10
20130416-IHC	Fannie Hurley	Arthur Josey	10
20130402-IHC5	Adam Smith	Kevin Pannell	10
CS104 - 254862	Ann Chovey	Cecilia Hoy	12
CS145 - 254789 1A	Olive Yew	Kevin Pannell	5
CS160 - 254719	Liz Erd	Thomas Matthews	1
CS154 - 255789	Ray O'Sun	Debbie Hanrahan	3
CS204 - 255789 4B	Clark Kent	Suzanne Rhinehart	3
CS205 - 255790	Chris P. Bacon	Arthur Josey	1
CS205 - 255791	Marsha Mellow	Nicholas Monahan	10
CS205 - 255792	Suzzan Max	Nicholas Monahan	10
CS211 - 256091	Zaone Marshall	Deanna Hayman	7
CS101 - 252401	Sally Faulkner	Jacob Glaser	3
CS102 - 252413	James Donovan	Jacob Glaser	1
LS0012 - 45214	Barb, Akew	Jenny	1
CS3201 - 527890	Reeve Ewer	Jack Browne	11
CS3201 - 527891	Theresa Brown	Jack Browne	14
CS3201 - 527892	Tex Ryta	Arthur Josey	11

Positive tissue controls: 21  
Negative tissue controls: 25

Total cases: 28  
Total slides: 143

Buttons: Case report, Slide setup summary, Print labels

Slide configuration panel (Slide 1):

Buttons: Add slide, Add panel

1. 00000198  
"QIFAP"  
"MIC P" "D" "..." "C120"

Postać 6-1: Ekran **Slide setup** (konfiguracja szkiełek)

[Postać 6-1](#) przedstawia ekran **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Prawa górna część ekranu zawiera polecenia do pracy z przypadkami, zaś po prawej stronie ekranu znajdują się funkcje do obsługi szkiełek.

## 6.2 Praca z próbkami kontrolnymi

Leica Biosystems zaleca rutynowe sprawdzanie działania systemu BOND przy użyciu próbek kontrolnych. Niektóre systemy teranostyczne zawierają własne szkiełka z próbkami kontrolnymi, jednak w instrukcji systemu może być zalecane użycie dodatkowych próbek kontrolnych specyficznych dla laboratorium. Należy pamiętać, że próbki kontrolne powinny umożliwiać przeprowadzenie testu całego procesu. Więcej informacji znajduje się w części [14.3 - Kontrola jakości](#).



Aby jak najdokładniej sprawdzić wydajność systemu BOND, firma Leica Biosystems zdecydowanie zaleca umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tym samym szkiełku, co tkanka pacjenta.

Mimo że najbardziej zalecanym sposobem kontroli jest umieszczenie tkanki kontrolnej obok tkanki testowej, oprogramowanie BOND dopuszcza używanie szkiełek zawierających tylko tkankę kontrolną i odczynniki kontrolne. Należy zadbać o to, aby szkiełka z tkankami kontrolnymi były dobrze oznaczone, aby uniknąć pomyłek z próbkami pobranymi od pacjentów.

### 6.2.1 Tkanka kontrolna

Każde szkiełko musi zostać wprowadzone do oprogramowania BOND jako zawierające jeden z następujących typów tkanek:

- Tkanka testowa
- Tkanka ujemna
- Tkanka dodatnia

Typ tkanki ustawia się w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)). Każde szkiełko zawierające przeznaczoną do badania tkankę pacjenta powinno być ustawione jako „tkanka testowa”. Szkiełka zawierające tylko tkankę kontrolną należy konfigurować wyłącznie jako próbki kontrolne „Positive tissue” (tkanka dodatnia) i „Negative tissue” (tkanka ujemna).

W przypadku zmiany typu tkanki dla nowego szkiełka w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) pole **Marker** jest automatycznie czyszczone, co pozwala zapewnić, że dla tkanki wybrano właściwy marker.

Szkiełka zawierające tkankę dodatnią lub ujemną są oznaczone odpowiednio symbolem „+” lub „-” na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Na ekranie **Slide history** (historia szkiełek) w kolumnie **Type** (typ) dla każdego szkiełka wyświetlane jest oznaczenie „Test” (testowa), „Negative” (ujemna) lub „Positive” (dodatnia).

Aby szkiełka były wyraźnie oznaczone jako kontrolne, domyślnie szablon etykiet szkiełek zawiera pole „Tissue type” (typ tkanki). Wówczas na etykietach szkiełek kontrolnych z tkanką dodatnią drukowany jest duży znak „(+)”, a na etykietach szkiełek kontrolnych z tkanką ujemną – duży znak „(-)”. W przypadku tkanki testowej pole jest pozostawiane puste. Zalecamy, aby pole to znajdował się na każdej skonfigurowanej etykietce szkiełka (zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)).

### 6.2.2 Odczynnik kontrolny

Szkiełka można skonfigurować jako szkiełka z odczynnikiem kontrolnym – podczas konfiguracji należy wówczas zamiast standardowych przeciwciał lub sond jako marker wybrać odpowiedni odczynnik.

W przypadku IHC oprogramowanie BOND zawiera opcję ujemnego odczynnika kontrolnego. W oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) wybrać IHC, po czym z listy rozwijanej **Marker** wybrać opcję **\*Negative** (\*ujemny). Do wykonania odpowiednich kroków oprogramowanie BOND użyje roztworu BOND Wash Solution.

W przypadku badań ISH BOND oprogramowanie uwzględni ujemne i dodatnie odczynniki kontrolne dla RNA i DNA. Wybrać odpowiednią sondę kontrolną z listy **Marker**.

Szkiełka z odczynnikiem kontrolnym nie posiadają specjalnych oznaczeń innych niż nazwa markera przedstawiona na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) i na etykiecie szkiełka, jeżeli pole markera jest uwzględnione w odpowiednim szablonie etykiety szkiełka.

### 6.3 Praca z przypadkami

W tej części opisano dostępne po lewej stronie ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) funkcje umożliwiające pracę z przypadkami. Części znajdujące się za częścią opisową przedstawiają procedury dodawania, edytowania i usuwania szczegółów przypadków.

Dalsze części:

- [6.3.1 - Elementy sterujące dla przypadku i informacje o aktywnym przypadku](#)
- [6.3.2 - Identyfikator przypadku](#)
- [6.3.3 - Dodawanie przypadku](#)
- [6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku](#)
- [6.3.5 - Edytowanie przypadku](#)
- [6.3.6 - Kopiowanie przypadku](#)
- [6.3.7 - Opcja przypadku dziennego](#)
- [6.3.8 - Raport dla przypadku](#)

#### 6.3.1 Elementy sterujące dla przypadku i informacje o aktywnym przypadku

Kliknąć **Add case** (dodaj przypadek), aby dodać szczegóły nowego przypadku.  
Proces opisano w części [6.3.3 - Dodawanie przypadku](#).

Kliknąć **Edit case** (edytuj przypadek), aby edytować szczegóły istniejącego przypadku.  
Proces opisano w części [6.3.5 - Edytowanie przypadku](#).

Kliknąć **Delete case** (usuń przypadek), aby usunąć istniejący przypadek.  
Sposób usuwania przypadków opisano w części [6.3.5.1 - Usuwanie przypadku](#).

Kliknąć **Copy case** (kopiuj przypadek), aby dodać kopię przypadku i szkiełek do tego przypadku.  
Sposób kopiowania przypadku opisano w części [6.3.6 - Kopiowanie przypadku](#).

Polecenia **Edit** (edytuj), **Delete** (usuń) i **Copy** (kopiuj) są dostępne również w menu podręcznym wyświetlanym po kliknięciu przypadku prawym przyciskiem myszy.

Kliknąć **Case report** (raport dla przypadku) (poniżej listy przypadków), aby wyświetlić raport dla wybranego przypadku (zob. [6.3.8 - Raport dla przypadku](#)).

W tabeli poniżej przycisków znajdują się następujące informacje dotyczące aktywnego przypadku:

Case ID (ID przypadku)	Identyfikator przypadku. Może zawierać dowolne znaki alfanumeryczne. Ponieważ pole to może zawierać litery i cyfry, kliknięcie nagłówka kolumny „Case ID” (ID przypadku) powoduje sortowanie tej kolumny jako tekstu – identyfikator zaczynający się od „10” zostanie umieszczony przed identyfikatorem rozpoczynającym się od „2”.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patient name (imię i nazwisko pacjenta)	Identyfikacja pacjenta.
Doctor name (imię i nazwisko lekarza)	Imię i nazwisko lekarza lub patologa opiekującego się pacjentem.
Slides (szkiełka)	Liczba nietworzonych szkiełek skonfigurowanych dla wybranego przypadku.  Po rozpoczęciu przetwarzania szkiełka są przenoszone z ekranu <b>Slide setup</b> (konfiguracja szkiełek) do ekranu <b>Slide history</b> (historia szkiełek), zaś wartość liczbowa jest odpowiednio aktualizowana.

Przypadek z czerwonym paskiem po lewej stronie wskazuje, że zawiera on jedno lub więcej priorytetowych szkiełek LIS (zob. [11.2.5 - Szkiełka priorytetowe](#)).

Poniżej listy aktywnych przypadków znajduje się podsumowanie wszystkich przypadków i szkiełek:

Positive tissue controls (kontrolne tkanki dodatnie)	Całkowita liczba kontrolnych tkanek dodatnich dla wszystkich aktualnie wprowadzonych przypadków, dla których nie uruchomiono jeszcze przebiegu.
Negative tissue controls (kontrolne tkanki ujemne)	Całkowita liczba kontrolnych tkanek ujemnych dla wszystkich aktualnie wprowadzonych przypadków, dla których nie uruchomiono jeszcze przebiegu.
Total cases (łączna liczba przypadków)	Łączna liczba aktywnych przypadków.
Total slides (łączna liczba szkiełek)	Całkowita liczba szkiełek dla wszystkich aktualnie wprowadzonych przypadków, dla których nie uruchomiono jeszcze przebiegu.

## 6.3.2 Identyfikator przypadku

System BOND wykorzystuje dwa podstawowe identyfikatory przypadku: ID przypadku i numer przypadku (odpowiednio opcje **Case ID** (ID przypadku) oraz **Case No.** (nr przypadku) w oprogramowaniu).

- **Case ID** (ID przypadku): identyfikator przypadku wprowadzony przez użytkownika, zgodny ze standardem identyfikacji stosowanym w laboratorium. Dla przypadków utworzonych w systemie BOND ID przypadku wprowadza się w oknie dialogowym **Add case** (dodaj przypadek) podczas tworzenia przypadku. W systemach LIS-ip ID przypadku jest odbierane z LIS (gdzie może być nazywane „numerem dostępu” lub jeszcze inaczej).
- **Case No.** (nr przypadku): unikalny numer identyfikacyjny, który system BOND automatycznie przypisuje każdemu przypadkowi w systemie (zarówno przypadkom utworzonym w systemie BOND, jak i tym pobranym z systemu LIS). Numer przypadku jest wyświetlany w oknie dialogowym **Case properties** (właściwości przypadku).

W oprogramowaniu BOND w wersji starszej niż 4.1 nie było wymogu, aby ID przypadków były niepowtarzalne, więc możliwe było utworzenie dwóch lub większej liczby odrębnych przypadków posiadających to samo ID przypadku. Przypadki te różniły się jednak imionami i nazwiskami pacjentów i z pewnością miały różne numery przypadków. W oprogramowaniu BOND w wersji 4.1 lub nowszej wszystkie nowe ID przypadku muszą być unikatowe.

Przypadki są również często identyfikowane na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, jednak nazwiska pacjentów nie są wymagane i nie muszą być unikatowe.

## 6.3.3 Dodawanie przypadku

Aby dodać przypadek, przejść do ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) i wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć przycisk **Add case** (dodaj przypadek) na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek), aby wyświetlić okno dialogowe **Add case** (dodaj przypadek) (zob. [Figure 6-2](#)).

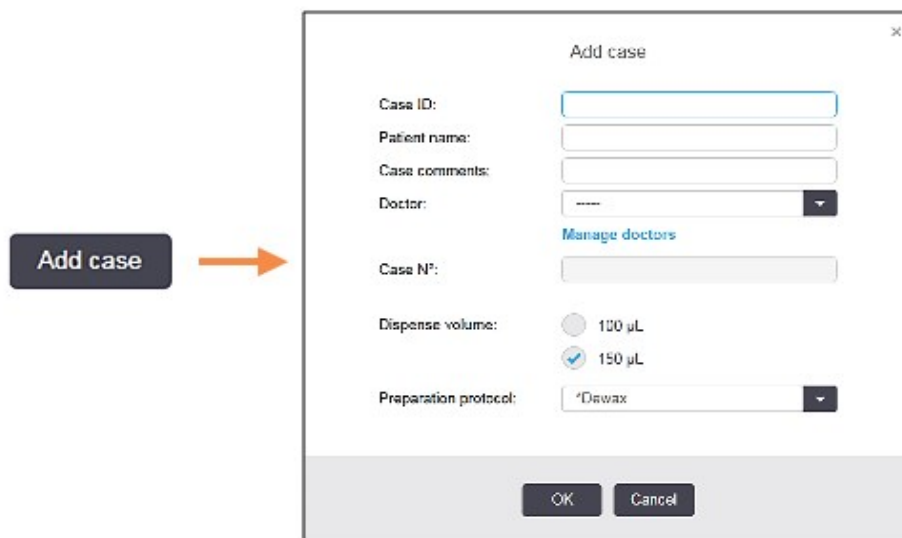


Figure 6-2: Okno dialogowe **Add case** (dodaj przypadek)

Wprowadzić szczegóły w polach „Case ID” (ID przypadku), „Patient name” (imię i nazwisko pacjenta), „Case comments” (komentarze do przypadku) i „Doctor” (lekarz).

 Możliwe jest dodawanie przypadków bez żadnych informacji o przypadku.

2. Jeśli wymagany lekarz nie znajduje się na liście lekarzy, należy go dodać, klikając opcję **Manage doctors** (zarządzaj lekarzami). Zostanie otwarte okno dialogowe **Manage doctors** (zarządzaj lekarzami) (zob. [6.4 - Zarządzanie lekarzami](#)).
3. Ustawić objętość dozowania dla szkiełek utworzonych dla tego przypadku, jeśli nie jest ona taka sama jak skonfigurowana domyślna objętość dozowania.  
Należy pamiętać, że wszystkie szkiełka przetwarzane przez urządzenie BOND wymagają objętości dozowania rzędu 150 µl. Ponadto do barwienia ISH wszystkie typy modułów przetwarzania wymagają objętości dozowania wynoszącej 150 µl.  
  
Informacje na temat zdatnych do użycia obszarów szkiełek i objętości dozowania znajdują się w części [6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach](#).
4. Z listy **Preparation protocol** (protokół przygotowywania) wybrać domyślny sposób przygotowywania szkiełek (zob. [Figure 6-2](#)) dla tego przypadku.
5. Aby opuścić okno dialogowe bez wprowadzania szczegółów do systemu, kliknąć przycisk **Cancel** (anuluj).  
Aby wprowadzić szczegóły przypadku, kliknąć **OK**.
6. Przypadek zostanie dodany do listy przypadków.

 Jeśli ID przypadku już istnieje w systemie, otwarte zostanie okno dialogowe **Case ID duplication** (powielanie ID przypadku) (zob. [6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku](#)).

### 6.3.4 Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku

W wersjach oprogramowania BOND wcześniejszych niż 4.1 różne przypadki mogą mieć takie samo ID przypadku. Takie przypadki są rozróżniane z reguły na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, i zawsze na podstawie numeru przypadku, który zawsze jest unikalny. System BOND nie pozwala już na tworzenie nowych przypadków z takim samym ID przypadku co istniejące przypadki – każdy nowy przypadek musi mieć unikatowy identyfikator lub zostać zidentyfikowany jako przypadek już istniejący w systemie.


W momencie wprowadzenia przypadku o ID przypadku znajdującym się już w systemie wyświetlone zostanie okno dialogowe **Case ID duplication** (powielanie ID przypadku) wskazujące istniejący przypadek o tym samym ID. Aby użyć istniejącego przypadku, zaznaczyć go i kliknąć **Use selected** (użyj wybranego przypadku) (zob. także [Scalanie przypadków on page 122](#)). W przeciwnym razie anulować okno dialogowe i zmienić ID przypadku, aby utworzyć przypadek jako nowy.

Przypadki w oknie dialogowym **Case ID duplication** (powielanie ID przypadku) mogą być usunięte, przeterminowane (tj. przypadki, dla których przetwarzanie wszystkich szkiełek zostało zakończone – zob. poniżej) lub mogą nadal być obecne na liście na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Przypadek, którego termin ważności upłynął, umieszczony z powrotem na liście aktywnych przypadków jest nazywany przypadkiem „przywróconym”.

Omówienie zduplikowanych ID przypadków dla przypadków LIS znajduje się w części [Duplicate Case ID \(zduplikowane ID przypadku\) on page 211](#).

#### 6.3.4.1 Scalanie przypadków

W przypadku edycji ID przypadku, aby było takie samo jak ID istniejącego przypadku, kliknąć opcję **Use selected** (użyj wybranego przypadku) w wyświetlonym oknie dialogowym **Case ID duplication** (powielanie ID przypadku), w którym wszystkie nieprzetworzone szkiełka z edytowanego przypadku zostaną przeniesione do istniejącego przypadku.


-  Edytować można tylko przypadek, który zawiera wyłącznie nieprzetworzone szkiełka; w związku z tym zmiana przypadku zawierającego przetworzone szkiełka nie jest możliwa.

#### 6.3.4.2 Czas wyświetlania przetworzonego przypadku

Po zakończeniu przetwarzania ostatniego szkiełka w danym przypadku przypadek jest (domyślnie) usuwany z ekranu konfiguracji szkiełek w ciągu 10 minut od odblokowania tacy na szkiełka.

System BOND można skonfigurować tak, aby zachowywał przypadki na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) przez kilka dni od zakończenia przetwarzania ostatniego szkiełka z danego przypadku. „Czas wyświetlania przetworzonego przypadku” ustawia się na ekranie **Laboratory** (laboratorium) klienta administracyjnego (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)).


Przypadki, których termin ważności upłynął, są przechowywane w systemie, ale nie można ich przeglądać. Przypadki te można przywrócić na listę, dodając je ponownie lub dodając do nich szkiełko z poziomu systemu LIS.

-  Przypadki, które nie zawierają żadnych przetworzonych szkiełek, nigdy nie są automatycznie usuwane z ekranu konfiguracji szkiełek.






## 6.3.5 Edytowanie przypadku

Aby edytować szczegóły przypadku, zaznaczyć go na liście, a następnie kliknąć opcję **Edit case** (edytuj przypadek). Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Case properties** (właściwości przypadku). Z okna tego korzysta się tak samo jak z opisanego wcześniej okna **Add case** (dodaj przypadek).

-  W razie edycji szczegółów przypadku, dla którego wydrukowano etykiety szkiełek, przed rozpoczęciem przebiegu należy ponownie wydrukować etykiety (na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat).


### 6.3.5.1 Usuwanie przypadku

Aby usunąć przypadek, zaznaczyć go na liście, a następnie kliknąć opcję **Delete case** (usuń przypadek).

-  Jeśli przypadek BOND na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) zawiera tylko nieprzetworzone szkiełka, można go ręcznie usunąć, ustawiając jako przypadek, którego „termin ważności upłynął”. (Wszystkie przypadki LIS tracą ważność automatycznie, jak tylko przestają zawierać nieprzetworzone szkiełka).
-  Jeśli przypadek zawiera jakiegokolwiek przetworzone lub przetwarzane szkiełka, nie da się go usunąć ręcznie.
-  Usunięcie przypadku powoduje również usunięcie wszystkich nieprzetworzonych szkiełek utworzonych dla tego przypadku. Odzyskać można szczegóły usuniętych przypadków, ale nie szkiełka.

## 6.3.6 Kopiowanie przypadku

Funkcja kopiowania przypadków ułatwia konfigurowanie nowego przypadku dla pacjenta. Szczegóły przypadku można zmienić lub zachować. Nowy numer przypadku jest tworzony automatycznie, niemniej nowe ID przypadku należy wprowadzić ręcznie.

-  Przypadku nie można skopiować, jeśli zawiera szkiełko, do którego przypisano usunięty protokół.

Skopiowane szkiełka są gotowe do nadrukowania etykiet i rozpoczęcia przetwarzania na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Niechciane szkiełka można usunąć, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję **Delete slide** (usuń szkiełko).

Aby skopiować przypadek:

1. Wybrać przypadek do skopiowania z listy przypadków po lewej stronie ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek).
2. Kliknąć opcję **Copy case** (kopiuj przypadek); oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Copy case** (kopiuj przypadek).
3. Wprowadzić nowe ID przypadku i w razie potrzeby edytować szczegóły przypadku.
4. Jeśli to konieczne, zaznaczyć opcję **Unprocessed slides** (nieprzetworzone szkiełka) lub **All slides** (wszystkie szkiełka).
  - Unprocessed slides (nieprzetworzone szkiełka) – kopiowane są tylko nieprzetworzone szkiełka z oryginalnego przypadku.
  - All slides (wszystkie szkiełka) – kopiowane są wszystkie szkiełka (nieprzetworzone, przetwarzane i przetwarzane) z oryginalnego przypadku. System oznaczy wszystkie szkiełka w nowym przypadku jako nieprzetworzone.

### 5. Kliknąć **OK**.

System utworzy nowy przypadek i skopiuje szkiełka, w tym wszelkie komentarze, zgodnie z wybraną opcją. Wszystkie skopiowane szkiełka (w tym LIS) są obsługiwane w taki sam sposób, jak szkiełka utworzone w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) (zob. [6.5.1 - Opis pól i elementów sterujących dla szkiełek](#)).

### 6.3.7 Opcja przypadku dziennego

System BOND można skonfigurować tak, aby automatycznie tworzył nowy przypadek co 24 godziny – wówczas wszystkie szkiełka utworzone danego dnia będą przypisane do jednego, tego samego przypadku. Pozwala to zaoszczędzić czas laboratoriom przetwarzającym małe liczby szkiełek, ponieważ eliminuje konieczność wprowadzania imion i nazwisk pacjentów oraz ID przypadków. Każdy przypadek dzienny ma następujące właściwości:

- ID przypadku przyjmuje bieżącą datę.
- Objętość dozowania i protokół przygotowania są ustawiane na domyślne wartości ustawione w kliencie administracyjnym. Ustawienia te można edytować.
- Pola **Patient name** (imię i nazwisko pacjenta) oraz **Doctor** (lekarz) pozostają puste i nie można ich zmienić.

W razie potrzeby nadal można utworzyć indywidualny przypadek mimo włączonej opcji przypadku dziennego. Instrukcje konfiguracji opcji przypadku dziennego znajdują się w części [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#).

### 6.3.8 Raport dla przypadku

Dla każdego przypadku można wygenerować osobny raport. Raporty przedstawiają podstawowe szczegóły przypadku i informacje na temat wszystkich szkiełek dla danego przypadku, np. ID szkiełek oraz zastosowane protokoły i odczynniki. Jeśli raport jest drukowany, zawiera miejsce na wpisanie komentarza dla każdego szkiełka. Pełny opis znajduje się w części [9.6 - Raport dla przypadku](#).

Raporty dla przypadków można generować z poziomu ekranów **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) oraz **Slide history** (historia szkiełek). Wybrać żądany przypadek lub szkiełko i kliknąć przycisk **Case report** (raport dla przypadku). Raporty dla przypadków obejmują szczegóły odczynników tylko tych szkiełek, które zostały przetworzone i odblokowane w module przetwarzania.

## 6.4 Zarządzanie lekarzami

System BOND przechowuje listę lekarzy, których opcjonalnie można dodać do szczegółów przypadku. W tym celu należy wybrać lekarza z listy „preferowanych” lekarzy w oknie dialogowym **Add case** (dodaj przypadek) lub **Case properties** (właściwości przypadku) lub dodać/edytować lekarza w oknie **Manage doctors** (zarządzaj lekarzami) otwieranym z poziomu okna dialogowego właściwości przypadku.

Dla każdego lekarza wyświetlane są następujące pola:

- Name (imię i nazwisko): – imię i nazwisko lekarza.
- LIS ID (ID LIS): – unikalny identyfikator dostarczony przez system informatyczny laboratorium (jeśli dotyczy).
- Pref. (preferowany): – status „preferowany” lekarza (na liście rozwijanej podczas tworzenia przypadku dostępni są tylko lekarze preferowani). Ten status ustawia się w oknie dialogowym **Edit doctor** (edytuj lekarza).

Pola te są również wyświetlane w oknie dialogowym **Edit doctor** (edytuj lekarza). Dodatkowo okno dialogowe **Edit doctor** (edytuj lekarza) zawiera następujące pola:

- ID: – unikalne ID generowane automatycznie i przypisywane przez system BOND.
- Comments (komentarze): – pole edytowalne umożliwiające dodanie ogólnego komentarza lub dodatkowych informacji o nazwisku.

W otwartym oknie dialogowym **Manage doctors** (zarządzaj lekarzami) kliknąć opcję **Add** (dodaj) lub **Edit** (edytuj), aby dodać nowych lub edytować szczegóły istniejących lekarzy. Edycji podlegają wyłącznie pola komentarzy i preferowanego statusu – po utworzeniu lekarza zmiana jego nazwiska nie jest możliwa.

Okno dialogowe **Manage doctors** (zarządzaj lekarzami) pozwala również na usuwanie lekarzy. Przypadki już utworzone z przypisanym usuniętym lekarzem nadal pokazują imię i nazwisko lekarza, ale lekarz ten nie jest dostępny do wyboru dla nowych przypadków. Imienia i nazwiska usuniętego lekarza nie można ponownie użyć do utworzenia nowego lekarza.

## 6.5 Praca ze szkiełkami

W tej części opisano sposoby tworzenia szkiełek i zarządzania nimi z poziomu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). W ostatniej części opisano ustawienia objętości dozowania i wpływ tej objętości na rozmieszczenie tkanek na szkiełkach.

- [6.5.1 - Opis pól i elementów sterujących dla szkiełek](#)
- [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)
- [6.5.3 - Kopiowanie szkiełek](#)
- [6.5.4 - Edytowanie szkiełka](#)
- [6.5.5 - Usuwanie szkiełek](#)
- [6.5.6 - Ręczna identyfikacja szkiełka](#)
- [6.5.7 - Dodawanie panelu szkiełek](#)
- [6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach](#)


## 6.5.1 Opis pól i elementów sterujących dla szkiełek

Na górze listy szkiełek znajdują się dwa przyciski:

- Kliknąć przycisk **Add slide** (dodaj szkiełko), aby dodać szkiełko do wybranego przypadku.
- Kliknąć przycisk **Add panel** (dodaj panel), aby dodać szkiełko do wybranego przypadku.

Więcej informacji znajduje się w części [6.5.7 - Dodawanie panelu szkiełek](#).

Lista szkiełek po prawej stronie ekranu zawiera szczegóły szkiełek dla przypadku wybranego po lewej stronie ekranu. Na każdym szkiełku wyświetlane są ID szkiełka oraz szczegóły protokołów dla przebiegów z wykorzystaniem tego szkiełka. Obszary etykiet po prawej stronie szkiełek są oznaczone kolorami wskazującymi, gdzie szkiełka zostały utworzone:

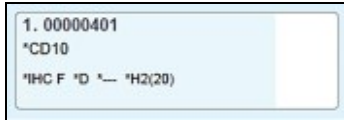

Biały:

szkiełko utworzone oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko)

(zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#))



Żółty:

szkiełko utworzone w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek)

(zob. [6.8 - Ręczne tworzenie slajdów i przypadków](#))



Jasnoszary:

szkiełko LIS

(zob. [11 - Pakiet integracji LIS \(kontroler BOND \)](#))

Szkiełka zawierają również następujące symbole:



Znak minus:

szkiełko z tkanką ujemną (zob. krok 4 w części [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#))



Znak plus:

szkiełko z tkanką dodatnią (zob. krok 4 w części [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#))



Czerwona litera P:

priorytetowe szkiełko LIS (zob. [11.2.5 - Szkiełka priorytetowe](#))



Etykieta próbki:

etykieta nadrukowana na szkiełku

Kliknąć dwukrotnie szkiełko, aby otworzyć okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka). Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby usunąć szkiełko lub wydrukować dla niego etykietę.

## 6.5.2 Tworzenie szkiełek

Sposób tworzenia szkiełek w systemach teranostycznych Leica opisano w instrukcjach dostarczonych z tymi systemami.



Aby utworzyć nowe szkiełko:

1. Kliknąć przypadek na liście przypadków.
2. Kliknąć **Add slide** (dodaj szkiełko), aby wyświetlić okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko).

Figure 6-3: Okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko)

Do nowego szkiełka automatycznie przypisywany jest nowy identyfikator **Slide ID** (ID szkiełka), ale nie jest on wyświetlany do momentu zapisania szkiełka poprzez kliknięcie opcji **Add slide** (dodaj szkiełko) w oknie dialogowym.

3. Jeśli to konieczne, dodać komentarz do szkiełka.
4. Wybrać typ tkanki (tkanka testowa, tkanka ujemna, tkanka dodatnia), klikając jeden z przycisków wyboru pod opcją **Tissue type** (typ tkanki).  
Zob. [6.2.1 - Tkanka kontrolna](#) lub [14.3.2 - Tkanki kontrolne](#), aby uzyskać więcej szczegółów na temat próbek kontrolnych.


5. W razie potrzeby zmienić objętość dozowania dla szkiełka (zob. [6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach](#)).
6. Wybrać tryb barwienia.
  - W pierwszym polu wybrać **Single** (pojedyncze) (ustawienie domyślne), jeśli przeprowadzone ma zostać barwienie pojedyncze, lub **Sequential DS** (sekwencyjne DS) bądź **Parallel DS** (równoczesne DS) (zob. [7.1.1 - Metody barwienia](#)).
  - W drugim polu wybrać **Routine** (rutynowe) (ustawienie domyślne) (opcję **Oracle** wybierać wyłącznie, jeśli jest to wyraźnie wskazane w instrukcji dotyczącej systemu Bond™ Oracle™ HER2 IHC).
7. Wybrać proces barwienia (IHC lub ISH).
8. Wybrać przeciwciało pierwszorzędowe lub sondę z listy rozwijanej **Marker** na karcie **Single** (pojedyncze), jeśli wybrano barwienie pojedyncze, lub na karcie **First** (pierwsze), jeśli wybrano sekwencyjne barwienie podwójne. W przypadku równoczesnego barwienia podwójnego wybrać marker na karcie **Parallel DS** (równoległe DS).  
 Aby rozpocząć przebieg z ujemnym odczynnikiem kontrolnym IHC, wybrać domyślny odczynnik ujemny **\*Negative** (\*ujemny) lub odczynnik ujemny utworzony przez użytkownika (zob. [14.3.3 - Ujemne odczynniki kontrolne do IHC](#)).  
 Aby rozpocząć przebieg z ujemnym odczynnikiem kontrolnym ISH, wybrać „\*RNA Negative Control Probe” (\*ujemna sonda kontrolna RNA) lub „\*DNA Negative Control” (\*ujemna sonda kontrolna DNA).  
 Aby rozpocząć przebieg z dodatnim odczynnikiem kontrolnym ISH, wybrać „\*RNA Positive Control Probe” (\*dodatnia sonda kontrolna RNA) lub „\*DNA Positive Control Probe” (\*dodatnia sonda kontrolna DNA).
-  Aby dodać lub usunąć elementy z listy rozwijanej **Marker**, zaznaczyć lub odznaczyć pole **Preferred** (preferowany) obok danego odczynnika na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników). Więcej informacji znajduje się w części [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#).
9. Wybrać odpowiedni protokół dla każdego etapu przetwarzania.  
 Po wybraniu przeciwciała pierwszorzędowego lub sondy oprogramowanie dobierze protokół domyślny. Sprawdzić, czy dla każdego etapu ustawiono właściwe protokoły i w razie potrzeby wybrać nowy protokół z odpowiedniej listy rozwijanej. Wybrać \*- - - , jeżeli dla danego etapu nie jest wymagany żaden protokół.  
 Domyślne protokoły ustawia się na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników). Zob. [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#).
-  Aby dodać lub usunąć elementy z listy rozwijanej **Protocol** (protokół), zaznaczyć lub odznaczyć pole **Preferred** (preferowany) obok danego protokołu na ekranie **Protocol Setup** (konfiguracja protokołów). Więcej informacji znajduje się w części [7.2.1 - Szczegóły protokołu](#).
10. W przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego kliknąć przycisk **Second** (drugi) i wybrać drugi marker.  
 Taj jak dla pierwszego markera, sprawdzić domyślne protokoły i w razie potrzeby zmienić je.

11. Kliknąć przycisk **Add slide** (dodaj szkiełko).

Naciśnięcie opcji **Add slide** (dodaj szkiełko) powoduje dodanie szkiełka wraz ze szczegółami aktualnie wyświetlanymi w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko), ale nie zamyka okna dialogowego. Ułatwia to szybkie dodanie kilku szkiełek do wybranego przypadku.

12. Kliknąć **Close** (zamknij) po zakończeniu dodawania szkiełek do przypadku.

### 6.5.3 Kopiowanie szkiełek

 Szkiełka nie można skopiować, jeśli przypisano do niego usunięty protokół.


Aby skopiować istniejące szkiełko:

1. Kliknąć dwukrotnie szkiełko, które ma zostać skopiowane, aby otworzyć okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka).
2. Kliknąć opcję **Copy slide** (kopiuj szkiełko).  
Okno dialogowe zmieni się w okno **Add slide** (dodaj szkiełko) z przyciskiem **Add slide** (dodaj szkiełko).
2. Sprawdzić szczegóły szkiełka i zmienić je w razie potrzeby.
3. Kliknąć przycisk **Add slide** (dodaj szkiełko).

Nowe szkiełko, wraz ze wszelkimi komentarzami, zostanie dodane do tego samego przypadku, co skopiowane szkiełko.

### 6.5.4 Edytowanie szkiełka

Aby edytować szczegóły szkiełka z poziomu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek), kliknąć dwukrotnie dane szkiełko, aby otworzyć okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka). Zmienić szczegóły w sposób opisany w części [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#).


 W przypadku edycji szczegółów szkiełka, dla którego etykieta została już wydrukowana, przed rozpoczęciem przetwarzania szkiełka należy ponownie wydrukować etykietę.

### 6.5.5 Usuwanie szkiełek


Aby usunąć szkiełko z listy szkiełek, kliknąć je prawym przyciskiem myszy na liście na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) i z podmenu wybrać opcję **Delete slide** (usuń szkiełko). Do usunięcia zaznaczonego szkiełka można również użyć klawisza Delete.

### 6.5.6 Ręczna identyfikacja szkiełka

Każde szkiełko w systemie BOND można zidentyfikować w dowolnym momencie. Kliknąć ikonę **Search** (szukaj) na pasku funkcji, aby otworzyć okno dialogowe **Manual ID entry** (ręczne wprowadzanie ID).





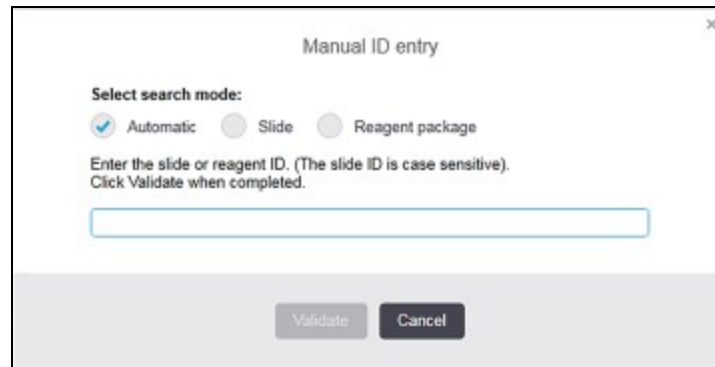

Postać 6-4: Okno dialogowe ręcznego wprowadzania ID

W przypadku szkiełek z etykietami z jedno- lub dwuwymiarowym kodem kreskowym, na przykład drukowanymi przez system BOND, zeskanować etykietę, aby otworzyć okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełka). Można też ręcznie wprowadzić 8-cyfrowy numer ID, w tym wiodące zera, a następnie kliknąć przycisk **Validate** (walidacja).

W przypadku szkiełek alfanumerycznymi ID wpisać w polu czteroznakowy identyfikator szkiełka (pierwsze cztery znaki etykiety z ID), a następnie kliknąć **Validate** (walidacja).

### 6.5.7 Dodawanie panelu szkiełek


Panel to wstępnie zdefiniowany zestaw markerów powiązanych z typami tkanek. Panele służą do szybkiego dodawania szkiełek z powszechnie używanymi wraz z nimi markerami – zob. [8.4 - Ekran paneli odczynników](#).

Aby dodać panel szkiełek do przypadku, z poziomu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć opcję **Add panel** (dodaj panel). Otwarte zostanie okno dialogowe **Add tests from panel** (dodaj testy z panelu).
2. Wybrać panel z listy rozwijanej. Wyświetlone zostaną szkiełka znajdujące się w panelu.
3. W razie potrzeby wykluczyć niektóre szkiełka, odznaczając pola wyboru, a następnie kliknąć przycisk **OK**.

Oprogramowanie BOND doda szkiełka do przypadku.

- W przypadku szkiełek ISH objętość dozowania jest automatycznie ustawiana na 150 µl.
- W przypadku szkiełek IHC objętość dozowania jest ustawiana na wartość domyślną dla przypadku.
- Dla wszystkich szkiełek protokół przygotowania jest ustawiany na domyślny dla przypadku.

 Panele można wykorzystać do dodawania szkiełek w trybach barwienia pojedynczego lub równoczesnego barwienia podwójnego DS, ale nie w trybie sekwencyjnego barwienia podwójnego DS.



### 6.5.8 Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach

Oprogramowanie BOND posiada dwa ustawienia objętości dozowania, ustawiane dla każdego szkiełka w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)). Ustawienie 100 µl może być używane wyłącznie do szkiełek IHC w module przetwarzania BOND-MAX – w przypadku wszystkich szkiełek przetwarzanych w urządzeniu BOND-III i wszystkich szkiełek ISH (w obu typów modułu przetwarzania) należy stosować ustawienie 150 µl.

Ustawienie objętości dozowania określa miejsce, w którym odczynnik jest dozowany na szkiełku, oraz ilość dozowanego odczynnika:

- W przypadku ustawienia 100 µl szkiełka nakrywkowe Covertile są odciągane do tyłu o około pół długości szkiełka, a sonda aspiracyjna dozuje przeciwiata na górną część szkiełek nakrywkowych Covertile (mniej więcej w połowie szkiełka).
- W przypadku ustawienia 150 µl szkiełka nakrywkowe Covertile pokrywają niemal całe szkiełka podstawowe. Ponownie, odczynnik jest dozowany na górną część szkiełek Covertile, dzięki czemu większy obszar szkiełek jest pokryty odczynnikiem.

Różnica w obszarach szkiełek, na które dozowany jest odczynnik sprawia, że prawidłowe umiejscowienie tkanki na szkiełku jest bardzo ważne. Przy objętości 100 µl zazwyczaj barwiona jest tylko jedna próbka, z tego powodu powinna ona być umieszczona na dolnej połowie szkiełka (z dala od etykiety). Przy objętości 150 µl na szkiełku można bez problemu umieścić dwie próbki tkanki; jeśli próbka jest tylko jedna, należy ją umieścić na środku szkiełka. Obszary szkiełka używane przy różnych ustawieniach objętości dozowania przedstawiono na [Postać 6-5](#). Szkiełka Leica BOND Plus posiadają oznaczenie wskazujące obszary, w których należy umieścić tkankę.

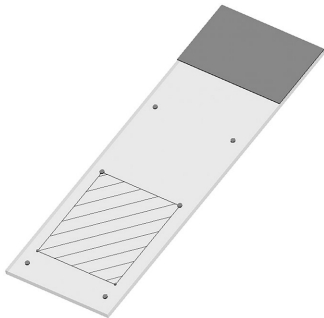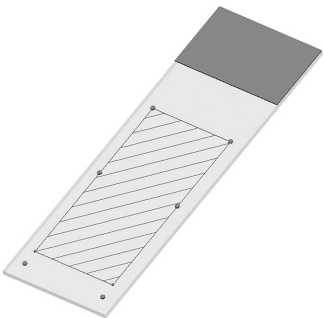	100 µl	150 µl
Obszar użyteczny		

Postać 6-5: Obszary zakreskowane pokazują miejsce umieszczenia tkanki na szkiełkach przy różnych objętościach dozowania.

Na szkiełkach Leica BOND Plus znajdują się kropki oznaczające położenie tkanki (zob. [2.6.1 - Szkiełka](#)).

Moduł przetwarzania BOND dozuje tylko objętość 150 µl – w przypadku załadowania szkiełek przeznaczonych do objętości dozowania 100 µl rozpoczęcie przetwarzania nie będzie możliwe.

Objętości dozowanych przeciwiata dla szkiełek IHC (w urządzeniach BOND-MAX oraz BOND-III) są przedstawione w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) – 100 µl lub 150 µl. Dla szkiełek ISH (w obu urządzeniach) wymuszana jest objętość 150 µl, zaś moduły przetwarzania wykorzystują szkiełka nakrywkowe Covertile 150 µl i pozycje dozowania sond przypisane do tej objętości. Jednak system BOND dozuje więcej niż 150 µl sondy:

- dla sond RNA system BOND dozuje 220 µl w dwóch krokach – 150 µl i 70 µl;
- dla sond DNA system BOND dozuje 240 µl w dwóch krokach – 150 µl i 90 µl.

Na etapach płukania i innych używane są różne objętości dozowania, zależnie od protokołu.

### Domyślne wartości objętości dozowania

W przypadku badania IHC objętość dozowania w urządzeniu BOND-MAX (150 µl lub 100 µl) można ustawić osobno dla każdego szkiełka, jednak oprogramowanie BOND umożliwia skonfigurowanie tylko dwóch poziomów domyślnych. Istnieje również możliwość skonfigurowania ustawienia domyślnego dla całego

systemu (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)). Ustawienie to jest zastępowane domyślnym ustawieniem dla konkretnego przypadku ustawianym w oknie dialogowym **Add case** (dodaj przypadek) (zob. [Dodawanie przypadku \(Section 6.3.3 on page 120\)](#)). Objętość dozowania można też skonfigurować osobno dla poszczególnych szkiełek w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)).

Szkiełka przetwarzane w ramach tego samego przebiegu muszą mieć tę samą objętość dozowania (zob. [6.9 - Zgodność szkiełek](#)).

## 6.6 Etykietowanie szkiełek


Wszystkie szkiełka barwione w systemie BOND muszą posiadać etykiety umożliwiające ich zidentyfikowanie w oprogramowaniu, dzięki czemu system może uruchamiać przebiegi z właściwymi dla tych szkiełek protokołami. Etykiety szkiełek utworzone w systemie BOND zawierają ID (w postaci znaków alfanumerycznych lub kodu kreskowego 1D bądź 2D) używane do automatycznego identyfikowania szkiełek w modułach przetwarzania. Etykiety utworzone w systemie LIS (z ID w postaci kodu kreskowego 1D lub 2D) również mogą być identyfikowane automatycznie. Jednakże etykiety szkiełek powinny zawsze zawierać dodatkowe, czytelne dla człowieka informacje pozwalające zidentyfikować szkiełko, kiedy ID nie mogą zostać automatycznie zidentyfikowane np. z powodu rozmazania (zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)).

Etykiety należy naklejać na szkiełka przed ich załadowaniem do urządzenia. Zadbaj o to, aby etykiety były prawidłowo przyklejone – dzięki temu czytnik ID będzie w stanie prawidłowo je zeskanować (w przypadku kodów kreskowych 1D lub 2D) lub zobrazować (w przypadku ID w postaci alfanumerycznych i, w niektórych sytuacjach, kodów kreskowych).


Jeśli system zawiera drukarkę etykiet do szkiełek BOND, należy używać etykiet dostarczonych przez Leica Biosystems.

- [6.6.1 - Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkiełka](#)
- [6.6.2 - ID szkiełek i ID etykiet](#)

### 6.6.1 Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkiełka

 Aby wydrukować etykietę dla pojedynczego szkiełka, kliknąć szkiełko prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Print label** (drukuj etykietę). W takim przypadku okno dialogowe **Print slide labels** (drukuj etykiety szkiełek) nie zostanie wyświetlone. W systemie BOND-ADVANCE zawierającym zdefiniowane grupy do wydrukowania etykiety użyta zostanie domyślna drukarka etykiet do szkiełek. W innych systemach wybrana zostanie pierwsza drukarka etykiet do szkiełek znajdująca się na liście (zob. [10.6.3 - Slide Labelers \(drukarki etykiet do szkiełek\)](#)).

1. Po skonfigurowaniu wszystkich szkiełek kliknąć opcję **Print labels** (drukuj etykiety) na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek).
2. Określić, czy wydrukowane mają zostać:
  - Wszystkie jeszcze niewydrukowane etykiety szkiełek – drukarka wydrukuje etykiety dla tych szkiełek ze wszystkich przypadków, dla których etykiety nie zostały jeszcze wydrukowane.
  - Wszystkie etykiety szkiełek jeszcze niewydrukowane dla danego przypadku – drukarka wydrukuje etykiety dla tych szkiełek z bieżącego przypadku, dla których etykiety nie zostały jeszcze wydrukowane.
  - Wszystkie etykiety dla bieżącego przypadku – drukarka wydrukuje wszystkie etykiety dla aktualnie wybranego przypadku, w tym już wydrukowane etykiety.

 Etykiety szkiełek są drukowane w kolejności, w jakiej zostały utworzone przypadki, a w obrębie każdego przypadku – w kolejności utworzenia szkiełek.

3. Wybrać drukarkę etykiet do szkiełek.  
(Drukarkę domyślną ustawia się na ekranie **Hardware** (osprzęt) klienta administracyjnego – zob. [10.6.2 - Pods \(grupy\)](#)).

4. Kliknąć opcję **Print** (drukuj).



**i** W trakcie procesu drukowania etykiet w lewym dolnym rogu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) będzie migać odpowiednia ikona.

5. Upewnić się, że matowa powierzchnia szkiełka, gdzie naklejana będzie etykieta, jest całkowicie sucha (wytarcie chusteczką nie jest wystarczające), a następnie nakleić etykietę z ID szkiełka ustawionym równolegle względem krawędzi szkiełka.

6. Etykieta powinna znajdować się po właściwej stronie szkiełka (tej samej, co tkanka, kiedy szkiełko jest przytrzymywane tak, aby etykieta była u góry).

Prawidłowo wyrównać etykietę, ponieważ moduł przetwarzania nie jest w stanie prawidłowo obrazować nieprawidłowo wyrównanych etykiet.



**Prawidłow  
o:**

Etykieta jest prawidłowo wyrównana względem krawędzi szkiełka.



**Nieprawidłow  
o:**

Etykieta nachodzi na krawędzie szkiełka.



**Nieprawidłow  
o:**

Etykieta jest przekrzywiona.

Postać 6-6: Rozmieszczenie etykiety względem krawędzi szkiełka



Wszystkie części etykiety powinny znajdować się w obszarze ograniczonym krawędziami szkiełka. Odstłonięta powierzchnia samoprzylepna może spowodować przywarcie etykiety (i szkiełka) do szkiełka nakrywkowego Covertile lub innego elementu i uszkodzenie szkiełka.

#### 6.6.1.1 Zewnętrzne odparafinowanie i odsłanianie epitopu

Jeśli odparafinowanie i odsłanianie epitopu są wykonywane zewnętrznie, a nie przez system BOND, czynności te najlepiej wykonać po naklejeniu etykiet na szkiełka. Zapobiega to wysychaniu szkiełek podczas wprowadzania szczegółów i konfiguracji systemu BOND przed uruchomieniem wymaganych protokołów i pozwala uniknąć problemów z etykietowaniem mokrych szkiełek.

**i** W przypadku odparafinowania z użyciem ksyłenu poza urządzeniem nie dotykać etykiety, aby jej nie rozmazać. Etykiety można również zabezpieczyć specjalną osłoną BOND.

**i** Wydłużone namaczanie lub wystawienie szkiełka na działanie ksyłenu i/lub wody może zmniejszyć skuteczność kleju do etykiet z ID szkiełek. Zaleca się, aby nie zanurzać etykiet w ksylenie ani wodzie na dłużej niż dziesięć minut. Podczas odparafinowania i odwadniania poza urządzeniem ważne jest, aby poziom odczynnika znajdował się poniżej poziomu etykiety szkiełka.



W urządzeniach BOND-III oraz BOND-MAX używać wyłącznie roztworu BOND Dewax Solution. Nie używać ksyłenu, zamienników ksyłenu ani innych odczynników, które mogą rozkładać części urządzenia i powodować wyciek płynu.

## 6.6.2 ID szkiełek i ID etykiet

System BOND przypisuje unikatowe ID szkiełka do każdego nowo utworzonego **szkiełka**. System BOND tworzy również unikatowe ID etykiety dla każdej wydrukowanej **etykiety szkiełka**.

Z poziomu klienta administracyjnego można określić, czy ID etykiety ma być alfanumeryczne (OCR), czy też stanowić kod kreskowy 1D lub 2D (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)).



W przypadku szkiełek LIS ID szkiełka można zdefiniować w systemie LIS i może być dowolną wartością liczbową (zawierającą 8 cyfr lub mniej).

### 6.6.2.1 ID etykiet z kodem kreskowym

Etykiety z kodem kreskowym zawierają ID składające się z 4 znaków ASCII stanowiących unikatowy identyfikator szkiełka.

### 6.6.2.2 ID etykiet alfanumerycznych

W przypadku etykiet alfanumerycznych pierwsze cztery znaki stanowią unikatowe „ID szkiełka”, które na wydrukowanej etykiecie zawiera dodatkowy trójznakowy przyrostek pomagający zapewnić prawidłową identyfikację szkiełka podczas obrazowania.

### 6.6.2.3 Identyfikacja szkiełek

Po umieszczeniu etykiet na szkiełkach system jest w stanie identyfikować szkiełka na każdej pozycji w zespolach barwienia szkiełek (zob. [5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkiełek](#)).

Szkiełka bez ID lub z nierozpoznanym ID muszą zostać zidentyfikowane ręcznie (zob. [5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#)). Alternatywnie można też na nowo wydrukować i nakleić etykietę na szkiełko i ponownie przeprowadzić obrazowanie.

Informacje, które mają znajdować się na etykietach szkiełek, konfiguruje się na ekranie **Label configuration** (konfiguracja etykiet) klienta administracyjnego (zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)).

## 6.7 Raport dot. podsumowania konfiguracji szkiełka

Podsumowanie konfiguracji szkiełka obejmuje wszystkie szkiełka (ze wszystkich przypadków) skonfigurowane obecnie na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek). Szkiełka są pogrupowane wg przypadków i zawierają szczegóły, takie jak wybrany marker czy objętość dozowania. U dołu raportu znajduje się lista wszystkich odczynników i systemów odczynników dla szkiełek ujętych w raporcie, wraz z liczbą testów dla każdego odczynnika. Listy dla urządzeń BOND-MAX oraz BOND-III są oddzielne.

Raport pomaga przy przygotowywaniu przebiegu. Pozwala zapewnić, że szkiełka umieszczone na każdej tacy są zgodne (zob. [6.9 - Zgodność szkiełek](#)) i wskazuje odczynniki oraz systemy odczynników, które należy załadować.

Aby utworzyć raport dot. konfiguracji szkiełek, kliknąć **Slide setup summary** (podsumowanie konfiguracji szkiełek).

Dla każdego szkiełka raport zawiera poniższe informacje.

Pole	Opis
Slide ID (ID szkiełka)	Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do każdego szkiełka
Marker	Markery
Staining protocol (protokół barwienia)	Protokół barwienia
Preparation (przygotowanie)	Protokół przygotowania (jeśli dotyczy)
HIER	Protokół HIER (jeśli dotyczy)
Enzyme (enzym)	Protokół odsłaniania enzymatycznego (jeśli dotyczy)
Dispense volume (objętość dozowania)	Dozowana objętość odczynnika (zob. <a href="#">6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach</a> )
Tissue type (typ tkanki)	Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna



W przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego w kolumnach Marker, Protocols (protokoły), Dispense volume (objętość dozowania) i Tissue type (typ tkanki) wyświetlane są dwa wiersze pogrupowane według ID szkiełka.

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 6.8 Ręczne tworzenie slajdów i przypadków

Domyślnie system BOND jest skonfigurowany tak, aby nowe przypadki i szkiełka mogły zostać utworzone po załadowaniu tacy na szkiełka do modułu przetwarzania i zakończeniu obrazowania szkiełek.

W pierwszej części poniżej zawarto wskazówki dotyczące takiego „ręcznego” tworzenia przypadków i szkiełek. W drugiej części opisano ustawienia dla alternatywnych przebiegów pracy.

- [6.8.1 - Tworzenie nowych przypadków i/lub szkiełek po zakończeniu obrazowania](#)
- [6.8.2 - Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu](#)

### 6.8.1 Tworzenie nowych przypadków i/lub szkiełek po zakończeniu obrazowania

Aby dodać informacje o przypadku i szkiełku po załadowaniu i zobrazowaniu szkiełek, postępować zgodnie z poniższą procedurą (procedura jest podobna do procedury wspomaganego wykrywania ID opisanej w części [5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#), ale obejmuje również tworzenie nowych przypadków i szkiełek).

1. Załadować szkiełka do modułu przetwarzania w standardowy sposób.  
Nie ma potrzeby tworzenia przypadków ani szkiełek w oprogramowaniu BOND ani drukowania osobnych etykiet – można używać etykiet odręcznych lub etykiet innych producentów.
2. Jeśli system nie rozpozna szkiełek, wyświetli obrazy etykiet.

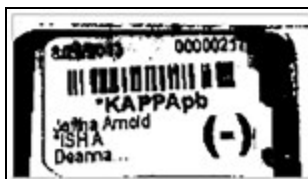


Figure 6-7: Szkiełko, które nie zostało automatycznie zidentyfikowane



Jeśli w przypadku danego modułu przetwarzania obrazy etykiet nie są w ogóle wyświetlane, można skonfigurować oprogramowanie tak, aby nie przechwytywać obrazów etykiet szkiełek dla tego modułu. Skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzgodnić zmianę tego ustawienia modułu przetwarzania.



3. Aby uruchomić funkcję **Slide identification** (identyfikacja szkiełek), wykonać jedną z poniższych czynności:
  - i. Dwukrotnie kliknąć obraz szkiełka.
  - ii. Kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Select manually** (wybierz ręcznie) z podmenu.

Pojawi się okno dialogowe **Slide identification** (identyfikacja szkiełek) z przyciskami **New case** (nowy przypadek) oraz **New slide** (nowe szkiełko) (elementy 1 i 2 na [Figure 6-8](#)).

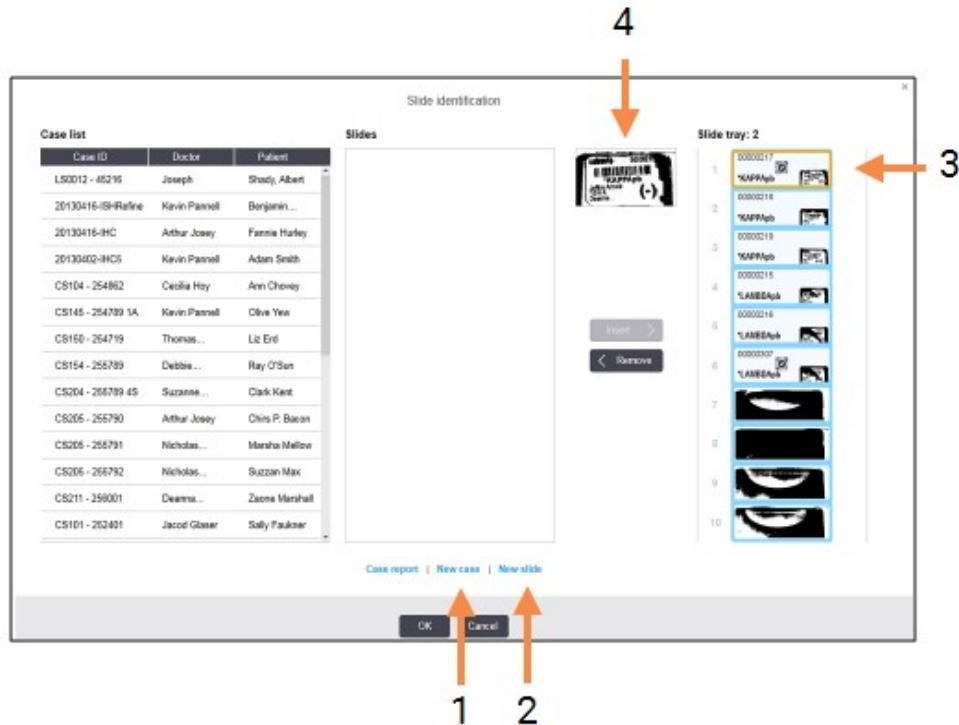


Figure 6-8: Okno dialogowe identyfikacji szkiełek z wyświetlaniem statusu szkiełek

**i** W niektórych laboratoriach przycisk „New case” (nowy przypadek) lub oba przyciski „New case” (nowy przypadek) i „New slide” (nowe szkiełko) mogą być niedostępne – zob. [6.8.2 - Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu](#).

Aktywne szkiełko jest podświetlone na tacy na szkiełka (element 3).

Okno dialogowe zawiera powiększony obraz etykiety (element 4), co ułatwia identyfikację szkiełka. Przytrzymać kursor nad szkiełkiem w prawym okienku, aby jeszcze bardziej powiększyć obraz etykiety.

W lewym okienku znajduje się lista wszystkich przypadków dla bieżących szkiełek. W przypadku ustawień domyślnych wyświetlane są tylko przypadki ze szkiełkami, dla których wydrukowane zostały etykiety (ustawienia te można zmienić tak, aby uwzględnić przypadki ze szkiełkami, dla których etykiety nie zostały wydrukowane, zob. [6.8.2.2 - Zewnętrzne etykiety szkiełek](#)).

Środkowe okienko zawiera szkiełka skonfigurowane dla przypadku wybranego w okienku po lewej, gdzie szkiełka nie zostały jeszcze dopasowane do szkiełek obrazowanych w module przetwarzania.

Ponownie, domyślnie wyświetlane są tylko szkiełka, dla których zostały wydrukowane etykiety, jednak ustawienie to można zmienić, aby wyświetlić wszystkie szkiełka skonfigurowane dla przypadku.



Upewnić się, że wybrano właściwy obraz etykiety, ponieważ nieprawidłowy wybór może mieć wpływ na szkiełka.

4. Aby utworzyć nowy przypadek, kliknąć opcję **New case** (nowy przypadek) (element 1).  
Utworzyć nowy przypadek dla wybranego szkiełka w normalny sposób (zob. [6.3.3 - Dodawanie przypadku](#)).
5. Po kliknięciu **OK** w oknie dialogowym **Add case** (dodaj przypadek) zaznaczyć nowy przypadek na liście przypadków w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek).
6. Aby utworzyć nowe szkiełko dla właśnie powstałego przypadku, kliknąć opcję **New slide** (nowe szkiełko) (element 2).  
Spowoduje to otwarcie okna dialogowego **Add slide** (dodaj szkiełko).
7. Utworzyć nowe szkiełko w oprogramowaniu dla fizycznego szkiełka wybranego w okienku po prawej stronie (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)).  
Po dodaniu nowe szkiełko jest wyświetlane w środkowym okienku okna dialogowego (jeśli oczywiście nowy przypadek jest nadal zaznaczony na liście przypadków po lewej stronie).
8. Upewnić się, że w okienku po prawej nadal zaznaczony jest właściwy obraz etykiety. Kliknąć opcję **Insert** (wstaw), aby dopasować go do nowego szkiełka w środkowym okienku.  
Szkiełko zostanie usunięte ze środkowego okienka, a obraz etykiety w prawym okienku zostanie zastąpiony informacjami systemowymi dla szkiełka zgodnymi z danymi wprowadzonymi dla nowo utworzonego szkiełka.  
W przypadku nieprawidłowego dopasowania szkiełek krok można cofnąć, wybierając szkiełko w okienku po prawej stronie i klikając przycisk **Remove** (usuń).
9. Szkiełko można teraz przetwarzać w standardowy sposób.  
Powtórzyć procedurę tworzenia nowych przypadków i szkiełek dla pozostałych szkiełek na tacy.

## 6.8.2 Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu

System można skonfigurować tak, aby dopuścić lub wymusić różne przebiegi identyfikacji szkiełek. W tym celu w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek) klienta administracyjnego należy zaznaczyć lub odznaczyć odpowiednie opcje.

### 6.8.2.1 Ograniczanie lub wyłączanie funkcji ręcznego tworzenia szkiełek i przypadków

Domyślnie system BOND umożliwia załadowanie szkiełek, które nie zostały utworzone w oprogramowaniu BOND (lub nie zostały zaimportowane z systemu LIS) i utworzenie przypadków i szkiełek w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek) po zakończeniu obrazowania szkiełek. Można też skonfigurować system tak, aby uniemożliwić tworzenie nowych przypadków w ten sposób (ale wciąż zezwalać na tworzenie nowych szkiełek dla istniejących przypadków) lub całkowicie uniemożliwić tworzenie szkiełek (i przypadków) po załadowaniu szkiełek. W zależności od ustawień niedostępny będzie tylko przycisk **New case** (nowy przypadek) lub oba przyciski **New case** (nowy przypadek) oraz **New slide** (nowe szkiełko) w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek) (zob. [Figure 6-8](#)).


Funkcję ręcznego tworzenia szkiełek i przypadków można ograniczyć lub wyłączyć z poziomu ekranu **Laboratory Configuration** (konfiguracja laboratorium) klienta administracyjnego (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)).

### 6.8.2.2 Zewnętrzne etykiety szkiełek

System BOND można skonfigurować tak, aby przed rozpoczęciem przetwarzania żądał (lub nie) wydrukowania wszystkich etykiet szkiełek przez system BOND. Ustawienia dla szkiełek LIS i szkiełek innych niż LIS są oddzielne.

W przypadku szkiełek innych niż LIS domyślnie wymagana jest etykieta wydrukowana przez system BOND. Oznacza to, że fizyczne szkiełka bez etykiet wydrukowanych przez system BOND nie są automatycznie dopasowywane do szkiełek utworzonych w oprogramowaniu (nawet jeśli ID są takie same). Co więcej, szkiełek tych nie da się dopasować ręcznie przy użyciu okna dialogowego **Slide identification** (identyfikacja szkiełek), ponieważ w oknie tym wyświetlane są tylko szkiełka z etykietami wydrukowanymi przez system BOND. W rezultacie laboratorium nie posiadające zintegrowanego systemu BOND–LIS pozwalającego na odczytywanie etykiet odręcznych lub wydrukowanych na urządzeniach zewnętrznych muszą wyłączyć tę opcję. To sprawia, że wszystkie szkiełka utworzone w systemie są dostępne do dopasowania do szkiełek załadowanych do modułu przetwarzania, niezależnie od tego, czy etykiety zostały wydrukowane przez system BOND, czy też nie.

Aby umożliwić przetwarzanie szkiełek, które nie posiadają etykiet wydrukowanych przez system BOND, odznaczyć opcję **Force printing in BOND** (wymuś drukowanie w systemie BOND) w na ekranie **Laboratory** (laboratorium) klienta administracyjnego (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)). (Odznaczenie opcji **Force printing in BOND** (wymuś drukowanie w systemie BOND) celem umożliwienia ręcznego tworzenia szkiełek i przypadków nie jest konieczne – zob. [6.8.2.1 - Ograniczanie lub wyłączanie funkcji ręcznego tworzenia szkiełek i przypadków](#)).

 Szkiełka utworzone przed odznaczeniem opcji **Force printing in BOND** (wymuś drukowanie w systemie BOND) nie będą dostępne do przetwarzania do momentu wydrukowania ich etykiet, chociaż szkiełka utworzone po usunięciu zaznaczenia nie muszą mieć etykiet drukowanych.

W przypadku szkiełek LIS etykieta wydrukowana przez system BOND nie jest wymagana. Oznacza to, że szkiełka z etykietami wydrukowanymi przez system LIS mogą być automatycznie dopasowywane do szkiełek w oprogramowaniu BOND (zaimportowanych z systemu LIS). Jeśli przeprowadzenie automatycznego dopasowania nie jest możliwe (np. jeśli etykieta szkiełka jest rozmazana), można ręcznie dopasować szkiełka przy użyciu okna dialogowego **Slide identification** (identyfikacja szkiełek). Jeśli jednak konieczne jest wymuszenie wydruku etykiet przez system BOND dla szkiełek LIS, należy włączyć opcję **Force LIS printing in BOND** (wymuś drukowanie etykiet dla szkiełek LIS w systemie BOND) na ekranie **LIS** klienta administracyjnego – zob. [10.2 - LIS](#).

## 6.9 Zgodność szkiełek

Aby zapewnić synchronizację kroków w każdym przebiegu w sposób gwarantujący optymalne wyniki dla wszystkich szkiełek na tacy, system BOND sprawdza je pod kątem *zgodności* podczas załadunku tacy na szkiełka. Niezgodne szkiełka są wyświetlane na ekranie **System status** (stan systemu). Przed rozpoczęciem przebiegu należy usunąć lub wymienić niezgodne szkiełka (zob. [5.1.4.4 - Rozwiązywanie problemu z niezgodną konfiguracją szkiełek](#)).

Aby szkiełka zostały uznane za zgodne, wszystkie muszą:

- mieć taką samą objętość dozowania;
- być przeznaczone do barwienia pojedynczego lub do równoczesnego barwienia podwójnego lub do sekwencyjnego barwienia podwójnego;
- mieć przypisany ten sam protokół przygotowywania;
- mieć przypisany ten sam protokół barwienia; oraz
- mieć przypisane zgodne protokoły obróbki wstępnej i/lub protokoły denaturacji i hybrydyzacji ISH.

Zasady dotyczące zgodności protokołów opisano w części [6.9.1 - Zgodność protokołów](#).

Raporty dot. konfiguracji szkiełek ([6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkiełka](#)) pomagają zapewnić zgodność szkiełek ładowanych na każdą tacę.

### 6.9.1 Zgodność protokołów

Ograniczenia dotyczące zgodności protokołów barwienia i przygotowywania są sztywne, podczas gdy w przypadku protokołów wstępnej obróbki enzymatycznej oraz protokołów hybrydyzacji ISH i denaturacji istnieje pewna przestrzeń dopuszczająca modyfikacje. Zgodność dla tych protokołów zależy od typu modułu przetwarzania (BOND-III lub BOND-MAX), liczby i czasu trwania kroków protokołu oraz stanów urządzenia podczas tych kroków. Protokoły uznaje się za zgodne, gdy wszystkie te czynniki są takie same lub różnią się w sposób, który można skompensować bez wpływu na jakość barwienia.

Poniżej wymieniono zasady zgodności dla wszystkich typów protokołów.

#### 6.9.1.1 Protokoły barwienia

Dla każdego szkiełka na tacy należy przypisać ten sam protokół barwienia. W przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego w jednym zleceniu należy zdefiniować dwa te same dwa protokoły barwienia.

Szkiełek IHC i ISH nie należy łączyć w przebiegach z barwieniem pojedynczym – jest to dozwolone wyłącznie w przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego.

#### 6.9.1.2 Protokoły przygotowywania

Do protokołów „odparafinowania” i „podgrzewania i odparafinowania”

1. Do wszystkich szkiełek na danej tacy należy stosować ten sam protokół.
2. Szkiełek z przypisanym protokołem przygotowywania nie należy mieszać ze szkiełkami bez takiego protokołu.

### 6.9.1.3 Protokoły obróbki wstępnej

Szkiełka tylko z odsłanianiem w podwyższonej temperaturze, tylko z odsłanianiem enzymatycznym, z odsłanianiem enzymatycznym *oraz* w podwyższonej temperaturze i szkiełka bez odsłaniania epitopu mogą być przetwarzane w tym samym przebiegu. Szkiełka niepodlegające wybranej obróbce wstępnej są uwadniane podczas wykonywania protokołu na pozostałych szkiełkach (odsłanianie w podwyższonej temperaturze zawsze następuje przed odsłanianiem enzymatycznym).

Podobnie zgodne są wszystkie kombinacje szkiełek z i bez denaturacji ISH i hybrydyzacji.

W poniższych częściach podano warunki zgodności protokołów obróbki wstępnej z protokołami dla tego samego typu obróbki wstępnej.

#### Obróbka termiczna

1. Protokoły termicznej obróbki wstępnej są zgodne, gdy:
  - i. zawierają taką samą liczbę kroków; oraz
  - ii. do każdego kroku przypisane są te same czasy inkubacji, z wyjątkiem etapów podgrzewania. W przypadku jednoczesnego podgrzewania dla wszystkich szkiełek używany jest najdłuższy czas dla danego kroku. Szkiełka z krótszym czasem są podgrzewane tylko przez skonfigurowany dla nich czas, po czym zasilanie podgrzewacza szkiełek jest wyłączane.
2. W ramach jednego przebiegu można stosować oba protokoły wykorzystujące roztwory do odsłaniania epitopu 1 i 2.
3. Szkiełka poddawane obróbce termicznej mogą być przetwarzane wraz szkiełkami bez termicznej obróbki wstępnej – wówczas podczas przetwarzania pozostałych szkiełek szkiełka bez obróbki termicznej będą uwadniane roztworem do odsłaniania epitopu w temperaturze otoczenia.

#### Wstępna obróbka enzymatyczna

1. Protokoły wstępnej obróbki enzymatycznej są zgodne, gdy:
  - i. zawierają taką samą liczbę kroków; oraz
  - ii. do każdego kroku przypisane są te same czasy inkubacji.
2. W jednym przebiegu można zastosować maksymalnie 2 typy enzymów.
3. Szkiełka poddawane wstępnej obróbce enzymatycznej mogą być przetwarzane wraz szkiełkami bez obróbki enzymatycznej – wówczas podczas przetwarzania pozostałych szkiełek szkiełka bez obróbki enzymatycznej będą uwadniane w temperaturze otoczenia.

### 6.9.1.4 Denaturacja ISH

Protokoły denaturacji są zgodne, jeśli zawierają te same czasy inkubacji. Temperatura inkubacji może się różnić.

### 6.9.1.5 Hybrydyzacja ISH

Protokoły hybrydyzacji są zgodne, jeśli zawierają te same czasy inkubacji. Temperatura inkubacji może się różnić.

# 7. Protokoły (kontroler BOND )

W oprogramowaniu BOND protokołem nazywa się serię kroków wykonywanych w celu wybarwienia próbek tkanek.

System BOND jest dostarczany z zestawem wstępnie zdefiniowanych protokołów Leica Biosystems, których nie można edytować ani usuwać. Wstępnie zdefiniowane protokoły zostały poddane rygorystycznym testom i walidacji przez Leica Biosystems. Przy prawidłowym wykorzystaniu zapewniają doskonałe wyniki barwienia. Użytkownik może jednak tworzyć własne protokoły, kopiując i edytując te istniejące.



Użytkownik ma obowiązek przeprowadzić testowanie i walidację każdego utworzonego lub edytowanego protokołu. Możliwość tworzenia i zapisywania protokołu nie oznacza, że jest on odpowiedni do zamierzonego zadania.

---

Ten rozdział zawiera następujące części:

- [7.1 - Typy protokołów](#)
- [7.2 - Ekran konfiguracji protokołów](#)
- [7.3 - Tworzenie nowych protokołów](#)
- [7.4 - Edytowanie protokołów użytkownika](#)
- [7.5 - Raporty dot. protokołów](#)
- [7.6 - Wstępnie zdefiniowane protokoły](#)

## 7.1 Typy protokołów

Wszystkie protokoły w systemie BOND mają przypisany „typ” zgodny z określonymi działaniami, jakie mają być wykonane. Na przykład, protokoły barwienia wstępnego HIER są jednego typu, a protokoły sekwencyjnego barwienia podwójnego IHC – innego.

- Typu protokołu nie można zmienić.
- Aby utworzyć nowy protokół, należy skopiować istniejący protokół takiego typu, jaki ma być przypisany do nowego protokołu. W razie potrzeby można edytować kroki protokołu.

Zazwyczaj jeden przebieg przetwarzania obejmuje kilka różnego typu protokołów: przygotowywania szkiełek, aplikacji markerów i dozowania chromatogenu. W przypadku barwienia podwójnego takie sekwencje i zawarte w nich protokoły zwykle wymagają modyfikacji.

- [7.1.1 - Metody barwienia](#)
- [7.1.2 - Sekwencje protokołów](#)

### 7.1.1 Metody barwienia

Barwienie podwójne polega na aplikacji dwóch różnych markerów i chromogenów na jedno szkiełko. W systemie BOND zaprogramowane są dwie metody barwienia podwójnego: sekwencyjne barwienie podwójne (dwa markery są aplikowane jeden po drugim w ramach oddzielnych protokołów barwienia) oraz równoczesne barwienie podwójne (dwa markery są mieszane ze sobą, tworząc tzw. „koktajl”, i aplikowane w ramach protokołu barwienia pojedynczego).

Podczas tworzenia i edycji protokołu barwienie pojedyncze jest traktowane jako specjalny przypadek sekwencyjnego barwienia podwójnego.

Każdy protokół barwienia ma przypisaną „metodę barwienia”, która określa rolę protokołu (barwienia podwójne lub pojedyncze). Dla protokołów typu „sekwencyjne barwienie podwójne” dostępne są trzy „metody barwienia”:

- Single (pojedyncze) – do stosowania jako samodzielny protokół aplikacji pojedynczego markera
- First (pierwszy) – do stosowania jako pierwszy protokół sekwencyjnego barwienia podwójnego
- Second (drugi) – do stosowania jako drugi protokół sekwencyjnego barwienia podwójnego

Wszystkie wstępnie zdefiniowane protokoły sekwencyjnego barwienia podwójnego mają przypisaną metodę barwienia „Single” (pojedyncze), której nie można zmienić. Jednak metodę barwienia dla protokołów sekwencyjnego barwienia utworzonych przez użytkownika można dowolnie zmienić. Przykładowo protokół użytkownika może być skonfigurowany tak, aby w niektórych przypadkach był stosowany jako protokół barwienia pojedynczego, a w innych – jako pierwszy protokół barwienia podwójnego.

Protokoły typu „równoczesne barwienie podwójne” mają przypisaną tylko jedną metodę barwienia – „równoczesne DS”.



W przypadku równoczesnego barwienia podwójnego, jeśli odpowiedni wstępnie zdefiniowany protokół równoczesnego barwienia podwójnego nie jest dostępny do użycia lub skopiowania, należy zmodyfikować protokół barwienia pojedynczego tak, aby uwzględnić drugi chromogen i inne wymagane odczynniki pomocnicze. Dodatkowe odczynniki można załadować w otwartych pojemnikach.



Poniższa tabela zawiera wyszczególnione typy protokołów i metody barwienia:

<b>Type (typ)</b>		<b>Metoda barwienia</b>	<b>Opis</b>
Barwienie	Barwienie IHC	Pojedyncze	Protokół wykrywania pojedynczego przeciwciała metodą barwienia pojedynczego
	Pojedyncze i sekwencyjne barwienie podwójne	Pierwszy	Protokół wykrywania pierwszego przeciwciała metodą sekwencyjnego barwienia podwójnego
		Drugi	Protokół wykrywania drugiego przeciwciała metodą sekwencyjnego barwienia podwójnego
		Równoczesne DS	Protokół wykrywania koktajlu przeciwciał metodą równoczesnego barwienia podwójnego
	Barwienie IHC	Równoczesne DS	Protokół wykrywania koktajlu przeciwciał metodą równoczesnego barwienia podwójnego
	Równoczesne barwienie podwójne	Pojedyncze	Protokół wykrywania pojedynczej sondy metodą barwienia pojedynczego
		Pierwszy	Protokół wykrywania pierwszej sondy metodą sekwencyjnego barwienia podwójnego
		Drugi	Protokół wykrywania drugiej sondy metodą sekwencyjnego barwienia podwójnego
	Detekcja ISH	Równoczesne DS	Protokół wykrywania koktajlu sond metodą równoczesnego barwienia podwójnego (obecnie brak protokołów w tej kategorii)
	Równoczesne barwienie podwójne		
Barwienie wstępne BOND-III oraz BOND-MAX	Preparation (przygotowanie)	ND.	Odfarbinowanie lub podgrzewanie szkiełka (celem zapewnienia lepszego przylegania tkanki), a następnie odfarbinowanie
	Obróbka termiczna	ND.	Odsłanianie epitopu w podwyższonej temperaturze
	Wstępna obróbka enzymatyczna	ND.	Odsłanianie epitopu przy użyciu enzymów
	Denaturacja ISH	ND.	Protokoły denaturacji dla DNA ISH
	Hybrydyzacja ISH	ND.	Protokoły hybrydyzacji dla ISH

## 7.1.2 Sekwencje protokołów

Zazwyczaj dla każdego szkiełka stosuje się sekwencję protokołów różnych typów. Sekwencja taka obejmuje protokoły przygotowywania, odsłaniania epitopu, denaturacji, hybrydyzacji i barwienia, dobrane odpowiednio do tkanki i markera oraz zgodne z procedurami laboratoryjnymi. Sekwencje te można skonfigurować osobno dla każdego szkiełka podczas jego tworzenia (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)), jednak oprogramowanie BOND umożliwia skonfigurowanie protokołów domyślnych, co przyspiesza tworzenie szkiełek, gdy nie są wymagane żadne specjalistyczne protokoły:

- domyślny protokół przygotowywania (np. \*Odparafinowanie) jest ustawiany z poziomu klienta administracyjnego dla całego systemu BOND (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#));
- domyślne ustawienia dla pozostałych typów protokołów są konfigurowane na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) osobno dla każdego markera (zob. [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)).

Ustawienie protokołów domyślnych pozwala maksymalnie skrócić czas spędzony na przygotowywaniu poszczególnych szkiełek. W razie potrzeby protokoły dla poszczególnych szkiełek można zmienić podczas tworzenia tych szkiełek.

Kolejność, w jakiej protokoły są ustawiane w sekwencji, jest określana automatycznie przez oprogramowanie BOND zgodnie z poniższą tabelą. Kroki dozowania i usuwania sondy nie są uwzględnione w żadnym protokole, jako że procesy te są wykonywane automatycznie.

Kolejność	Protokół (lub sonda)	IHC lub ISH	Komentarz
1	Preparation (przygotowanie)	Oba	Opcjonalne usunięcie parafiny przez urządzenie w trakcie przygotowania do badania biochemicznego.
2	HIER (odsłanianie epitopu w podwyższonej temperaturze)	Oba	W przypadku większości szkiełek podczas przebiegu stosuje się protokół HIER lub EIER – a czasami oba te protokoły lub żaden z nich.
3	EIER (enzymatyczne odsłanianie epitopu)	Oba	
4	Aplikacja sondy	ISH	Protokół ten nie jest wybierany przez użytkownika, system BOND sam automatycznie dobiera odpowiedni protokół.
5	Denaturacja	ISH	Protokół denaturacji dla sond DNA.  W przypadku sond DNA należy zawsze stosować denaturację.
6	Hybrydyzacja	ISH	Wymagany protokół hybrydyzacji dla ISH.
7	Usuwanie sondy	ISH	Protokół ten nie jest wybierany przez użytkownika, system BOND sam automatycznie dobiera odpowiedni protokół.

<b>Kolejność</b>	<b>Protokół (lub sonda)</b>	<b>IHC lub ISH</b>	<b>Komentarz</b>
8	Barwienie	Oba	Wymagany protokół aplikacji chromogenu i powiązanych odczynników. W ramach tego protokołu dozowane są pierwszorzędowe przeciwciała IHC.

Do sekwencji można wybierać protokoły wstępnie zdefiniowane lub utworzone przez użytkownika (zob. [Chapter 7.3 - Tworzenie nowych protokołów](#)).

### 7.1.2.1 Protokoły i sekwencje protokołów dla sekwencyjnego barwienia podwójnego

W procesie sekwencyjnego barwienia podwójnego zwykle uruchamiane są dwie sekwencje protokołu barwienia pojedynczego, jedna po drugiej. Mogą to być dwie sekwencje IHC, dwie sekwencje ISH lub jedna sekwencja IHC i jedna ISH, w dowolnej kolejności. Zwykle, ale nie we wszystkich przypadkach, do aplikacji pierwszego markera wykorzystywany jest system detekcji BOND Polimer Refine Detection z chromogenem DAB, a do aplikacji drugiego markera – system detekcji BOND Polymer Refine Red Detection z chromogenem Fast Red.

Często niektóre protokoły w sekwencji aplikacji drugiego markera można pominąć, jeśli jednak są one uwzględnione, należy je zmodyfikować. Zwykle należy również zmodyfikować kroki aplikacji pierwszego i drugiego markera w protokołach barwienia (w przypadku protokołów konieczne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji w celu ustawienia odpowiedniej metody barwienia – zob. [7.1.1 - Metody barwienia](#)). Poniżej podano kilka sugestii dotyczących modyfikacji protokołów i sekwencji protokołów w przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzić własne testy w celu weryfikacji wyników.

- Protokoły przygotowywania mogą być wykonywane w sekwencji tylko dla pierwszego markera – oprogramowanie BOND nie zezwala na wybór protokołu przygotowywania dla drugiego markera.
- Często odsłanianie epitopu jest wymagane tylko raz, przed aplikacją pierwszego markera. Jeśli wymagane jest dodatkowe odsłonięcie dla drugiego markera, należy ustawić krótszy czas trwania.
- W przypadku barwienia podwójnego ISH do obu markerów należy przypisać protokoły hybrydyzacji, jednak dla drugiego markera należy ustawić krótszy czas trwania niż w przypadku barwienia pojedynczego.
- W przypadku barwienia podwójnego dwoma sondami DNA denaturacja jest często wymagana tylko raz, przed aplikacją pierwszego markera. Jeśli wymagana jest dodatkowa denaturacja dla drugiego markera, zazwyczaj należy ustawić krótszy czasu trwania.
- W przypadku protokołów barwienia najlepsze wyniki zazwyczaj uzyskuje się, jeśli segment hematoksyliny zostanie usunięty z końca pierwszego protokołu, a z początku drugiego protokołu zostanie usunięty segment blokera nadtlenu (jeśli jest).

## 7.2 Ekran konfiguracji protokołów

W celu rozpoczęcia pracy z protokołami kliknąć ikonę **Protocol setup** (konfiguracja protokołów) na pasku funkcji.

Protocol setup



Protocol setup					
Protocol name	Protocol type	Description	Modified by	Mod. date	Pref.
*IHC Protocol F	IHC staining	Bond Polymer Refine IHC protocol	Leica	10-Apr-13	✓
*IHC Protocol G	IHC staining	Bond Polymer AP Red IHC protocol	Leica	10-Apr-13	✓
*IHC Protocol J	IHC staining	Bond Polymer Refine Red IHC protocol	Leica	10-Apr-13	✓
*IHC Protocol K	IHC staining	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	10-Apr-13	✓
*IHC Protocol K - 50 Test	IHC staining	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	23-Aug-13	✓
GFAP (ER2, Enzyme1)	IHC staining	Bond Polymer Refine IHC protocol	paul	22-Aug-13	✓
IHC Protocol EDS	IHC staining	Bond Polymer Refine IHC protocol	paul	22-Aug-13	✓
IHC Protocol F DS	IHC staining	Bond Polymer Refine IHC protocol	jimmy	22-Aug-13	✓
Negative F	IHC staining	Bond Polymer Refine IHC protocol	jimmy	22-Aug-13	✓
*FISH Protocol A	ISH detection	FISH System protocol - 30 Test	Leica	10-Apr-13	✓
*ISH Protocol A	ISH detection	Bond Polymer Refine RNA ISH protocol	Leica	10-Apr-13	✓
*ISH Protocol B	ISH detection	Bond Polymer Refine DNA ISH protocol	Leica	10-Apr-13	✓
FISH Protocol ASDS	ISH detection	FISH System protocol - 30 Test	jimmy	22-Aug-13	✓
ISH Protocol ASDS	ISH detection	Bond Polymer Refine RNA ISH protocol	jimmy	22-Aug-13	✓
ISH Protocol BDS	ISH detection	Bond Polymer Refine DNA ISH protocol	jimmy	22-Aug-13	✓

Protocol group: Staining Protocol type: All Staining status: All Protocol origin: All Preferred status: Preferred

Postać 7-1: Ekran **Protocol setup** (konfiguracja protokołów)

Na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów) znajduje się tabela zawierająca wszystkie protokoły wraz z ich podstawowymi szczegółami. Wstępnie zdefiniowane protokoły są oznaczone gwiazdką (\*) umieszczoną przed pierwszy znakiem nazwy i skróconej nazwy.

Z poziomu tej tabeli można wybrać protokół do skopiowania, edytowania czy wygenerowania raportu. Operacje są dostępne za pośrednictwem przycisków umieszczonych nad tabelą lub z poziomu menu wyświetlanego po kliknięciu protokołu prawym przyciskiem myszy.

Filtry poniżej tabeli umożliwiają wyświetlenie protokołów tylko wybranego typu. Przykładowo można wybrać pomiędzy protokołami barwienia i barwienia wstępnego, a następnie jeszcze bardziej zawęzić kryteria, aby wyświetlić określone typy protokołów (zob. [7.1 - Typy protokołów](#)). Dodatkowo można przefiltrować protokoły wg metody barwienia, pochodzenia protokołu i preferowanego statusu.

Na liście protokołów wyświetlane są następujące informacje:

<b>Nazwa kolumny</b>	<b>Opis</b>	<b>Opcje</b>
Protocol name (nazwa protokołu)	Pełna nazwa protokołu	Wstępnie zdefiniowane protokoły (Leica Biosystems) zawsze zaczynają się od gwiazdki (*)
Protocol type (typ protokołu)	Opisuje działanie protokołu	Zob. <a href="#">7.1 - Typy protokołów</a>
Opis	Opisuje działanie i zastosowanie protokołu	
Modified by (zmodyfikowany przez)	Określa, kto utworzył lub zmodyfikował protokół	Nazwa <b>Leica</b> wskazuje wstępnie zdefiniowany protokół Leica Biosystems
Mod. date (data modyfikacji)	Data utworzenia lub ostatniej modyfikacji protokołu	
Pref. (preferowany):	Wyświetla preferowany status protokołu	<p>Pole zaznaczone – protokół jest preferowany i dostępny do wyboru w oknie dialogowym <b>Add slide</b> (dodaj szkiełko)</p> <p>Pole odznaczone – protokół nie jest preferowany i nie jest dostępny do wyboru w oknie dialogowym <b>Add slide</b> (dodaj szkiełko)</p>

## 7.2.1 Szczegóły protokołu

Aby otworzyć protokół zaznaczony na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów) do przeglądania lub edycji, dwukrotnie kliknąć ten protokół (lub zaznaczyć go, a następnie kliknąć **Open** (otwórz)). Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu) zawierające szczegóły protokołu.

W przypadku wstępnie zdefiniowanych protokołów Leica Biosystems edytować można tylko ustawienie „Preferred” (preferowany), zaś w protokołach użytkownika zmienić można dowolne inne ustawienia.

The screenshot shows the 'Edit protocol properties' dialog box. It contains the following information:

- Name:** MyIHC Protocol F
- Abbreviated name:** MyIHC F
- Description:** Bond Polymer Refine IHC protocol
- Staining method:** Single, First, Second (all checked), Preferred (checked)
- Preferred detection system:** Bond Polymer Refine Detection
- Table of steps:**

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. time
1		*Peroxide Block	Leica Microsystems	✓		5:00
5		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10:00
9		*Post Primary	Leica Microsystems	✓		8:00
13		*Polymer	Leica Microsystems	✓		8:00
17		*Mixed DAB Refine	Leica Microsystems	✓		0:00
18		*Mixed DAB Refine	Leica Microsystems	✓		10:00
22		*Hamatoxylin	Leica Microsystems	✓		5:00
- Buttons:** Show wash steps (checkbox), Import protocol, Protocol type: IHC staining, Insert segment, Duplicate, Delete segment, Save, Cancel.

Postać 7-2: Okno dialogowe **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu) dla protokołu użytkownika

Okno dialogowe zawiera osobne karty dla każdego typu modułu przetwarzania (BOND oraz BOND-MAX) skonfigurowanego dla grupy (lub dwie karty, jeśli nie skonfigurowano żadnego modułu). W oknie znajduje się również przycisk **Import protocol** (importuj protokół), który pojawia się podczas tworzenia nowego protokołu lub podczas edytowania protokołu użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w części [7.4.4 - Typy urządzeń i wersje protokołów](#)

Zaznaczyć pole **Show wash steps** (pokaż kroki płukania) pod tabelą, aby wyświetlić wszystkie kroki protokołu (w tym kroki płukania). Odznaczyć pole, aby ukryć etapy płukania.

Okno dialogowe **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu) zawiera poniższe informacje o protokole.

Nazwa	Pełna nazwa protokołu.
Abbreviated name (skrótowa nazwa)	Skrótowa nazwa protokołu, używana na przykład na etykietach szkiełek.
Opis	Krótki opis protokołu.
Staining method (metoda barwienia)	(Zob. poniżej)

Protocol type (typ protokołu)	Typ wskazuje funkcję protokołu i określa dopuszczalne kroki i odczynniki.
Preferred detection system (preferowany system detekcji)	Preferowany system detekcji dla danego protokołu. Nie dotyczy to protokołów barwienia wstępnego.

Tabela pod informacjami o protokole w tym oknie dialogowym zawiera listę kroków protokołu i jego właściwości (zob. [Postać 7-2](#)). Z poziomu tej tabeli można modyfikować edytowalne kroki w protokołach użytkownika (zob. [7.4 - Edytowanie protokołów użytkownika](#)).

W tabeli przedstawione są następujące szczegóły:

Pozycja	Opis
Step No. (nr kroku)	Kolejność, w jakiej wykonywane są kroki protokołu.
Wash (płukanie)	Pole zaznaczone, jeśli dany krok jest krokiem płukania.
Reagent (odczynnik)	Odczynnik używany w danym kroku.
Supplier (dostawca)	Dostawca odczynnika. Tego pola nie można edytować.
Ambient (temperatura otoczenia)	Pole zaznaczone, jeśli krok jest wykonywany w temperaturze otoczenia.
Temperature (temperatura)	Temperatura szkiełka, jeśli jest inna niż temperatura otoczenia (tylko protokoły barwienia wstępnego).
Inc. (min) (czas inkubacji w minutach)	Minimalny czas pozostawiania odczynnika na szkiełku.

### 7.2.1.1 Metoda barwienia

Protokoły barwienia zawierają sekcję „metoda barwienia”. W przypadku protokołów barwienia pojedynczego i sekwencyjnego barwienia podwójnego dostępne są następujące opcje:

- **Single** (pojedyncze) – protokół dotyczy barwienia pojedynczego
- **First** (pierwszy) – pierwszy protokół sekwencyjnego barwienia podwójnego
- **Second** (drugi) – drugi protokół sekwencyjnego barwienia podwójnego

Dla protokołów równoczesnego barwienia podwójnego dostępna jest tylko jedna metoda barwienia: **Parallel DS** (równoczesne DS).

Szczegółowy opis metod barwienia znajduje się w części [7.1.1 - Metody barwienia](#).

#### 7.2.1.2 Preferowany status

Do wyboru w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) dostępne są tylko preferowane protokoły, dlatego też protokoły, z których korzysta laboratorium, należy ustawić jako „preferowane”. W tym celu zaznaczyć pole **Preferred** (preferowany) – lub odznaczyć je, aby protokół nie był wyświetlany.



## 7.3 Tworzenie nowych protokołów

Nowe protokoły tworzy się, kopiując istniejące protokoły użytkownika lub protokoły Leica Biosystems. Typ skopiowanego protokołu pozostaje stały i nie można go później zmienić. Z tego powodu w celu utworzenia nowego protokołu IHC należy skopiować istniejący protokół IHC; w celu utworzenia nowego protokołu HIER – skopiować istniejący protokół HIER i tak dalej.

Aby skopiować protokół, zaznaczyć go na liście na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów), a następnie kliknąć przycisk **Copy** (kopiuj). W oknie dialogowym **New protocol properties** (właściwości nowego protokołu) wyświetlona zostanie gotowa do edycji kopia wybranego protokołu.

Nowy protokół będzie wymagał nadania unikalnej nazwy i skróconej nazwy, które muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami określonymi w części [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#). Poza zmianą nazwy protokołu i skróconej nazwy nie trzeba zmieniać żadnej innej części nowego protokołu. Można jednak zmienić dowolne właściwości protokołu zgodnie z opisem zawartym w części [7.4 - Edytowanie protokołów użytkownika](#).

Po zakończeniu edycji kliknąć opcję **Save** (zapisz). Jeżeli protokół jest zgodny z zasadami, system zażąda potwierdzenia, że użytkownik tworzy protokół „na własne ryzyko”. Ten komunikat stanowi przypomnienie, że system Leica Biosystems nie może przewidzieć jakości wyników dla żadnego protokołu utworzonego lub edytowanego przez użytkownika. Po potwierdzeniu zmiany protokołu zostaną zapisane.

## 7.4 Edytowanie protokołów użytkownika

Protokoły użytkownika (z wyłączeniem protokołów Leica Biosystems) można edytować w oknie dialogowym **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu). Aby edytować protokół, zaznaczyć go na liście na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów), a następnie kliknąć przycisk **Open** (otwórz) lub dwukrotnie kliknąć protokół. Alternatywnie można również skonfigurować nowy protokół, kopiując istniejący protokół tego samego typu i edytując go (zob. [7.3 - Tworzenie nowych protokołów](#)).


W przypadku protokołów barwienia można dodawać i usuwać kroki dozowania odczynników oraz ustawiać nowe odczynniki i czasy inkubacji. Można również dodawać lub usuwać kroki płukania.


W przypadku protokołów barwienia wstępnego nie można zmienić liczby kroków, ale dopuszczalna jest zmiana temperatury i czasów inkubacji dla wybranych kroków. Lista dopuszczalnych zmian znajduje się w części [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#).

Ponieważ po dozowaniu nowego odczynnika musi następować płukanie, wstawienie nowego kroku dozowania odczynnika w protokole barwienia powoduje automatyczne dodanie „segmentu” składającego się z kroku dozowania odczynnika i trzech następujących po nim kroków płukania.

W trakcie edytowania protokołu zmiany lub nowe kroki, które zawierają wszystkie wymagane informacje, są oznaczone zielonym paskiem umieszczonym po lewej stronie. Kroki wymagające uzupełnienia informacji są oznaczone czerwonym paskiem.

Podczas edycji można przeglądać wszystkie kroki protokołów lub ukrywać kroki płukania za pomocą pola wyboru **Show wash steps** (pokaż kroki płukania) pod tabelą.


 W przypadku większości kroków protokołu ustawić czas inkubacji poniżej 30 minut. Ustawienie dłuższego czasu ten może spowodować wysychanie tkanki. Jeśli wymagany jest dłuższy czas inkubacji, należy zduplikować krok jeden lub więcej razy i rozdzielić wymagany czas pomiędzy te kroki. Jedynym wyjątkiem są kroki protokołu hybrydyzacji ISH, które są zawsze dłuższe niż 30 minut i nigdy nie powinny być dzielone na krótsze.

 Możliwość tworzenia i zapisywania protokołu nie oznacza, że jest on odpowiedni do zamierzonego zadania. Za testowanie i walidację dowolnego utworzonego lub edytowanego protokołu odpowiedzialność ponosi użytkownik.

- [7.4.1 - Edytowanie kroków protokołu](#)
- [7.4.2 - Dodawanie i usuwanie kroków protokołu](#)
- [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#)
- [7.4.4 - Typy urządzeń i wersje protokołów](#)
- [7.4.5 - Usuwanie protokołów](#)

### 7.4.1 Edytowanie kroków protokołu

W celu skonfigurowania nowego protokołu w oknie dialogowym **New protocol properties** (właściwości nowego protokołu) lub edytowania istniejącego protokołu w oknie dialogowym **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu) należy wykonać poniższe czynności. Aby zapewnić prawidłowość tworzonych protokołów, zapoznać się z częścią [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#).

 Przy każdym zapisie protokołu w systemie zachowywana jest jego kopia. Podczas tworzenia raportu dot. protokołu należy wybrać jedną z tych kopii (zob. [7.5 - Raporty dot. protokołów](#)). Aby uniknąć wielu nadmiarowych wersji danego protokołu, należy go zapisać dopiero po zakończeniu konfiguracji.

1. W przypadku nowych protokołów wpisać nazwę protokołu i skróconą nazwę.
2. Opcjonalnie wpisać opis protokołu.
3. Ustawić metodę barwienia dla protokołu barwienia (zob. [7.1.1 - Metody barwienia](#)).
4. Ustawić status **Preferred** (preferowany) protokołu (zob. [7.2.1.2 - Preferowany status](#)).
5. W przypadku protokołów barwienia z listy rozwijanej **Preferred detection system** (preferowany system detekcji) wybrać system detekcji do stosowania wraz z protokołem.
6. Dodawać lub usuwać kroki protokołu (zob. [7.4.2 - Dodawanie i usuwanie kroków protokołu](#)) do czasu uzyskania żądanej liczby kroków w protokole.
7. Zmienić parametry edytowalne w nowych i istniejących krokach protokołu, klikając dwukrotnie parametr, który ma zostać zmieniony:
  - i. Wybrać odczynnik z listy rozwijanej.  
**Uwaga:** Wybrać opcję \*MARKER, aby wskazać krok protokołu IHC, w którym używane jest przeciwciało pierwszorzędowe. W przypadku kroków płukania do wyboru dostępne są tylko opcje \*BOND Wash Solution (roztwór do płukania BOND) lub \*Deionized Water (\*woda dejonizowana).
  - ii. Ustawić czas inkubacji w minutach i sekundach (mm:ss). Jest to minimalny czas, przez jaki szkiełko będzie inkubowane przed przejściem do kolejnego kroku. Informacje na temat limitów czasu inkubacji znajdują się w kroku [9](#) w części [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#).  
  
 Ogólnie, w przypadku kroków, na których używane są odczynniki, firma Leica Biosystems zaleca ustawienie czasu inkubacji nieprzekraczającego 30 minut. Jeśli wymagany jest dłuższy czas, należy utworzyć zduplikowane kroki w celu dozowania tego samego odczynnika (zob. [7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania odczynników](#)).
  - iii. Ustawić temperaturę (w przypadku niektórych kroków protokołów barwienia wstępnego):  
  
 Jeśli koniecznej jest ustawienie temperatury, która nie jest temperaturą otoczenia, najpierw odznaczyć pole **Ambient** (temperatura otoczenia). Następnie zaznaczyć puste pole **Temperature** (temperatura) i wprowadzić temperaturę (liczbę całkowitą) w stopniach Celsjusza.  
  
 Jeśli wymagana jest zmiana temperatury na temperaturę otoczenia, zaznaczyć i sprawdzić parametr **Ambient** (temperatura otoczenia).  
  
 Dopuszczalne zakresy temperatur opisano w kroku [8](#) w części [7.4.3 - Reguły dla protokołów](#).
  - iv. Kliknąć dowolny inny krok, aby zatwierdzić zmienione parametry.

## 7.4.2 Dodawanie i usuwanie kroków protokołu

Kroki można dodawać i usuwać w przypadku protokołów IHC i ISH użytkownika, ale nie w przypadku protokołów barwienia wstępnego. Do dodawania i usuwania kroków służą przyciski znajdujące się pod tabelą z krokami protokołu. Przyciski te są kontekstowe, a ich dostępność i funkcje różnią się w zależności od wybranego kroku.


Szczegółowe instrukcje można znaleźć w następujących częściach:

- [7.4.2.1 - Segmenty dla odczynników](#)
- [7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania odczynników](#)
- [7.4.2.3 - Kroki płukania](#)

#### 7.4.2.1 Segmenty dla odczynników

Aby dodać nowy segment dla odczynników (krok dozowania odczynnika i trzy obowiązkowe kroki płukania):

1. Zaznaczyć odczynnik i kliknąć „Insert segment” (wstaw segment). Nowy segment zostanie wstawiony powyżej zaznaczonego odczynnika.

 W przypadku zaznaczenia ostatniego odczynnika nowy segment można wstawić poniżej tego odczynnika.

Na liście pojawi się nowy segment (z krokami dozowania odczynnika i płukania). Nowe kroki płukania są oznaczone zielonym paskiem, który wskazuje zmianę względem zapisanego protokołu. Krok dozowania odczynnika jest oznaczony czerwonym paskiem wskazującym konieczność wybrania odczynnika dla tego kroku.

2. Dwukrotnie kliknąć puste pole „Reagent” (odczynnik) i wybrać żądany odczynnik z listy rozwijanej. W razie potrzeby zmodyfikować pozostałe parametry nowych kroków dozowania odczynnika i płukania.

Aby usunąć segment, zaznaczyć odczynnik i kliknąć „Delete segment” (usuń segment). Aby usunąć segment ze zduplikowanym odczynnikiem, najpierw należy usunąć duplikat.


#### 7.4.2.2 Zduplikowane kroki dozowania odczynników

Zduplikowany krok to taki, w którym dwa lub więcej identycznych odczynników jest dozowanych tuż po sobie bez płukania po każdym odczynniku.

1. Z listy kroków wybrać krok dozowania odczynnika do zduplikowania.
2. Kliknąć **Duplicate** (duplikuj).
3. Nad bieżącym krokiem zostanie dodany nowy krok o parametrach identycznych jak w bieżącym kroku.


Nowy krok jest oznaczony zielonym paskiem, który wskazuje zmianę względem zapisanego protokołu.


4. W razie potrzeby zmienić edytować czas inkubacji dla nowego kroku.


 W przypadku zmiany typu odczynnika w zduplikowanym kroku zmianie ulegną również wszystkie pozostałe kroki dozowania odczynników w sekwencji, ponieważ w zduplikowanych krokach musi być użyty ten sam odczynnik.

Aby usunąć zduplikowany krok, należy go zaznaczyć i kliknąć **Delete duplicate** (usuń duplikat).

#### 7.4.2.3 Kroki płukania

 Dodanie kroków płukania może zmienić właściwości płynu na szkiełkach i negatywnie wpłynąć na barwienie. Przed użyciem do celów diagnostycznych należy zawsze przeprowadzić walidację nowych lub edytowanych protokołów.

 Przed każdym krokiem dozowania chromogenu oraz po nim musi znajdować się krok płukania wodą dejonizowaną.

 Jeśli kroki płukania nie są wyświetlane, zaznaczyć opcję **Show wash steps** (pokaż kroki płukania) znajdującą się pod listą kroków.

Aby wstawić dodatkowy krok płukania:

1. Zaznaczyć istniejący krok płukania na liście kroków (protokoły IHC i ISH).
2. Kliknąć **Insert wash** (wstaw płukanie).


W przypadku protokołów IHC i ISH nowy krok płukania jest dodawany na końcu bieżącej sekwencji płukania.

Nowy krok płukania jest oznaczony zielonym paskiem, który wskazuje zmianę względem zapisanego protokołu.

3. W razie potrzeby zmodyfikować parametry kroku płukania na liście kroków.

Aby usunąć krok płukania, zaznaczyć go i kliknąć **Delete wash** (usuń płukanie). W przypadku protokołów IHC i ISH można usuwać tylko te kroki płukania, które następują po trzech obowiązkowych krokach sekwencji płukania.

#### 7.4.2.4 Kroki przygotowywania


-  Do protokołu przygotowywania można dodać lub usunąć (ale nie edytować) kroki dotyczące odparafinowania i dozowania alkoholu, i ile przestrzegane są pewne reguły.

Aby wstawić dodatkowy krok odparafinowania:

4. Z listy kroków wybrać istniejący krok odparafinowania.
5. Kliknąć **Insert reagent** (wstaw odczynnik).

Nowy krok odparafinowania zostanie dodany powyżej wybranego kroku odparafinowania.

Aby usunąć krok odparafinowania, zaznaczyć go i kliknąć **Delete step** (usuń krok).


-  Przeznaczony do usunięcia krok odparafinowania mieć ustawioną temperaturę inną niż temperatura otoczenia. Ponadto protokół musi zawierać więcej niż trzy kroki odparafinowania.

Aby wstawić dodatkowy krok dozowania alkoholu:

1. Z listy kroków wybrać istniejący krok dozowania alkoholu.
2. Kliknąć **Insert wash** (wstaw płukanie).

Nowy krok dozowania alkoholu zostanie dodany powyżej wybranego kroku dozowania alkoholu.

Aby usunąć krok dozowania alkoholu, zaznaczyć go i kliknąć **Delete step** (usuń krok).

-  Ponadto protokół musi zawierać więcej niż trzy kroki dozowania alkoholu.

### 7.4.3 Reguły dla protokołów

Każdy utworzony lub edytowany protokół musi być zgodny z podstawowymi regułami. Jednakże reguły te nie gwarantują, iż zastosowanie protokołu przyniesie akceptowalne wyniki.

1. Nazwa protokołu musi:
  - i. być unikatowa;
  - ii. zaczynać się od znaku innego niż spacja lub gwiazdka.
2. Skrócona nazwa protokołu musi:
  - i. być unikatowa;
  - ii. zaczynać się od znaku innego niż spacja lub gwiazdka;
  - iii. składać się z maksymalnie 8 znaków.
3. Wszystkie protokoły IHC muszą zawierać co najmniej jeden krok oznaczania markerem.
4. Wszystkie protokoły barwienia muszą zawierać co najmniej jeden odczynnik z systemu detekcji Leica Biosystems.
5. Po kroku dozowania odczynnika muszą następować albo trzy kroki płukania (co najmniej), albo krok dozowania tego samego odczynnika.
6. W przypadku protokołów barwienia ostatnie trzy kroki muszą być krokami płukania.
7. W przypadku protokołów barwienia IHC wszystkie temperatury muszą być temperaturami otoczenia.
8. W przypadku protokołów barwienia wstępnego temperatura w krokach o podwyższonej temperaturze musi mieścić się w zakresie podanym w tabeli:

<b>Krok protokołu</b>	<b>Zakres temperatury (°C)</b>
Podgrzewanie i odparafinowanie, krok podgrzewania	35 – 72
Obróbka termiczna	35 – 100
Wstępna obróbka enzymatyczna	35 – 100
Denaturacja	70 – 100
Hybrydyzacja	37 – 65

9. Czasy inkubacji dla kroku, definiowane w minutach i sekundach (mm:ss), powinny mieścić się w zakresie podanym w poniższej tabeli. Zakresy te nie są jednak wymuszane:

<b>Krok protokołu</b>	<b>Zakres inkubacji (minuty)</b>
Podgrzewanie i odparafinowanie, krok podgrzewania	0 – 60
Obróbka termiczna (kroki o temperaturze otoczenia)	0 – 15
Obróbka termiczna (kroki o podwyższonej temperaturze)	5 – 60
Wstępna obróbka enzymatyczna (krok 1)	0
Wstępna obróbka enzymatyczna (kroki dozowania enzymów)	0 – 15

<b>Krok protokołu</b>	<b>Zakres inkubacji (minuty)</b>
Denaturacja	5 – 20
Hybrydyzacja	20 – 950
Protokoły barwienia, kroki dozowania odczynników	0 – 60
Protokoły barwienia, kroki płukania	0 – 55

Ogólnie, w przypadku kroków, na których używane są odczynniki, należy ustawić czas inkubacji nieprzekraczający 30 minut. Jeśli wymagany jest dłuższy czas, należy utworzyć zduplikowane kroki w celu dozowania tego samego odczynnika (zob. [7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania odczynników](#)).

10. Każdy krok musi mieć zdefiniowany odczynnik, czas inkubacji i (w stosownych przypadkach) temperaturę.
11. Protokoły barwienia pojedynczego i sekwencyjnego barwienia podwójnego mogą mieć tylko jeden odczynnik mieszany (np. mieszany DAB) na protokół, używany w maksymalnie dwóch krokach protokołu. (W związku z tym procedura sekwencyjnego barwienia podwójnego może mieć przypisane dwa odczynniki mieszane – po jednym na każdy protokół – i maksymalnie cztery kroki aplikacji – po dwa na każdy protokół).  
Procedura równoczesnego barwienia podwójnego może mieć przypisane dwa zmieszane odczynniki, z których każdy może być stosowany w protokole do dwóch razy.
12. Wszystkie składniki wymagane do sporządzenia mieszanego odczynnika używanego w protokole barwienia muszą pochodzić z zestawu preferowanego dla tego protokołu.

#### 7.4.4 Typy urządzeń i wersje protokołów

W systemach BOND z modułami przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX każdy protokół może mieć oddzielne wersje dla obu typów modułów. Różne wersje „tego samego” protokołu pozwalają skompensować wynikające z charakterystyki modułów różnice, takie jak szybsze chłodzenie w urządzeniach BOND-III (kroki, na których szkiełka są chłodzone, są zazwyczaj krótsze w protokołach w wersji dla modułu BOND-III niż odpowiednie kroki w protokołach w wersji dla modułu BOND-MAX). Niektóre różnice w wersjach protokołu mogą nie być widoczne na liście kroków wyświetlanej w oprogramowaniu; przykładowo protokoły w wersji BOND-III obejmują ukryte instrukcje dla robotów odczynników zbiorczych, w które urządzenie nie BOND-MAX jest wyposażone.

Wszystkie wstępnie zdefiniowane protokoły w systemach BOND są dostępne w wersjach zarówno dla modułu BOND-III, jak i modułu BOND-MAX. Jeśli jednak do systemu zostanie dodany nowy typ urządzenia, należy utworzyć nowe wersje istniejących protokołów zdefiniowanych przez użytkownika, dostosowane do nowego typu urządzenia. W tym celu należy skopiować („zaimportować”) odpowiednią wersję innego protokołu, a następnie wprowadzić w tej kopii wszelkie wymagane zmiany (zob. poniżej).

#### 7.4.4.1 Importowanie wersji protokołu

Aby utworzyć wersję protokołu dla nowego typu urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Metoda ta może zostać również wykorzystana do zastąpienia istniejących wersji protokołu, jednak po zakończeniu wstępnej konfiguracji nie powinno to być konieczne.

1. Z poziomu ekranu **Protocol setup** (konfiguracja protokołów) wybrać protokół użytkownika, dla którego ma zostać utworzona nowa wersja. Kliknąć opcję **Open** (otwórz).  
Otwarte zostanie okno dialogowe **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu).
2. Kliknąć **Import protocol** (importuj protokół).  
Otwarte zostanie okno dialogowe **Import protocol** (importuj protokół).
3. Wybrać nowy typ urządzenia z listy **Processing modules** (moduły przetwarzania).  
Lista protokołów wyświetlanych w oknie dialogowym jest aktualizowana tak, aby wyświetlać tylko protokoły z wersjami dostosowanymi do wybranego typu urządzenia.
4. Opcjonalnie zaznaczyć lub odznaczyć opcję **Preferred** (preferowany), aby wyświetlić tylko preferowane lub wszystkie protokoły.
5. Wybrać protokół z listy, skopiować i kliknąć **Import** (importuj).  
Aby ułatwić późniejszą konfigurację, wybrać protokół jak najbardziej zbliżony do protokołu, dla którego tworzona jest nowa wersja. Przykładowo wybrać protokół, który wykorzystuje ten sam system detekcji i, jeśli to możliwe, ma taką samą liczbę kroków.  
Okno dialogowe **Import protocol** (importuj protokół) zostanie zamknięte. Pola na karcie nowego typu urządzenia w oknie dialogowym **Edit protocol properties** (edytuj właściwości protokołu) zostanie teraz wypełniona danymi z zaimportowanej wersji protokołu.



Aktualizowana jest tylko karta dla wybranego typu urządzenia.

6. Należy edytować nową wersję protokołu, aby była ona równoważna z istniejącą wersją protokołu (zob. [7.4.1 - Edytowanie kroków protokołu](#)). Nawigacja pomiędzy kartami modułu przetwarzania nie powoduje utraty danych.
7. Kliknąć **Save** (zapisz).



Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy protokoły gwarantują równoważne barwienie dla obu typów modułów przetwarzania.

#### 7.4.5 Usuwanie protokołów

Aby usunąć protokół użytkownika, zaznaczyć go na liście na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów), a następnie kliknąć przycisk **Delete** (usuń).

Wstępnie zdefiniowanych protokołów Leica Biosystems (zaczynających się od gwiazdki) nie da się usunąć. Można jednak je ukryć – w tym celu otworzyć dany protokół i usunąć zaznaczenie **Preferred** (preferowany), a następnie ustawić filtr **Preferred status** (preferowany status) na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów) na „Preferred” (preferowany).



## 7.5 Raporty dot. protokołów

Raporty dot. protokołów zawierają szczegóły kroków wybranych protokołów. Aby wygenerować raport, zaznaczyć protokół na liście na ekranie **Protocol setup** (konfiguracja protokołów), a następnie kliknąć przycisk **Report** (raport). Jeśli system zawiera oba urządzenia BOND-MAX oraz BOND-III, wybrać typ modułu przetwarzania dla żądanej wersji protokołu, a następnie kliknąć przycisk **Generate report** (generuj raport). Można również wybrać bieżącą lub wcześniej używaną wersję protokołu. Po zakończeniu kliknąć **Generate report** (generuj raport).

Raport zostanie wyświetlony w nowym oknie. W prawym górnym rogu raportu znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
Full name (pełna nazwa)	Pełna nazwa protokołu.
ID	Unikalny numer identyfikacyjny protokołu.
Type (typ)	Typ protokołu (zob. <a href="#">7.1 - Typy protokołów</a> ).
Created by (utworzony przez)	Nazwa użytkownika, który utworzył wyświetlaną wersję protokołu.
Creation time (czas utworzenia)	W przypadku wstępnie zdefiniowanych protokołów jest to data i godzina zaimportowania protokołu do bazy danych. W przypadku protokołów zdefiniowanych przez użytkownika jest to data i godzina utworzenia.
Placówka	Nazwa placówki wprowadzona na ekranie <b>Laboratory settings</b> (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego (zob. <a href="#">10.5.1 - Ustawienia laboratorium</a> ).
Staining status (status barwienia)	Metody barwienia, do których przeznaczony jest protokół (barwienie podwójne lub pojedyncze) (zob. <a href="#">7.2.1.1 - Metoda barwienia</a> ).


Treść raportu zawiera następujące informacje dla każdego kroku:

- Odczynnik i dostawca
- Typ kroku (dozowanie odczynnika lub płukanie)
- Czas inkubacji
- Temperature (temperatura)
- Typ dozowania (położenie szkiełka nakrywkowego Covertile i objętość dozowania – dane te mogą być wymagane przez technika serwisowego)

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 7.6 Wstępnie zdefiniowane protokoły

W poniższych częściach opisano wstępnie zdefiniowane protokoły dostarczane w ramach oprogramowania BOND.

 W przypadku dokonania aktualizacji przed wprowadzeniem na rynek następnej wersji oprogramowania lista protokołów może ulec zmianie. Poniższa lista była aktualna w momencie publikacji.


- [7.6.1 - Protokoły barwienia](#)
- [7.6.2 - Protokoły barwienia wstępnego](#)

### 7.6.1 Protokoły barwienia

Każdy protokół barwienia jest przeznaczony do stosowania z określonym systemem detekcji BOND.

Szczegółowe informacje na temat każdego systemu detekcji znajdują się w literaturze dołączonej do każdego produktu lub na stronie internetowej Leica Biosystems: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

Protokoły te można wykorzystać jako podstawowe bloki ułatwiające tworzenie własnych protokołów użytkownika poprzez edycję wstępnie zdefiniowanych protokołów (zob. [7.3 - Tworzenie nowych protokołów](#) oraz [7.4 - Edytowanie protokołów użytkownika](#)).

 Niektóre z wymienionych poniżej protokołów są przeznaczone do stosowania z systemami detekcji, które mogą nie być zatwierdzone przez organy regulacyjne w danym regionie. Protokoły te nie będą wyświetlane w oprogramowaniu.

#### 7.6.1.1 IHC

Nazwa	Preferowany system detekcji	Uwagi dotyczące systemu detekcji
*Protokół IHC B	Bond Intense R Detection	System wykorzystujący kompleks streptawidyna-biotyna odpowiedni do zastosowań badawczych wymagających otwartego doboru przeciwciała drugorzędowego. Umożliwia blokowanie nadtlenu, intensywne barwienie DAB i kontrastowe barwienie hematoksyliną (w tym barwienie na niebiesko).
*Protokół IHC F	Bond Polymer Refine Detection	Niezawierający biotyny system detekcji o wysokim stopniu amplifikacji, zoptymalizowany pod kątem stosowania w systemie BOND. Umożliwia wyraźne identyfikowanie antygenów związanych z błoną dzięki wysokiej intensywności barwienia.

Nazwa	Preferowany system detekcji	Uwagi dotyczące systemu detekcji
*Protokół IHC H	Bond™ Oracle™ HER2 IHC System  UWAGA: Dostępność tego protokołu zależy od dopuszczenia przez organy regulacyjne.	Kompletny system detekcji HER2, składający się z pierwszorzędowego przeciwciała HER2 i ujemnej próbki kontrolnej HER2, uzupełnionych wysoce czułym systemem detekcji opartym na technologii Compact Polymer.  System zawiera szkiełka kontrolne specyficzne dla danego profilu HER2, umożliwiające w pełni zautomatyzowane, spójne profilowanie immunohistochemiczne HER2 metodą barwienia kontrastowego.
*Protokół IHC J	BOND Polymer Refine Red Detection	Przeznaczony do badań in vitro, wysoce czuły system detekcji oparty na technologii Compact Polymer, umożliwiający immunobarwienie fosfatazą alkaliczną na jaskrawoczerwono oraz kontrastowe barwienie hematoksyliną (w tym barwienie na niebiesko).
*Protokół IHC K	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (100 testów)	D wykrywania in vitro związanych tkankowo mysich i króliczych pierwszorzędowych przeciwciał IgG.  Przeznaczony do barwienia skrawków utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek w systemie BOND.
*Protokół IHC K – 50 testów	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (50 testów)	D wykrywania in vitro związanych tkankowo mysich i króliczych pierwszorzędowych przeciwciał IgG.  Przeznaczony do barwienia skrawków utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek w systemie BOND.

7.6.1.2 ISH

Nazwa	Preferowany system detekcji	Uwagi dotyczące systemu detekcji
*Protokół FISH A	System Leica HER2 FISH System – 30 testów  UWAGA: Dostępność tego protokołu zależy od dopuszczenia przez organy regulacyjne.	Kompletny system LSI HER2/CEP17 FISH z dwiema sondami RTU HER2/CEP17 i roztworem do płukania po hybrydyzacji 2. Wykrywa amplifikację genu HER2 metodą FISH w utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie próbkach tkanki ludzkiego raka piersi. Do stosowania w diagnostyce in vitro.  Uwaga: LSI i CEP są znakami towarowymi firmy Abbott Molecular Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Używane na podstawie licencji.
*Protokół ISH A	BOND Polymer Refine Detection	Niezawierający biotyny system detekcji o wysokim stopniu amplifikacji, zoptymalizowany pod kątem stosowania w systemie BOND. Wykrywa RNA za pomocą linkera anty-FITC.

Nazwa	Preferowany system detekcji	Uwagi dotyczące systemu detekcji
*Protokół ISH B	BOND Polymer Refine Detection	Niezawierający biotyny system detekcji o wysokim stopniu amplifikacji, zoptymalizowany pod kątem stosowania w systemie BOND. Wykrywa DNA za pomocą linkera antybiotyny.

## 7.6.2 Protokoły barwienia wstępnego

Typ protokołu	Nazwa protokołu	Uwagi
Preparation (przygotowanie)	*Dewax	Do usuwania parafiny, w której zatopiona jest tkanka, oraz do uwadniania próbek w protokołach przygotowywania wykorzystywany jest roztwór BOND Dewax Solution.
	*Podgrzewanie i odparafinowanie	Przed odparafinowaniem tkanka jest podgrzewana, aby lepiej przylegała do szkła. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w części <a href="#">14.2.3 - Odparafinowanie i podgrzewanie</a>
Obróbka termiczna	*HIER z ER1 lub ER2	W procesie odsłaniania epitopu w podwyższonej temperaturze skrawek tkanki jest poddawany działaniu podgrzanego roztworu buforowego, co pomaga zmienić konformację tkanki i poprawia jakość barwienia. Istnieje wiele wstępnie zdefiniowanych protokołów wstępnej obróbki termicznej, różniących się długością trwania i temperaturą.
Wstępna obróbka enzymatyczna	*Enzym 1 *Enzym 2 *Enzym 3 *Enzym 5	Dostępnych jest osiem protokołów wstępnej obróbki enzymatycznej.  Protokoły te różnią się od siebie stosowanym enzymem i czasem inkubacji.
ISH Denaturacja	*Denaturacja (10 min)	Dostępny jest jeden wstępnie zdefiniowany protokół denaturacji ISH (trwający 10 minut).
ISH Hybrydyzacja	*Hybrydyzacja ISH (2 godz.) *Hybrydyzacja ISH (12 godz.)	Dostępne są dwa wstępnie zdefiniowane protokoły hybrydyzacji ISH (trwające 2 godziny oraz 12 godzin).

# 8. Zarządzanie odczynnikami (kontroler BOND )

System BOND tworzy rejestr wszystkich używanych odczynników innych niż zbiorcze, śledząc wszystkie pojemniki na odczynniki i ich zawartość. Umożliwia również skonfigurowanie paneli szkiełek z określonymi markerami, co pozwala przyspieszyć tworzenie przypadków.

Ten rozdział zawiera następujące części:

- [8.1 - Przegląd zarządzania odczynnikami](#)
- [8.2 - Ekran konfiguracji odczynników](#)
- [8.3 - Ekran rejestru odczynników](#)
- [8.4 - Ekran paneli odczynników](#)

## 8.1 Przegląd zarządzania odczynnikami

Zarządzanie odczynnikami w systemie BOND obejmuje konfigurację i w razie potrzeby modyfikację szczegółów poszczególnych odczynników, zarządzanie rejestrem wszystkich pakietów odczynników (z wyłączeniem odczynników zbiorczych) i tworzenie zestawów markerów, zwanych „panelami”, do wykorzystania podczas tworzenia szkiełek.

Aby otworzyć ekrany zarządzania odczynnikami, z poziomu których wykonywane są te operacje, kliknąć ikonę **Reagent setup** (konfiguracja odczynników) na pasku funkcji.



Kliknąć kartę w lewym górnym rogu ekranu, aby otworzyć żądany ekran (**Setup** (konfiguracja), **Inventory** (rejestr) lub **Panels** (panele)).

Name	Abb. name	Type	Supplier	Pref.
*CD10 (56C6)	*CD10	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD15 (Caib-1)	*CD15	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD20 (M11)	*CD20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD25 (4C3)	*CD25	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD30 (1G12)	*CD30	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD5 (4C7)	*CD5	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD56 (CD564)	*CD56	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD7 (LPH5) "NEW"	*CD7	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 20 (Ks20.8)	*CK20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 20 (PW31)	*CK20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 7 (RN7)	*CK7	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Estrogen Receptor (ER11)	*ER	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)	*GFAP	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin A (HNCLA)	*IgA	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin D (DRN1C)	*IgD	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin G (Polyclonal)	*IgG	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Melan A (A103)	*MelA	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Negative	*Neg	Primary antibody	Laboratory Specified	✓

Package type: All reagents | Reagent type: Primaries | Supplier: Leica Microsystems | Preferred status: Preferred

Postać 8-1: Ekran konfiguracji odczynników

Na ekranie **Reagent setup** (konfiguracja odczynników) wyświetlana jest pełna lista wszystkich odczynników znanych systemowi BOND. Lista nie obejmuje żadnych wstępnie skompletowanych systemów odczynników, np. systemów detekcji BOND, ale zawiera odczynniki składowe tych systemów. Zawiera również odczynniki mieszane w module przetwarzania ze składników systemu detekcji. Ekran służy do wyświetlania właściwości odczynników, tworzenia nowych odczynników w systemie i ustawiania opcji odczynników.

Ekran **Reagent inventory** (rejestr odczynników) zawiera z kolei listę systemów odczynników oraz odczynniki znajdujące się w osobnych pakietach. W przypadku dowolnego typu odczynnika lub systemu lista pokazuje całkowitą ilość zapasów wraz z informacjami o poszczególnych pakietach.

Z poziomu ekranu **Reagent panels** (panele odczynników) można tworzyć zestawy markerów używanych w przypadku konkretnych badań. Podczas tworzenia szkiełek w oprogramowaniu BOND wybór panelu powoduje utworzenie szkiełek dla każdego markera w panelu, co znacznie przyspiesza ten proces.

- [8.1.1 - Informacje ogólne](#)
- [8.1.2 - Systemy teranostyczne](#)

## 8.1.1 Informacje ogólne

- [8.1.1.1 - Kategorie odczynników](#)
- [8.1.1.2 - Przebieg pracy z odczynnikami](#)
- [8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika](#)
- [8.1.1.4 - Zastępowanie odczynników](#)

### 8.1.1.1 Kategorie odczynników

Oprócz płynów zbiorczych w systemie BOND można stosować cztery różne „typy pakietów” odczynników:

- Systemy detekcji BOND: wstępnie skompletowane tace z odczynnikami detekcyjnymi do stosowania w połączeniu z markerami wybranymi przez użytkownika podczas konfiguracji szkiełka
- Systemy teranostyczne Leica: wstępnie skompletowane tace z markerami, odczynnikami pomocniczymi i odczynnikami detekcyjnymi do pomocy w ocenie pacjentów, w przypadku których rozważa się podanie określonego leku; systemy mogą obejmować również szkiełka kontrolne (zob. [14.1.2 - Systemy teranostyczne](#))
- Systemy czyszczenia BOND: wstępnie skompletowane tace z odczynnikami do czyszczenia urządzenia (zob. [12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej](#))
- Pojemniki na odczynniki: pojedyncze pojemniki na odczynniki zawierające markery (przeciwciała pierwszorzędowe lub sondy) bądź odczynniki pomocnicze – w pojemnikach gotowych do użycia lub otwartych pojemnikach (zob. [2.6.3 - Systemy odczynników i pojemniki na odczynniki](#))

Systemy detekcji BOND, systemy czyszczenia i systemy teranostyczne określane są łącznie jako „systemy odczynników”.

„Marker” odnosi się do przeciwciała pierwszorzędowego w badaniach IHC lub sondy w badaniach ISH.

Odczynniki dzielą się na następujące „typy odczynników”:

- Pierwszorzędowy: odczynnik znakujący stosowany w badaniach IHC
- Sonda: odczynnik znakujący używany w badaniach ISH
- Pomocnicze: wszystkie odczynniki nieznakujące stosowane do przetwarzania tkanek przed barwieniem z użyciem markera lub po barwieniu
- Mieszane: odczynniki pomocnicze utworzone podczas wykonywania protokołu ze składników znajdujących się w systemie odczynników lub składników pochodzących z poszczególnych pojemników. W urządzeniu nigdy nie jest przechowywany zapas odczynników mieszanych, jednak muszą one istnieć w systemie do zastosowania na określonych krokach protokołu.

Listę odczynników i systemów odczynników na ekranach **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) oraz **Reagent Inventory** (rejestr odczynników) można filtrować zgodnie z tą klasyfikacją.

### 8.1.1.2 Przebieg pracy z odczynnikami

Zanim system BOND będzie mógł użyć danego odczynnika, odczynnik ten musi zostać właściwie rozpoznany. Proces rozpoznawania obejmuje trzy etapy:

1. Dany typ odczynnika musi znajdować się na liście odczynników na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) – na liście wstępnie zdefiniowane są odczynniki gotowe do użycia Leica Biosystems i odczynniki pomocnicze Leica Biosystems (łącznie z odczynnikami z systemów detekcji, systemów teranostycznych i systemów czyszczenia BOND), jednak pozostałe odczynniki muszą zostać dodane do listy przez użytkowników.
2. Po zarejestrowaniu nowego zapasu poszczególne pojemniki na odczynniki i systemy odczynników są skanowane lub „zarejestrowane” w systemie BOND, co powoduje dodanie ich do rejestru.
1. Kiedy odczynnik lub system są gotowe do użycia, zostają załadowane na tacę na odczynniki, gdzie system BOND je identyfikuje i aktualizuje rejestr w miarę zużywania się odczynnika.

Oprogramowanie BOND rejestruje zużycie dla każdego indywidualnego pojemnika i systemu, a także łączne wartości zużycia dla każdego typu odczynnika. W przypadku odczynników Leica Biosystems można ustawić wartość graniczną, po osiągnięciu której program będzie informował, że zapas odczynnika jest niski. Zob. [Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów](#) w części [8.3.2 - Szczegóły odczynnika lub systemu odczynników](#)

### 8.1.1.3 Identyfikacja odczynnika

Poszczególne pojemniki na odczynniki mają dwa kody kreskowe wykorzystywane do identyfikacji. Dłuższe kody kreskowe z przodu pojemników są używane do rejestrowania pojemników i ich identyfikacji po zarejestrowaniu (zob. [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#)). Krótsze kody kreskowe na górze pojemników (pod pokrywami) zawierają unikatowe identyfikatory opakowań (UPI) używane przez system BOND do identyfikacji pojemników po ich załadowaniu do modułów przetwarzania. UPI umożliwi również ręczne zidentyfikowanie załadowanego pojemnika na odczynniki, który nie został pomyślnie zeskanowany (zob. [5.1.3.5 - Rozwiązywanie problemów z niewykrytymi odczynnikami](#)).

Systemy odczynników są oznaczone dwoma kodami kreskowymi umieszczonymi na boku tac. Do rejestrowania systemów i ich identyfikowania po zarejestrowaniu należy używać obu kodów kreskowych. Kody kreskowe UPI pojemników w systemach odczynników znajdują się na górze i z przodu każdego pojemnika. Oprogramowanie BOND wykorzystuje je do identyfikowania systemów załadowanych do modułów przetwarzania. Jeśli automatyczna identyfikacja pojemników nie powiedzie się, kody te należy wprowadzić ręcznie.

Informacje o dowolnym zarejestrowanym odczynniku lub systemie odczynników można wyświetlić w dowolnym momencie, ponownie skanując długi kod kreskowy z boku danego pojemnika lub dwa kody kreskowe na bokach systemu odczynników.

Jeśli pakiet nie zostanie zeskanowany, otworzyć okno dialogowe **Manual ID entry** (ręczne wprowadzanie ID), klikając ikonę **Search** (szukaj) na pasku funkcji lub przycisk **Enter ID** (wprowadź ID) na ekranie **Reagent Inventory** (rejestr odczynników).

Wpisać ID pakietu i kliknąć **Validate** (walidacja) (w przypadku systemów odczynników kliknąć **Validate** (walidacja) po wprowadzeniu każdego kodu kreskowego). Spowoduje to wyświetlenie danych pojemnika lub systemu w oknie dialogowym **Reagent inventory details** (szczegóły rejestru odczynników) lub **Reagent system inventory details** (szczegóły rejestru systemu odczynników).





### 8.1.1.4 Zastępowanie odczynników

Przed rozpoczęciem przetwarzania należy załadować wystarczającą ilość wszystkich wymaganych odczynników do modułu przetwarzania. Czasami jednak, mimo początkowej obecności, dany odczynnik może okazać się niedostępny. Może to być spowodowane wyjęciem tacy na odczynniki przez operatora lub niższym niż początkowo zakładano poziomem w pojemniku na odczynniki. Wówczas system BOND podejmie próbę zastąpienia brakującego odczynnika odczynnikami tego samego typu z innego pojemnika. Podczas zastępowania brakującego odczynnika system BOND stosuje następujące zasady:

- System początkowo próbuje zastąpić brakujący odczynnik odczynnikami tego samego typu pochodzącym z tego samego systemu odczynników.  
Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, przebieg będzie kontynuowany bez powiadomienia.
- Następnie system próbuje zastąpić brakujący odczynnik odczynnikami z alternatywnego źródła, mającym ten sam typ i ten sam numer partii.  
Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, przebieg będzie kontynuowany bez powiadomienia.
- Następnie system próbuje zastąpić brakujący odczynnik odczynnikami z alternatywnego źródła, mającym ten sam typ ale inny numer partii.  
Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, przebieg będzie kontynuowany, ale szkiełka przetwarzane przy użyciu zastępczego odczynnika będą wyświetlane z powiadomieniem o zdarzeniu.
- Jeśli zamiana odczynnika nie jest możliwa, odczynnik zostanie zastąpiony odczynnikami zbiorczym dla wszystkich szkiełek z przypisanym tym odczynnikiem do końca przebiegu.  
Przebieg będzie kontynuowany, ale szkiełka przetwarzane przy użyciu zastępczego odczynnika będą wyświetlane z powiadomieniem o zdarzeniu.
- Jeśli zmiana ma wpływ na wszystkie szkiełka, tzn. konieczne jest użycie odczynnika zbiorczego dla wszystkich szkiełek, przebieg zostanie przerwany.

## 8.1.2 Systemy teranostyczne

Produkty teranostyczne Leica dla systemu BOND składają się z systemów odczynników i mogą zawierać szkiełka kontrolne. W takim przypadku wymagane są również standardowe odczynniki zbiorcze i – dla niektórych systemów – odczynniki pomocnicze.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji dołączonych do systemów teranostycznych i pamiętać o następujących kwestiach:

- Szkiełka kontrolne dostarczane wraz z systemem Bond™ Oracle™ HER2 IHC są nazywane szkiełkami kontrolnymi Oracle i różnią się od laboratoryjnych szkiełek kontrolnych stosowanych w przebiegach Oracle:
  - Laboratoryjne szkiełka kontrolne są tworzone przez oprogramowanie w oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko) z wykorzystaniem standardowych ustawień parametrów **Tissue type** (typ tkanki) i **Marker**, ale *nie* mają zaznaczonej opcji **Oracle control** (próbka kontrolna Oracle).
  - Szkiełka kontrolne Oracle muszą mieć, oprócz prawidłowej wartości parametru **Tissue type** (typ tkanki), mieć zaznaczoną opcję **Oracle control** (próbka kontrolna Oracle).
- Szkiełka kontrolne Oracle mogą być używane wyłącznie z systemem, z którego pochodzą.
- Etykiety szkiełek Oracle mają specjalny układ definiowany na ekranie **Labels** (etykiety) klienta administracyjnego (zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)).

## 8.2 Ekran konfiguracji odczynników

Na ekranie **Reagent setup** (konfiguracja odczynników) wyświetlana jest lista wszystkich odczynników znanych w oprogramowaniu BOND, obejmująca również systemy odczynników i odczynniki mieszane ze składnikami znajdujących się w systemie odczynników załadowanym do modułu przetwarzania. Lista zawiera również wszystkie wstępnie zdefiniowane, gotowe do użycia przeciwciała pierwszorzędowe BOND (których nie można usunąć), a także do użycia sondy ISH BOND i wiele powszechnie stosowanych odczynników pomocniczych Leica Biosystems.

Filtry poniżej tabeli umożliwiają wyświetlenie odczynników tylko wybranego typu. Filtrowanie wg typu pakietu nie jest możliwe, jednak dostępne są filtry typu odczynników (przeciwciała pierwszorzędowe, sondy, odczynniki pomocnicze, odczynniki mieszanych, odczynniki Oracle oraz przeciwciała pierwszorzędowe i sondy do równoczesnego barwienia podwójnego), dostawcy i preferowanego statusu.

Przyciski nad tabelą umożliwiają dodawanie nowych odczynników do listy; otwieranie okna odczynnika zaznaczonego w tabeli celem wyświetlenia lub edytowania jego szczegółów; lub usuwanie odczynnika zaznaczonego w tabeli (usuwać można tylko odczynniki inne niż produkowane przez Leica Biosystems).



Odczynników, które nie są wymienione na liście lub zostały zdefiniowane przez użytkownika jako niepreferowane, nie da się zarejestrować.

Tabela zawiera następujące szczegóły dla każdego odczynnika:

Nazwa	Pełna nazwa odczynnika. Początkowy znak „*” oznacza wstępnie zdefiniowany odczynnik Leica Biosystems.
Abb. name (skrót)	Krótką nazwą odczynnika używaną na etykietach szkiełek i na ekranie statusu.
Type (typ)	Typ odczynnika, na przykład „przeciwciała pierwszorzędowe”.
Supplier (dostawca)	Nazwa dostawcy odczynnika.
Pref. (preferowany):	Zaznaczone (preferowane) markery są uwzględniane na listach konfiguracji szkiełek w innych oknach oprogramowania BOND.

## Edytowalne właściwości odczynników

Oprócz nazwy i szczegółów dostawcy do edycji dostępne są następujące opcje odczynników:

1. W przypadku markerów:
  - i. Protokoły domyślne stosowane w momencie wybrania danego markera podczas tworzenia szkiełek (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)). Dla pojedynczej aplikacji markera oraz pierwszej i drugiej aplikacji podczas barwienia podwójnego można ustawić różne protokoły.
  - ii. Preferowany status – na liście rozwijanej **Marker** podczas tworzenia szkiełek (zob. [6.5.2 - Tworzenie szkiełek](#)) oraz na liście **Available markers** (dostępne markery) w oknie dialogowym **Reagent panels properties** (właściwości paneli odczynników) podczas tworzenia panelu (zob. [8.4.1 - Tworzenie panelu](#)) wyświetlane są tylko preferowane markery. Wg tej właściwości można również filtrować listy na ekranach odczynników.
  - iii. Status „niebezpieczny” – markery oznaczone jako niebezpieczne są usuwane do pojemnika na odpady niebezpieczne. W przypadku wstępnie zdefiniowanych odczynników tego ustawienia nie można zmienić.
2. W przypadku odczynników pomocniczych
  - i. Odczynniki zbiorcze zgodne z danym odczynnikiem – system BOND automatycznie zapobiega niezetknięciu się niezgodnych odczynników pomocniczych i odczynników zbiorczych.
  - ii. Preferowany status – wg tej właściwości można filtrować listy na ekranach odczynników.
  - iii. Status „niebezpieczny” – odczynniki oznaczone jako niebezpieczne są usuwane do pojemnika na odpady niebezpieczne. W przypadku wstępnie zdefiniowanych odczynników tego ustawienia nie można zmienić.

Zob. części:

- [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)
- [8.2.2 - Usuwanie odczynnika](#)


## 8.2.1 Dodawanie lub edytowanie odczynnika

Aby dodać odczynniki do listy, kliknąć przycisk **Add** (dodaj) na ekranie **Reagent setup** (konfiguracja odczynników). Oprogramowanie BOND wyświetli okno dialogowe **Add reagent** (dodaj odczynnik). Zob. [Postać 8-2](#) poniżej.

Postać 8-2: Okno dialogowe dodawania odczynnika

Aby zmienić szczegóły istniejącego odczynnika, zaznaczyć go i kliknąć **Open** (otwórz) lub kliknąć go dwukrotnie. Otworzy się okno dialogowe **Edit reagent properties** (edytuj właściwości odczynnika). Jest ono takie samo jak okno dialogowe **Add reagent** (dodaj odczynnik), tyle że zawiera szczegóły wybranego odczynnika.


Dodać lub edytować odczynnik zgodnie z następującymi zasadami:

1. W przypadku dodawania nowego odczynnika wprowadzić opisową nazwę w polu **Name** (nazwa). Nowe odczynniki nie mogą rozpoczynać się od „\*”, która jest zarezerwowana dla odczynników Leica Biosystems.
-  Należy zachować ostrożność, aby nie użyć nazwy, która może spowodować pomylenie tego odczynnika z innym podczas tworzenia protokołów lub szkiełek.
2. W przypadku nowych odczynników wprowadzić skróconą nazwę w polu **Abbreviated Name** (skrócona nazwa). Skrócone nazwy mogą zawierać maksymalnie osiem znaków. Nazwa ta pojawia się na ikonach szkiełek na ekranie **Status** i jest drukowana na etykietach szkiełek.
3. Jeśli system BOND jest podłączony do systemu LIS, w polu **Public name** (nazwa publiczna) wprowadzić nazwę odczynnika używaną w LIS (nie dotyczy odczynników pomocniczych).
4. W przypadku tworzenia nowego odczynnika wybrać typ odczynnika z listy rozwijanej **Type** (typ). Okno dialogowe zmieni się w zależności od wybranego typu.
5. Wprowadzić nazwę dostawcy odczynnika w polu **Supplier** (dostawca).

6. Jeżeli odczynnik jest markerem (tj. przeciwciałem pierwszorzędowym lub sondą RNA bądź DNA), wybrać domyślne protokoły do użycia w różnych typach tych przebiegów barwienia, w których używany jest marker.

Z listy **Single/double stain** (barwienie pojedyncze/podwójne) wybrać **Single/Sequential DS** (pojedyncze/sekwencyjne DS), a następnie na karcie **Single** (pojedyncze) ustawić domyślne protokoły dla markerów w przebiegach barwienia pojedynczego. W przypadku markerów w przebiegach sekwencyjnego barwienia podwójnego na kartach **First** (pierwszy) oraz **Second** (drugi) ustawić domyślne protokoły pierwszej i drugiej aplikacji.

Wybrać **Parallel DS** (równoczesne DS), aby ustawić domyślne protokoły dla markerów w przebiegach równoczesnego barwienia podwójnego.

-  Jeśli odczynnik jest sondą RNA lub DNA, na wszystkich wspomnianych kartach zostaną wyświetlone dodatkowe protokoły (denaturacji i hybrydyzacji).

W przypadku wstępnie zdefiniowanych markerów BOND, nacisnąć **Restore factory default protocols** (przywróć domyślne protokoły fabryczne), aby przywrócić ustawienia protokołów do domyślnych wartości fabrycznych zalecanych dla markera (przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga zalogowania się użytkownika o roli „przełożony”).

7. Tylko jeśli odczynnik został utworzony przez użytkownika jako odczynnik pomocniczy, sprawdzić zgodność roztworów zbiorczych i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian.

Dla większości systemów na liście **Compatible bulks** (kompatybilne odczynniki zbiorcze) będą wyświetlone roztwór BOND Wash Solution (\*BWash) i woda dejonizowana (\*DI). Oznacza to, że do pobrania i aspiracji odczynnika system płynów wykorzysta jeden z tych roztworów. Podczas gdy roztwory zbiorcze nie powinny stykać się bezpośrednio z odczynnikiem pomocniczym, może dojść do niewielkiego kontaktu z sondą aspiracyjną. Aby całkowicie tego uniknąć, wybrać roztwór zbiorczy, który ma nie stykać się z odczynnikiem, i kliknąć <<, aby przenieść go na listę **Available bulks** (dostępne odczynniki zbiorcze).

Co najmniej jeden roztwór zbiorczy musi być ustawiony jako kompatybilny.




W przypadku kontaktu niekompatybilnych ze sobą roztworów może dojść do uzyskania niezadowolających wyników barwienia i potencjalnego uszkodzenia modułu przetwarzania. Skontaktować się z firmą Leica Biosystems, aby ustalić, czy roztwory są kompatybilne.

8. W przypadku markerów zaznaczyć pole **Preferred** (preferowany), aby dane przeciwciała pierwszorzędowe lub sonda były wyświetlane w oknie dialogowym konfiguracji szkiełek.  
W przypadku odczynników pomocniczych status Preferred (preferowany) jest używany wyłącznie do filtrowania list na ekranach **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników) oraz **Inventory** (rejestr).
9. Jeśli odczynnik ma być sfluviwany do pojemnika na odpady niebezpieczne, zaznaczyć pole **Hazardous** (niebezpieczny).
10. Kliknąć **Save** (zapisz), aby dodać szczegóły odczynnika systemu BOND.

Kliknąć **Cancel** (anuluj) w dowolnym momencie podczas procesu, aby wyjść bez wprowadzania zmian.

## 8.2.2 Usuwanie odczynnika

Aby usunąć odczynnik, zaznaczyć go na liście na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników), a następnie kliknąć przycisk **Delete** (usuń). Wstępnie zdefiniowanych odczynników Leica Biosystems (zaczynających się od gwiazdki) nie da się usunąć.

-  Usunięcie szczegółów odczynnika powoduje również usunięcie szczegółów rejestru dla pakietów zawierających ten odczynnik. Usuniętych szczegółów odczynnika ani szczegółów rejestru nie można odzyskać.

Jeśli używany wcześniej odczynnik nie jest dłużej potrzebny, lepiej oznaczyć go jako niepreferowany niż usunąć. Dzięki temu odczynnik nie będzie wyświetlany na większości ekranów w oprogramowaniu, ale pozostanie w systemie.

## 8.3 Ekran rejestru odczynników

Ekran **Reagent Inventory** (rejestr odczynników) zawiera listę wszystkich odczynników i systemów odczynników zarejestrowanych kiedykolwiek w systemie BOND oraz bieżący stan zapasów. Z poziomu tego ekranu można przeglądać zapasy i zarządzać nimi.

**Reagent setup**

Setup | Inventory | Panels

Details | Enter ID | Details report | Reagent usage

Name	Supplier	Type	Catalog N°	Vol. (mL)	Min. (mL)
*Kappa Probe	Leica Microsystems	Probe RNA	PE0545	27.50	11.00
*CD15 (Cerb-1)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0039	44.85	7.00
GFAP (ER2, Enzyme1)	AAA Antibodies	Primary antibody	Open container	0.00	0.00
*Anti-Fluorescein Antibody	Leica Microsystems	Ancillary	AR0222	30.00	15.00
*CD30 (1G12)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0153	0.00	1.00
*Melan A (A103)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0233	7.00	0.00
*CD7 (LP15) "NEW"	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0017	0.00	14.00
*Lambda Probe	Leica Microsystems	Probe RNA	PE0569	16.50	5.50
*Estrogen Receptor (ER11)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0151	14.00	7.00
*CD5 (4C7)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0168	6.55	0.00
*Cytokeratin 20 (PW31)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0918	0.00	7.00
*Estrogen Receptor (ER11)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0009	0.00	10.00
*Immunoglobulin D...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0051	7.00	2.00
*Glial Fibrillary Acidic...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0026	0.00	5.00
*CD25 (4C9)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0305	47.50	14.00
*CD10 (5B2)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0131	0.00	0.00
*Immunoglobulin G...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0904	7.00	3.00
*CD20 (MJ1)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0906	47.55	14.00

Package type: Reagent containers | Reagent type: All | Inventory status: All | Supplier: All | Preferred status: Preferred

Postać 8-3: Ekran **Reagent Inventory** (rejestr odczynników)

Odczynniki Leica Biosystems o objętości mniejszej niż minimalny poziom zapasów są podświetlone na czerwono.

Filtry poniżej tabeli umożliwiają wyświetlenie odczynników lub systemów tylko wybranego typu.

W przypadku systemów detekcji BOND systemów Oracle i systemów czyszczenia – wybranych za pomocą filtra **Package type** (typ pakietu) – listę można filtrować tylko wg parametru **Inventory status** (status rejestru). Wówczas można wyświetlić albo wszystkie zarejestrowane systemy, albo tylko te systemy, dla których dostępny jest jeszcze zapas odczynników, albo te systemy, których zapas jest mniejszy niż poziom wskazujący na konieczność zamówienia nowych odczynników.

Listę poszczególnych pojemników na odczynniki można filtrować wg parametrów **Supplier** (dostawca), **Preferred status** (preferowany status) oraz **Reagent type** (typ odczynnika) (tj. „Primaries” (przeciwciała pierwszorzędowe), „Probes” (sondy), „Parallel DS Primaries” (przeciwciała pierwszorzędowe do równoczesnego barwienia podwójnego), „Parallel DS Probes” (sondy do równoczesnego barwienia podwójnego), „Ancillaries” (odczynniki pomocnicze) lub „All” (wszystkie)).

W zależności od typu odczynnika wyświetlane mogą być niektóre lub wszystkie poniższe szczegóły.

Nazwa	Pełna nazwa odczynnika.
Supplier (dostawca)	Nazwa dostawcy odczynnika. W przypadku systemów odczynników parametr ten nie jest wyświetlany.
Type (typ)	Typ odczynnika, na przykład „przeciwciąło pierwszorzędowe”. W przypadku systemów odczynników parametr ten nie jest wyświetlany.
Catalog No. (nr katalogowy)	Numer katalogowy odczynnika do podania podczas zamawiania. W przypadku systemów odczynników parametr ten nie jest wyświetlany (kolumna jest obecna, ale wszystkie jej pola są puste).
objętość (ml)	Całkowita dostępna ilość odczynnika. Wartość ta obejmuje wszystkie zarejestrowane pakiety odczynników, niezależnie od tego, czy są one załadowane do modułu przetwarzania, czy nie (zob. <a href="#">8.3.1 - Określanie objętości odczynnika</a> ).
Runs rem. (pozostałe przebiegi)	Dla systemów Oracle; liczba przebiegów, jakie jeszcze można przeprowadzić w systemie.
Cleans remaining (pozostałe cykle czyszczenia)	Liczba cykli czyszczenia pozostałych w systemach czyszczenia.
Min. (ml)	Tylko dla odczynników Leica Biosystems; poziom zapasów, po osiągnięciu którego zostanie wyświetlony monit o zamówienie odczynnika (zob. <a href="#">8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów</a> ).
Min. (runs) (min. liczba przebiegów)	Dla systemów Oracle; liczba pozostałych przebiegów, po osiągnięciu której wyświetlany jest monit o zamówienie systemu (zob. <a href="#">8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów</a> ).
Min. (cleans) (min. liczba cykli czyszczenia)	Dla systemów czyszczenia; liczba pozostałych cykli, po osiągnięciu której wyświetlany jest monit o zamówienie systemu (zob. <a href="#">8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów</a> ).



Przyciski sterowania nad tabelą odczynników umożliwiają zarządzanie rejestrem odczynników.

- Kliknąć przycisk **Details** (szczegóły), aby wyświetlić informacje o poszczególnych pakietach wybranego typu odczynnika i ustawić opcje tego odczynnika.  
Więcej informacji znajduje się w części [8.3.2 - Szczegóły odczynnika lub systemu odczynników](#).
- Kliknąć **Enter ID** (wprowadź ID), aby dodać rejestr danego odczynnika do systemu w oknie dialogowym **Manual ID entry** (ręczne wprowadzanie ID), jeśli ID nie zostanie automatycznie rozpoznane przez skaner ręczny.  
Więcej informacji znajduje się w części [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#).
- Kliknąć **Details report** (raport dot. szczegółów), aby wygenerować raport dla odczynników lub systemów odczynników aktualnie wymienionych w tabeli.  
Zob. [8.3.4 - Raport dot. szczegółów rejestru](#) .
- Kliknąć **Reagent usage** (użycie odczynnika), aby wygenerować raport dotyczący użycia odczynnika w określonym okresie.  
Zob. [8.3.5 - Raport dot. użycia odczynnika](#).

Ogólny opis sposobu śledzenia rejestru odczynników przez system BOND znajduje się w części [8.3.1 - Określanie objętości odczynnika](#) .

### 8.3.1 Określanie objętości odczynnika

System BOND wykorzystuje dwie metody określania objętości odczynnika w pojemnikach na tacy na odczynniki: oblicza objętość na podstawie początkowej objętości i późniejszego zużycia lub mierzy objętość bezpośrednio za pomocą czujnika poziomu cieczy (LLS).

Objętość jest obliczana zgodnie z następującą zasadą: od początkowej objętości odczynnika po każdej operacji dozowania odejmowana jest dozowana ilość odczynnika, a do uzyskanego wyniku dodawana jest objętość uzupełnienia (otwartego pojemnika). W przypadku utraty odczynnika przez odparowanie lub rozlanie mogą wystąpić rozbieżności.

System LLS jest zintegrowany z sondą aspiracyjną. Określa on objętości odczynników na podstawie wysokości odczynnika zmierzonej po zanurzeniu sondy aspiracyjnej w pojemniku. Przy ustawieniach domyślnych w pewnych warunkach, takich jak brak pomiaru objętości pojemnika przez ponad 30 dni, pomiar objętości LLS (często określany jako „test zanurzeniowy”) jest wykonywany automatycznie. Jest to spowodowane tym, że odczynnik mógł wyparować lub pojemnik mógł zostać użyty w innym systemie. Domyślne testy zanurzeniowe są planowane tak, aby nie opóźniać przetwarzania, istnieje więc możliwość, że ilość dostępnego odczynnika – mimo że początkowo prawidłowa – może nie być wystarczająca do przeprowadzenia zaplanowanych przebiegów. W takiej sytuacji generowany jest alarm i operator musi uzupełnić pojemnik (tylko otwarte pojemniki) lub upewnić się, że dostępny jest odpowiedni alternatywny odczynnik (zob. [8.1.1.4 - Zastępowanie odczynników](#)).

Opcjonalnie można skonfigurować system BOND tak, aby test zanurzeniowy pojemników był przeprowadzany przed każdym przebiegiem przetwarzania. Opcję tę ustawia się osobno dla otwartych pojemników, pojemników gotowych do użycia i systemów odczynników. Ustawienie to zapewnia, że ilość odczynników jest wystarczająca do zakończenia uruchomionych przebiegów, jednak należy pamiętać, że testy zanurzeniowe opóźniają przetwarzanie. Opcje te ustawia się z poziomu okienka **Laboratory settings** (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego (zob. [10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#)).

#### 8.3.1.1 Raportowanie objętości w przypadku systemów detekcji

Aby objętości raportowane dla systemów detekcji BOND były porównywalne z objętościami raportowanymi dla poszczególnych pojemników (co umożliwi szacowanie liczby szkiełek, które można przetworzyć przy użyciu systemu detekcji), wartości są podawane w mililitrach na pojedynczy pojemnik. Jednak ponieważ systemy detekcji zawierają pojemniki o różnych objętościach, należy zastosować regułę raportowania objętości opisaną w tej części.


Należy pamiętać, że reguła ta nie dotyczy systemów Oracle ani systemów czyszczenia, w przypadku których raportowane są odpowiednio pozostała liczba przebiegów i pozostała liczba cykli czyszczenia.

W przypadku systemów detekcji objętość jest raportowana w stosunku do największego pojedynczego pojemnika w systemie. Na przykład, jeśli największy pojemnik ma pojemność 30 ml, objętość systemu jest raportowana w stosunku do tych 30 ml. Oprogramowanie BOND zakłada, że wszystkie pojemniki w nowych systemach są pełne, więc przy pierwszej rejestracji system z największym pojemnikiem 30 ml jest raportowany jako system o objętości 30 ml.

W miarę zużywania odczynnika raportowana jest objętość pojemnika o najniższej objętości względnej. Jeśli objętość pojemnika nie jest taka sama jak objętość największego pojemnika w systemie, wartość jest normalizowana do objętości największego pojemnika. Na przykład w systemie z kilkoma pojemnikami 30 ml i dwoma pojemnikami 2.4 ml może się okazać, że najmniejsza ilość odczynnika, w stosunku do objętości początkowej, znajduje się w pojemniku 2.4 ml. Jeśli w pojemniku pozostało 1.2 ml (połowa jego objętości początkowej), objętość systemu jako całości zostanie podana jako połowa wartości 30 ml, tj. 15 ml.

### 8.3.2 Szczegóły odczynnika lub systemu odczynników

Aby wyświetlić szczegóły poszczególnych pakietów odczynników lub systemów odczynników, kliknąć dwukrotnie typ odczynnika w tabeli rejestru odczynników lub zaznaczyć dany odczynnik i kliknąć **Details** (szczegóły).

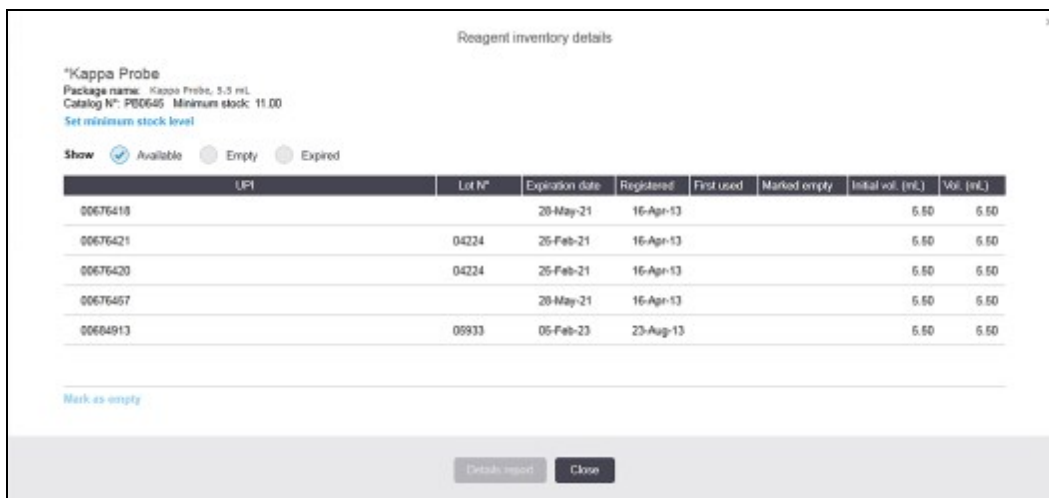

Postać 8-4: Okno dialogowe **Reagent inventory details** (szczegóły rejestru odczynników)

Okno dialogowe szczegółów rejestru zawiera listę wszystkich pakietów wybranego odczynnika lub systemu. Pola i opcje w tym oknie różnią się w zależności od typu pakietu odczynnika i dostawcy. Domyślnie wyświetlane są tylko pakiety z dostępnymi, nieprzetworzonymi odczynnikami. Można również wyświetlić puste pakiety (których termin ważności jeszcze nie upłynął) lub wszystkie pakiety, których termin ważności upłynął w ciągu ostatniego miesiąca – w tym celu zaznaczyć opcję **Available** (dostępne), **Empty** (puste) lub **Expired** (z przekroczonym terminem ważności) w oknie dialogowym.

W przypadku wszystkich typów pakietów odczynników wskazywana jest **nazwa pakietu**. Ponadto w przypadku odczynników BOND wyświetlany jest **nr katalogowy**, wg którego można sortować listę. Dodatkowo dla odczynników BOND (ale nie systemów) wskazywane są **nazwa** oraz wielkość pakietu.

Przy odczynnikach i systemach BOND wyświetlane jest również pole **Minimum stock** (minimalny zapas) pokazujące poziom odczynnika, po osiągnięciu którego wyświetlany będzie monit o zamówienie odczynnika (zob. [8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów](#)).

Za pomocą ręcznego skanera można zeskanować boczne kody kreskowe z zarejestrowanego pojemnika na odczynnik lub systemu odczynników, co spowoduje otwarcie okna dialogowego szczegółów rejestru. Zeskanowana pozycja rejestru zostanie podświetlona w tabeli szczegółów i automatycznie ustawione zostaną odpowiednie filtry **Show** (pokaż) („Available” (dostępne), „Empty” (puste) lub „Expired” (przetworzone)).

Tabela w oknie dialogowym zawiera następujące informacje dotyczące każdego pakietu odczynnika:

UPI	Unikalny identyfikator opakowania (zob. <a href="#">8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika</a> ).
Lot No. (nr partii)	Numer partii pakietu.
Expiration date (termin ważności)	Termin ważności pakietu. Nie używać pakietu po upływie tej daty.
Registered (zarejestrowano)	Data pierwszego zarejestrowania pakietu w systemie BOND.
First used (pierwsze użycie)	Data pierwszego użycia pakietu w systemie BOND.
Marked empty (oznaczony jako pusty)	Data oznaczenia pakietu jako pustego. Procedura ta może być wykonywana ręcznie lub automatycznie przez oprogramowanie (zob. <a href="#">8.3.2.3 - Oznaczanie pakietu jako pustego lub niepustego</a> ).
Initial vol. (objętość początkowa) (ml)	Objętość nowego, pełnego opakowania odczynnika. W przypadku systemów odczynników parametr ten nie jest wyświetlany.
objętość (ml)	Bieżąca objętość odczynnika w pojemniku. W przypadku systemów detekcji zob. <a href="#">8.3.1.1 - Raportowanie objętości w przypadku systemów detekcji</a> .
Refill (mL) (ponowne napełnienie (ml))	W przypadku otwartych pojemników jest to pozostała objętość odczynnika, którą można wykorzystać do napełnienia pojemnika.
Cleans remaining (pozostałe cykle czyszczenia)	W przypadku systemów czyszczenia jest to liczba cykli czyszczenia, które można wykonać przy użyciu pozostałej ilości odczynnika.
Runs remaining (pozostałe przebiegi)	W przypadku systemów Oracle jest to liczba przebiegów, które można wykonać przy użyciu pozostałej ilości odczynnika.

Przyciski w oknie dialogowym szczegółów rejestru umożliwiają konfigurację zakresu szczegółów (odpowiednich dla danego typu pakietu) i tworzenie raportu dot. szczegółów określonego odczynnika lub systemu. Poniżej opisano opcje konfiguracji i raportów.

### 8.3.2.1 Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów

Wstępnie zdefiniowane odczynniki i systemy odczynników Leica Biosystems mogą mieć ustawiony minimalny poziom zapasów. Gdy całkowity zapas odczynnika spadnie poniżej ustawionego poziomu, odczynnik zostanie podświetlony na czerwono na ekranie **Reagent Inventory** (rejestr odczynników), wskazując użytkownikowi konieczność zamówienia odczynnika lub systemu.

Aby zmienić ustawienie minimalnego poziomu zapasów, kliknąć **Set minimum stock level** (ustaw minimalny poziom zapasów). W oknie dialogowym w polu **Minimum stock** (minimalny zapas) wprowadzić wymagany minimalny poziom zapasów. W zależności od typu pakietu jako jednostki użyć mililitrów, przebiegów lub cykli czyszczenia. Kliknąć **OK**.

### 8.3.2.2 Raport dot. odczynnika

Kliknąć **Details report** (raport dot. szczegółów), aby wygenerować raport tylko wybranego odczynnika lub systemu odczynników. Więcej informacji znajduje się w części [8.3.4 - Raport. dot. szczegółów rejestru](#).

### 8.3.2.3 Oznaczanie pakietu jako pustego lub niepustego

Pakiet odczynnika można oznaczyć jako pusty, na przykład w przypadku usunięcia go przed całkowitym opróżnieniem. W tym celu zaznaczyć pakiet w tabeli, a następnie kliknąć opcję **Mark as empty** (oznacz jako pusty). Oprogramowanie umieści bieżącą datę w polu **Marked empty** (oznaczony jako pusty).

Aby przywrócić pakiet odczynnika oznaczony jako pusty, należy zaznaczyć go w tabeli i kliknąć **Mark not empty** (oznacz jako niepusty). Można to zrobić tylko wtedy, gdy pakiet nie jest załadowany do modułu przetwarzania. Oprogramowanie wyświetli objętość odczynnika zmierzoną przez oznaczeniem pakietu jako pusty.


Zaznaczyć pole **Empty** (puste) nad tabelą, aby wyświetlić pozycje oznaczone jako puste.


### 8.3.2.4 Ponowne napełnianie otwartego pojemnika na odczynnik

Otwarte pojemniki na odczynniki BOND można wykorzystać ponownie do dozowania określonych odczynników w ilości do 40 ml. Nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby ponownych napełnień pojemnika, o ile uzupełniana ilość odczynnika nie przekracza objętości pojemnika.

W celu ponownego napełnienia otwartego pojemnika wykonać poniższe czynności.

1. Napełnić pojemnik żądaną ilością odczynnika.
2. Zeskanować pojemnik (zgodnie z opisem w części [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#)), a następnie kliknąć **Refill** (napełnij).  
Przycisk napełniania nie będzie dostępny, jeśli dodanie odczynnika do pojemnika spowoduje przekroczenie limitu 40 ml.
3. Ustawić termin ważności nowego odczynnika.

 Należy pamiętać, że podczas napełniania otwartego pojemnika (po raz pierwszy lub ponownie) oprogramowanie zakłada, że pojemnik można napełnić do maksymalnej objętości dostępnej dla tego pojemnika, czyli objętości (ml) określonej przez użytkownika podczas pierwszej rejestracji odczynnika lub bieżącej objętości plus pozostałej dozwolonej objętości napełniania. Zgłoszona objętość zostanie skorygowana, jeśli jest to konieczne, po przeprowadzeniu testu zanurzeniowego. Może to jednak nastąpić dopiero po zaprzestaniu korzystania z pojemnika przez system.


 Każdy otwarty pojemnik jest przypisywany do konkretnego odczynnika podczas pierwszej rejestracji. Z tego powodu każdy otwarty pojemnik należy zawsze uzupełniać tym samym odczynnikiem.


### 8.3.3 Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników

Zarejestrowanie pakietu odczynnika powoduje dodanie go do rejestru. Zanim możliwe będzie zarejestrowanie pakietu, odczynnik musi znaleźć się na liście na ekranie **Reagent Setup** (konfiguracja odczynników).

 Zawsze należy zarejestrować pakiet odczynnika przed jego użyciem w urządzeniu BOND-III lub BOND-MAX.

W przypadku załadowania niezarejestrowanego pojemnika na odczynnik do modułu przetwarzania

oprogramowanie nie rozpozna go i wyświetli ikonę informacji  na pozycji tego odczynnika na liście na ekranie **System status** (stan systemu).

 Oprogramowanie BOND śledzi zużycie odczynnika i wyświetla alert informujący o tym, że trzeba wymienić odczynnik.

Nie próbować napełniać pojemnika z odczynnikiem gotowym do użycia BOND, jako że oprogramowanie BOND rozpozna ten pojemnik jako używany i odmówi jego wykorzystania.


Jeżeli system BOND nie rozpozna nowego pakietu odczynnika po jego zeskanowaniu, prawdopodobnie w systemie nie zainstalowano najnowszego pliku definicji danych BOND (BDD); wyszukać najnowszy plik BDD w Internecie, a następnie pobrać i zainstalować go (z poziomu ekranu **BDD update** (aktualizacja BDD) klienta administracyjnego), jeśli oczywiście jego wersja jest późniejsza niż wskazana w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND). Po zainstalowaniu najnowszego pliku BDD ponownie uruchomić klienta klinicznego i ponowić próbę zarejestrowania nowego pojemnika na odczynnik lub systemu odczynników.

Metody rejestrowania różnych typów pakietów odczynników opisano w następujących częściach:

- [8.3.3.1 - Rejestrowanie systemów odczynników](#)
- [8.3.3.2 - Rejestrowanie odczynników gotowych do użycia BOND](#)
- [8.3.3.3 - Rejestrowanie odczynników niegotowych do użycia](#)
- [8.3.3.4 - Ręczne wprowadzanie ID](#)

#### 8.3.3.1 Rejestrowanie systemów odczynników

Aby zarejestrować system detekcji, system teranostyczny lub system czyszczenia BOND, zeskanować dwa kody kreskowe z boku tacy na odczynniku.

 Niektóre systemy odczynników mają tylko jeden kod kreskowy na tacy na odczynniku, na przykład systemy zawierające tylko jeden lub dwa pojemniki.


Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Add reagent system** (dodaj system odczynników).



#### **OSTRZEŻENIE:**

Niebezpieczeństwo związane z laserem. Możliwość poważnego urazu oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z laserem.

---

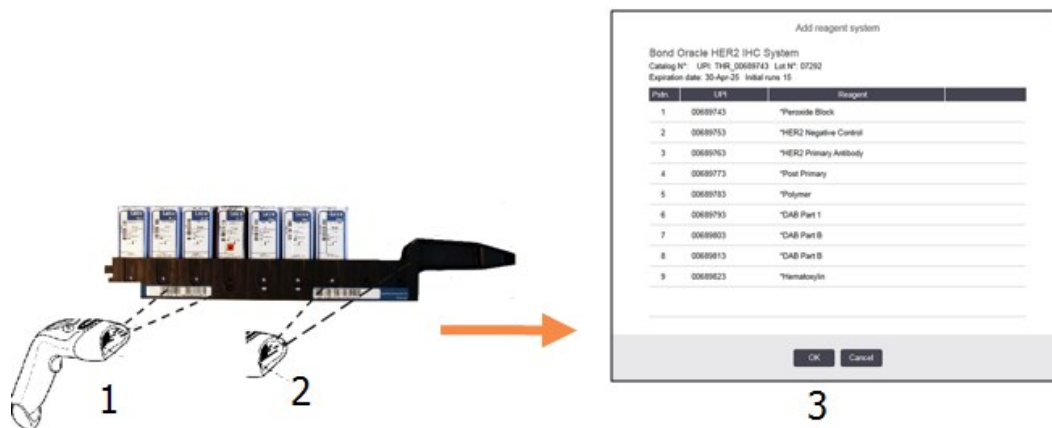

Postać 8-5: Rejestrowanie systemu detekcji BOND

Sprawdzić, czy szczegóły w oknie dialogowym odpowiadają szczegółom pakietu, a następnie kliknąć **OK**.

**i** Nie należy próbować rejestrować pojedynczych pojemników na odczynniki, będących częścią systemu odczynników.

### 8.3.3.2 Rejestrowanie odczynników gotowych do użycia BOND

Aby zarejestrować pakiet odczynnika gotowego do użycia BOND, zeskanować kod kreskowy z przodu pojemnika. Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Add reagent package** (dodaj pakiet odczynnika).



Postać 8-6: Rejestrowanie pakietów odczynników BOND

Sprawdzić, czy szczegóły w oknie dialogowym odpowiadają szczegółom pakietu, a następnie kliknąć **Add** (dodaj).



### 8.3.3.3 Rejestrowanie odczynników niegotowych do użycia

Odczynniki niedostarczane w gotowych do użycia pakietach BOND mogą być używane w systemie BOND w otwartych pojemnikach BOND lub pojemnikach do miareczkowania. Po przygotowaniu odczynnika niegotowego do użycia i wprowadzeniu go do otwartego pojemnika 7 ml lub 30 ml bądź pojemnika do miareczkowania 6 ml zarejestrować odczynnik w taki sam sposób, jak odczynnik BOND:

1. Upewnić się, że odczynnik został utworzony w systemie i jest preferowany. Aby możliwe było zarejestrowanie rejestru, odczynnik utworzony przez użytkownika musi zostać ustawiony jako preferowany (zob. [8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika](#)).  
Należy pamiętać, że enzymy z zestawu BOND do wstępnej obróbki enzymatycznej są wstępnie zdefiniowane w systemie i nie wymagają ręcznego tworzenia.
2. Zeskanować kod kreskowy z przodu otwartego pojemnika lub pojemnika do miareczkowanego, aby otworzyć okno dialogowe **Add open container** (dodaj otwarty pojemnik).
3. Wybrać nazwę odczynnika z listy rozwijanej **Reagent name** (nazwa odczynnika). (Nazwa dostawcy jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy odczynnika).  
Lista zawiera wszystkie utworzone w systemie preferowane odczynniki pomocnicze i markery inne niż BOND, a także cztery wstępnie zdefiniowane enzymy, które można przygotować ze składników zestawu BOND do wstępnej obróbki enzymatycznej. Jeśli odczynnik nie został utworzony w systemie, anulować okno dialogowe **Add open container** (dodaj otwarty pojemnik) i utworzyć odczynnik (zob. krok 1 powyżej).
4. Wpisać numer partii odczynnika z dokumentacji dostawcy odczynnika.
5. Kliknąć pole **Expiration date** (termin ważności) i za pomocą kalendarza ustawić termin ważności (lub wpisać datę ręcznie).



Daty można wprowadzić w postaci częściowej, np. D/M, DD/MM lub DD/MMM – system domyślnie przyjmuje bieżący rok. W przypadku wprowadzenia na przykład MM/RRRR lub MMM/RRRR system przyjmuje pierwszy dzień danego miesiąca.

Jeśli wprowadzona data będzie nieprawidłowa, wokół pola **Expiration date** (termin ważności) wyświetlona zostanie czerwona obwódka i pojawi się komunikat o błędzie walidacji.

Po kliknięciu obszaru poza polem **Expiration date** (termin ważności) prawidłowa data zostanie automatycznie zmieniona na systemowy format daty. Jeśli przed wpisaniem nieprawidłowej daty wprowadzono co najmniej jedną poprawną datę, kliknięcie poza polem spowoduje wyświetlenie ostatniej wpisanej prawidłowej daty.

6. Kliknąć **OK**, aby zarejestrować odczynnik.

### 8.3.3.4 Ręczne wprowadzanie ID

Jeśli system BOND nie odczytuje kodu kreskowego odczynnika, z poziomu ekranu **Reagent Inventory** (rejestr odczynników) wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć **Enter ID** (wprowadź ID).  
Oprogramowanie BOND wyświetli okno dialogowe **Manual ID entry** (ręczne wprowadzanie ID).
2. W górnym wierszu okna dialogowego wpisać ID odczynnika (znajdujące się obok kodu kreskowego z przodu pakietu odczynnika).
3. Kliknąć **Validate** (walidacja).  
Jeśli istnieje więcej niż jeden kod kreskowy, jak w przypadku systemów detekcji, opcję **Validate** (walidacja) kliknąć po wprowadzeniu wszystkich numerów pakietów.



4. Po sprawdzeniu, czy numer pakietu jest prawidłowy, oprogramowanie wyświetli odpowiednie okno dialogowe **Add reagent package** (dodaj pakiet odczynnika).
5. Sprawdzić szczegóły pakietu lub dodać wymagane szczegóły w oknie dialogowym z wymaganiami **Add reagent package** (dodaj pakiet odczynnika) i kliknąć przycisk **OK**, aby zarejestrować pakiet.

### 8.3.4 Raport. dot. szczegółów rejestru

System umożliwia generowanie raportów dot. szczegółów rejestru odczynników lub systemów odczynników wyświetlanych w tabeli na ekranie **Reagent Inventory** (rejestr odczynników). Wygenerowany raport zawiera informacje o każdym z widocznych odczynników lub systemów, w tym pozostałe zapasy. Jeśli całkowity poziom zapasów jest mniejszy niż minimalny (zob. [8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasów](#)), dany odczynnik jest oznaczony w raporcie jako „Low” (niski poziom).

Ustawić filtry w dolnej części ekranu, aby wyświetlić żądane odczynniki lub systemy odczynników, a następnie kliknąć przycisk **Details report** (raport szczegółowy). Raport zostanie wygenerowany i wyświetlony w nowym oknie.

W prawym górnym rogu raportu dot. rejestru odczynników znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
Placówka	Nazwa placówki wprowadzona w polu <b>Facility</b> (placówka) na ekranie <b>Laboratory settings</b> (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego – zob. <a href="#">10.5.1 - Ustawienia laboratorium</a>
Subject (temat)	Ustawienia filtra używane do wyboru odczynników lub systemów odczynników w raporcie.

Dla każdego odczynnika z tabeli w treści raportu wyświetlane są następujące informacje:

- nazwa
- całkowity dostępny zapas (oznaczony flagą, jeśli jest mniejszy niż minimalny poziom zapasów)
- numer katalogowy (dla gotowych do użycia pojemników BOND) lub oznaczenie „open” (otwarty) (tylko otwarte pojemniki)
- typ (typ przeciwciała pierwszorzędowego, sondy, odczynnika pomocniczego lub systemu odczynników)
- dostawca

W przypadku każdego indywidualnego pakietu odczynnika w raporcie wyświetlane są następujące informacje:

- UPI
- numer partii
- termin ważności
- data zarejestrowania
- data pierwszego użycia
- data ostatniego użycia
- pozostała ilość

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

### 8.3.5 Raport dot. użycia odczynnika

Raport dot. użycia odczynnika przedstawia ilość zużytego odczynnika oraz liczbę testów przeprowadzonych z wykorzystaniem tego odczynnika w określonym okresie. Informacje te są podawane osobno dla każdego pojemnika na odczynnik, a także w postaci zestawienia łącznego.

Raport obejmuje wszystkie odczynniki używane w określonym okresie, niezależnie od odczynników aktualnie wyświetlanych na ekranie **Reagent Inventory** (rejestr odczynników). Nie uwzględnia jednak zużycia systemów odczynników.

Kliknąć **Reagent usage** (użycie odczynnika), aby otworzyć okno dialogowe wyboru okresu, którego ma dotyczyć raport. Ustawić daty „From” (od) i „To” (do) (zob. [Korzystanie z pól wyboru daty i godziny on page 193](#)), a następnie kliknąć **Generate** (generuj). Raport zostanie wygenerowany i wyświetlony w nowym oknie.

W prawym górnym rogu raportu dot. użycia odczynnika znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
Placówka	Nazwa placówki wprowadzona w polu <b>Facility</b> (placówka) na ekranie <b>Laboratory settings</b> (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego – zob. <a href="#">10.5.1 - Ustawienia laboratorium</a>
Przedział czasu	Daty „od” i „do” okresu ujętego w raporcie

Dla każdego odczynnika użytego w okresie objętym raportem wyświetlany są następujące informacje:

- Nazwa (skrótowa nazwa odczynnika)
- UPI każdego użytego pojemnika
- Numer partii każdego użytego pojemnika
- Termin ważności każdego użytego pojemnika
- Liczba przetworzonych szkiełek, zarówno na pojemnik, jak i łącznie dla odczynnika
- Objętość odczynnika zużyta w wybranym okresie, zarówno na pojemnik, jak i łącznie dla odczynnika

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 8.4 Ekran paneli odczynników

Panel to zdefiniowany przez użytkownika zestaw markerów. Służą do szybkiego dodawania większej liczby szkiełek do systemu.

Panele można stosować wyłącznie do tworzenia szkiełek do rutynowego barwienia pojedynczego; ich używanie do konfiguracji szkiełek do barwienia podwójnego nie jest zalecane. Panele mogą być tworzone wyłącznie przez użytkowników o roli „przełożony”.

Aby wyświetlić ekran **Reagent Panels** (panele odczynników), kliknąć ikonę **Reagent setup** (konfiguracja odczynników) na pasku funkcji, a następnie kliknąć kartę **Panels** (panele).

Więcej informacji można znaleźć w częściach:

- [8.4.1 - Tworzenie panelu](#)
- [8.4.2 - Wyświetlanie lub edytowanie szczegółów panelu](#)
- [8.4.3 - Usuwanie panelu](#)

### 8.4.1 Tworzenie panelu

Aby utworzyć panel, wykonać następujące czynności (wymaga zalogowania się użytkownika o roli „przełożony”):

1. Kliknąć opcję **Add panel** (dodaj panel).

Oprogramowanie wyświetli okno dialogowe **Reagent panel properties** (właściwości panelu odczynników).

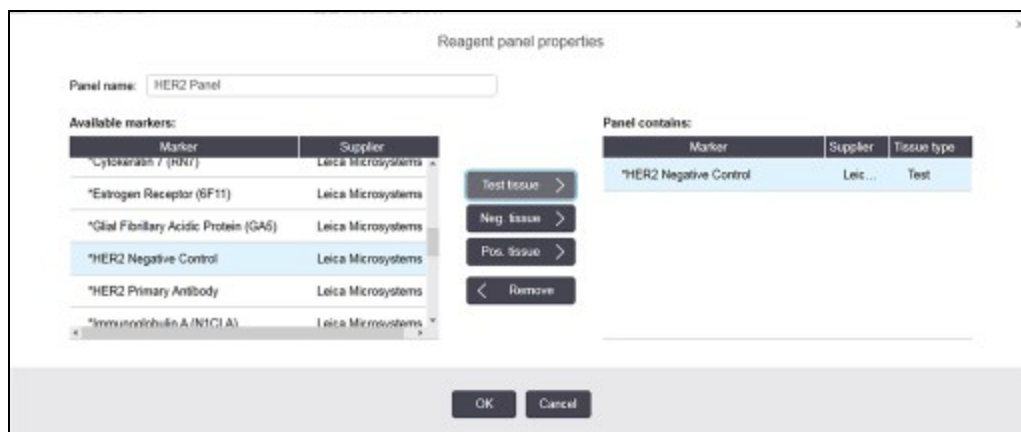


Figure 8-7: Okno dialogowe **Reagent panel properties** (właściwości panelu odczynników)


Tabela po prawej stronie okna **Reagent panel properties** (właściwości panelu odczynników) zawiera listę elementów panelu, a tabela po lewej stronie – listę wszystkich dostępnych markerów.

2. Wprowadzić nazwę panelu w polu **Panel name** (nazwa panelu) w górnej części okna dialogowego. Nie można zapisać panelu bez nazwy.
3. Aby dodać marker do panelu, zaznaczyć pozycję na liście dostępnych przeciwciał lub sond w tabeli po


lewej stronie, a następnie kliknąć przycisk




Aby dodać kontrolną tkankę dodatnią, kliknąć marker, a następnie kliknąć




Aby dodać kontrolną tkankę ujemną, kliknąć marker, a następnie kliknąć



4. Aby usunąć element z panelu, zaznaczyć go w tabeli po prawej i kliknąć



 Panele muszą zawierać tkankę testową. Nie można zapisać panelu, do którego nie przypisano tkanki testowej.

5. Kiedy panel będzie poprawny, kliknąć **OK**, aby zapisać szczegóły.

Jeśli panel ma nie być zapisany, kliknąć opcję **Cancel** (anuluj).

## 8.4.2 Wyświetlanie lub edytowanie szczegółów panelu

Aby wyświetlić szczegóły panelu, zaznaczyć go w tabeli po lewej stronie ekranu **Reagent Panels** (panele odczynników). Markery przypisane do panelu są wyświetlane w tabeli po prawej stronie ekranu. Aby edytować panel, kliknąć opcję **Panel properties** (właściwości panelu) i przeprowadzić edycję zgodnie z opisem w części [8.4.1 - Tworzenie panelu](#).

## 8.4.3 Usuwanie panelu

Aby usunąć panel z systemu, zaznaczyć go w tabeli na ekranie **Reagent Panels** (panele odczynników) i kliknąć przycisk **Remove panel** (usuń panel). System zażąda potwierdzenia usunięcia.

 Ostrożnie wyjąć panele. Szczegółów usuniętych paneli nie można odzyskać.

# 9. Historia szkiełek (kontroler BOND )

Ekran **Slide history** (historia szkiełek) zawiera szczegóły szkiełek zaplanowanych, aktualnie przetwarzanych lub już przetworzonych przez system BOND.

W przypadku przebiegów, które zostały zaplanowane, ale zatrzymane przed rozpoczęciem przetwarzania (no. przez odblokowanie tacy), wpisy dotyczące poszczególnych szkiełek są usunięte z listy historii i zastąpione pojedynczym wierszem dla całej tacy oznaczonym flagą „Rejected” (odrzucono). Dla tych przebiegów można wygenerować raporty dot. szczegółów przebiegu i zdarzeń podczas przebiegu.

Ten rozdział zawiera następujące części:

- [9.1 - Ekran historii szkiełek](#)
- [9.2 - Wybór szkiełek](#)
- [9.3 - Właściwości szkiełka i ponowny przebieg](#)
- [9.4 - Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu](#)
- [9.5 - Raport dot. szczegółów przebiegu](#)
- [9.6 - Raport dla przypadku](#)
- [9.7 - Raport dot. protokołu](#)
- [9.8 - Podsumowanie szkiełek](#)
- [9.9 - Eksport danych](#)
- [9.10 - Krótka historia szkiełek](#)

## 9.1 Ekran historii szkiełek

Aby wyświetlić szczegóły historii szkiełek lub wygenerować raport dot. zdarzeń podczas przebiegu, raport. dot. szczegółów przebiegu lub raport dla przypadku, kliknąć ikonę **Slide history** (historia szkiełek) na pasku funkcji.

Slide history



**Slide history**

Slide filters: Date range: From: 01-Jan-13 9:46 AM To: 05-Apr-17 9:46 AM Last seven days Apply

Process date	Run ID	Slide ID	Marker	Patient name	Case ID	Type	Status
27-Aug-13	84	0000288	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000289	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000241	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000291	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000292	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000290	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000293	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000294	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000295	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000296	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000399	*CD5	Cherry Dale	CS3225 - 527991	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000398	*Tyros	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000395	*CD20	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000395	*CD5	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000394	*Tyros	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000391	*CD5	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000400	*CD20	Cherry Dale	CS3225 - 527991	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000397	*MeIA	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000393	*MeIA	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress

Run ID numbers may not increment sequentially

Slides summary Export data Brief slide history Slide properties Run events Run details Case report Protocol report

Postać 9-1: Ekran **Slide history** (historia szkiełek)

Lista na ekranie historii szkiełek zawiera szkiełka przetworzone w okresie zdefiniowanym za pomocą filtra **Date range** (zakres dat) powyżej listy lub szkiełka przefiltrowane wg filtra **Slide ID** (ID szkiełka) (zob. [9.2 - Wybór szkiełek](#)).

Należy pamiętać, że ID przebiegów wyświetlane na ekranie mogą nie zwiększać się sekwencyjnie. ID przebiegów są przydzielane w momencie zablokowania tacy na szkiełka, jeśli więc taca została zablokowana, odblokowana, a następnie zablokowana ponownie (przed uruchomieniem przebiegu), ID przebiegu zwiększy się, a numer przydzielony w momencie pierwszego zablokowania zostanie pominięty.

Znaczenie kolorów, jakimi oznaczone są szkiełka, jest takie samo jak na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) (zob. [6.5.1 - Opis pól i elementów sterujących dla szkiełek](#)):

- Białe: szkiełka utworzone oknie dialogowym **Add slide** (dodaj szkiełko)
- Żółte: szkiełka utworzone w oknie dialogowym **Slide identification** (identyfikacja szkiełek) (zob. [6.8 - Ręczne tworzenie slajdów i przypadków](#))
- Jasnoszare: szkiełka LIS
- Czerwone: priorytetowe szkiełka LIS (zob. [11.2.5 - Szkiełka priorytetowe](#))

Dla każdego szkiełka lista podaje następujące informacje:

- Data przetworzenia (data rozpoczęcia przetwarzania szkiełka)
- ID przebiegu
- Slide ID (ID szkiełka)
- marker (nazwa przeciwciała pierwszorzędowego lub sondy)
- Patient name (imię i nazwisko pacjenta)
- Case ID (ID przypadku)
- Typ (tkanka testowa lub dodatnia bądź ujemna tkanka kontrolna)
- Status (w toku lub zakończono, plus informacja o wszelkich nieoczekiwanych zdarzeniach; również status „odrzucono” dla przebiegów, które zostały przerwane przed rozpoczęciem przetwarzania)




Jeśli status to **Done (notification)** (gotowe (powiadomienie)), sprawdzić raport dot. zdarzeń podczas przebiegu w celu ustalenia, czy nieoczekiwane zdarzenia mogły mieć wpływ na barwienie. Nieoczekiwane zdarzenia są wyświetlane pogrubioną czcionką.

Aby wyświetlić informacje o szkiełku, zaznaczyć go na liście i kliknąć jeden z przycisków poniżej listy.

## 9.2 Wybór szkiełek

Listę szkiełek na ekranie **Slide history** (historia szkiełek) można przefiltrować, aby wyświetlany były tylko szkiełka przetworzone w określonym okresie lub tylko szkiełka o wybranym ID. Kliknąć menu rozwijane i wybrać filtr, jaki ma zostać zastosowany do szkiełek.

### Filtr okresu przetwarzania szkiełek

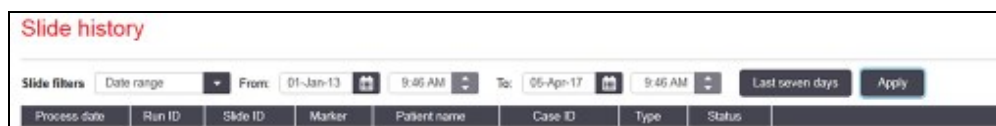

Postać 9-2: Filtr okresu przetwarzania szkiełek

Użyć filtra **Date range** (zakres dat), aby określić okres, którego ma dotyczyć lista na ekranie; wyświetlane są tylko szkiełka przetworzone w tym okresie. Ustawić daty „From” (od) i „To” (do) oraz, w razie potrzeby, godzinę, aby określić żądany przedział czasu. Kliknąć **Apply** (zastosuj), aby wyświetlić szkiełka.

Jeśli w danym okresie przetworzono ponad 1000 szkiełek, wyświetlone zostanie tylko pierwsze 1000 szkiełek. Aby wyświetlić szczegóły pełnego zestawu, należy wyeksportować dane szkiełek – zob. [9.9 - Eksport danych](#).

W polu **To** (do) wstępnie ustawiona jest bieżąca data i godzina, a polu **From** (od) – data wcześniejsza dokładnie o tydzień. Jeśli ustawienia zostały zmienione, można powrócić do tej konfiguracji, klikając opcję **Last seven days** (ostatnie siedem dni).

### Korzystanie z pól wyboru daty i godziny

Aby ustawić dzień, miesiąc i rok, kliknąć ikonę kalendarza i wybrać datę. Do przewijania miesięcy służą strzałki na pasku kalendarza. Można też kliknąć środek paska, aby wybrać kolejny miesiąc lub przewijać lata. Datę można również wpisać bezpośrednio w polu.

Aby ustawić godzinę, kliknąć pole godziny i użyć przycisków w górę i w dół (lub klawiszy strzałki w górę i w dół). W zależności od miejsca, w którym umieszczony jest kursor, wartość zmienia się o jedną godzinę, dziesięć minut lub minutę. Godzinę można również wpisać bezpośrednio w polu.

## Filtr ID szkiełek

Użyć filtra **Slide ID** (ID szkiełka), aby wyświetlić informacje o konkretnym szkiełku. Wpisać ID szkiełka w polu **Slide ID** (ID szkiełka) i kliknąć **Apply** (zastosuj).

## 9.3 Właściwości szkiełka i ponowny przebieg

Aby wyświetlić właściwości szkiełka na liście na ekranie **Slide history** (historia szkiełek), zaznaczyć to szkiełko i kliknąć opcję **Slide properties** (właściwości szkiełka) lub dwukrotnie kliknąć szkiełko.

Wyświetlone zostanie to samo okno dialogowe co okno otwierane z poziomu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek) ([6.5.4 - Edytowanie szkiełka](#)).

W oknie dialogowym **Slide properties** (właściwości szkiełka) otwartym z poziomu ekranu **Slide history** (historia szkiełek) nie można edytować żadnych szczegółów pacjenta ani testu (ponieważ szkiełko jest aktualnie przetwarzane lub zostało już przetworzone), jednak można dodawać uwagi w polu **Comments** (komentarze) lub uruchomić ponowne przetwarzanie szkiełek – zob. [9.3.1 - Ponowne przetwarzanie szkiełek](#).

### 9.3.1 Ponowne przetwarzanie szkiełek

Jeśli szkiełko nie spełnia wymagań, może zostać oznaczone jako wymagające ponownego przetworzenia. Aby ponownie przetworzyć szkiełko, wykonać następującą procedurę z poziomu okna dialogowego **Slide properties** (właściwości szkiełek):

1. Kliknąć opcję **Copy slide** (kopiuj szkiełko).  
Okno dialogowe **Slide properties** (właściwości szkiełek) zmieni się w okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko) z edytowalnymi polami.
2. Wprowadzić żądane zmiany i kliknąć **Add slide** (dodaj szkiełko).
3. Potwierdzić przypadek, pacjenta i lekarza dla skopiowanego szkiełka, aby dodać szkiełko do listy na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek).  
Okno dialogowe **Add slide** (dodaj szkiełko) pozostanie otwarte, umożliwiając dodanie kolejnych szkiełek.
4. Kliknąć **Close** (zamknij), aby powrócić do ekranu **Slide history** (historia szkiełek).
5. Uruchomić przebieg dla nowo utworzonego szkiełka w normalny sposób.



## 9.4 Raport dot. zdarzeń podczas przebiegu

Ten raport, generowany z poziomu ekranu **Slide history** (historia szkiełek), zawiera wszystkie zdarzenia dla wszystkich szkiełek znajdujących się na tacy, co przetwarzane szkiełko. Kliknąć **Run events** (zdarzenia podczas przebiegu), aby wygenerować raport.

Raporty dot. zdarzeń podczas przebiegu mogą być generowane również podczas przetwarzania szkiełek. Kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiedni przebieg lub pozycję na liście na ekranie **System status** (stan systemu) lub **Protocol status** (status protokołu) i wybrać z menu opcję **Run events** (zdarzenia podczas przebiegu). Zdarzenia, które zainicjowały powiadomienia dla szkiełka, są oznaczone pogrubioną czcionką, aby można je było łatwo znaleźć.

W prawym górnym rogu raportu dot. zdarzeń podczas przebiegu znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
PM serial N° (numer seryjny modułu przetwarzania)	Numer seryjny modułu przetwarzania, w którym przeprowadzono przebieg
Moduł przetwarzania	Nazwa modułu przetwarzania, w którym przeprowadzono przebieg
Slide tray (taca na szkiełka)	Numer zespołu barwienia szkiełek użytego do przeprowadzenia przebiegu
Dispense volume (objętość dozowania)	Dozowana objętość odczynnika (zob. <a href="#">6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach</a> )
Start time (czas rozpoczęcia)	Data i godzina rozpoczęcia przebiegu
Run progress (postęp przebiegu)	Wskazuje, czy przebieg jest zakończony czy nadal przetwarzany
Staining mode (tryb barwienia)	Używany tryb barwienia, na przykład barwienie pojedyncze

U góry raportu wyświetlane są obrazy etykiet wszystkich szkiełek w danym przebiegu. Treść raportu zawiera informacje o czasie, numer zdarzenia oraz opis zdarzenia, jakie wystąpiło podczas przebiegu. Numer zdarzenia jest używany przez Leica Biosystems do śledzenia błędów, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 9.5 Raport dot. szczegółów przebiegu

Ten raport, generowany z poziomu ekranu **Slide history** (historia szkiełek), przedstawia szczegóły każdego szkiełka znajdującego się na tej samej tacy, co aktualnie wybrane szkiełko. Przetwarzanie musi być zakończone, a taca – odblokowana. Kliknąć **Run details** (szczegóły przebiegu), aby wygenerować raport. W prawym górnym rogu raportu znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
PM serial N° (numer seryjny modułu przetwarzania)	Numer seryjny modułu przetwarzania, w którym przeprowadzono przebieg
PM name (nazwa modułu przetwarzania)	Nazwa modułu przetwarzania, w którym przeprowadzono przebieg
Slide tray (taca na szkiełka)	Numer zespołu barwienia szkiełek użytego do przeprowadzenia przebiegu
Start time (czas rozpoczęcia)	Data i godzina rozpoczęcia przebiegu
Run started by (przebieg uruchomiony przez)	Nazwa użytkownika, który uruchomił przebieg

Dla każdego szkiełka w przebiegu raport zawiera obraz etykiety szkiełka oraz poniższe informacje.

Pole	Opis
Slide ID (ID szkiełka)	Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do każdego szkiełka
Slide created by (szkiełko utworzone przez)	Nazwa użytkownika, który utworzył szkiełko, lub „LIS” (w odpowiednich przypadkach)
Case N° (nr przypadku)	Unikalny identyfikator przypadku wygenerowany przez oprogramowanie BOND
Tissue type (typ tkanki)	Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna
Dispense volume (objętość dozowania)	Dozowana objętość odczynnika (zob. <a href="#">6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach</a> )
Patient name (imię i nazwisko pacjenta)	Identyfikacja pacjenta
Case ID (ID przypadku)	Identyfikator przypadku wprowadzony podczas konfiguracji szkiełka
Staining protocol (protokół barwienia)	Zastosowany protokół barwienia
Preparation (przygotowanie)	Zastosowany protokół przygotowania (jeśli dotyczy)
HIER protocol (protokół HIER)	Zastosowany protokół HIER (jeśli dotyczy)

Pole	Opis
Enzyme protocol (protokół enzymatyczny)	Zastosowany protokół odsłaniania enzymatycznego (jeśli dotyczy)
Denaturacja	Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokół denaturacji (jeśli dotyczy)
Hybrydyzacja	Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokół hybrydyzacji (jeśli dotyczy)
LIS reference [2 to 7] (odniesienie LIS [2–7])	Dodatkowe informacje referencyjne LIS dla systemów z zainstalowanym LIS-ip (zob. <a href="#">11.2.6 - Pola danych szkiełek LIS</a> )
Stain (barwienie)	Używany tryb barwienia, na przykład barwienie pojedyncze
Completion status (status ukończenia)	Wskazuje, czy dane szkiełko jest aktualnie przetwarzane, zostało ukończony lub zostało poddane ocenie. Wskazuje też, czy zaraportowano jakiegokolwiek powiadomienia o zdarzeniu.
Comments (komentarze)	Komentarze można wprowadzić w oknie właściwości szkiełka w dowolnym momencie
Sign off: (zatwierdzenie:)	Zarezerwowany obszar na wydrukowanym raporcie, gdzie przełożony może zatwierdzić szkiełko
Użyte odczynniki (lub preferowany zestaw zawierający składniki do mieszania odczynników)	
UPI	Unikalny identyfikator opakowania każdego odczynnika lub preferowanego zestawu użytego na danym szkiełku
Nazwa	Nazwa każdego odczynnika lub preferowanego zestawu użytego na danym szkiełku
Public name (nazwa publiczna)	Nazwa publiczna dla systemów z zainstalowanym LIS-ip
Lot N° (nr partii)	Numer partii każdego odczynnika lub preferowanego zestawu użytego na danym szkiełku
Expiration date (termin ważności)	Termin ważności każdego odczynnika lub preferowanego zestawu użytego na danym szkiełku

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 9.6 Raport dla przypadku

Ten raport zawiera szczegóły każdego szkiełka należącego do tego samego przypadku, co aktualnie zaznaczone szkiełko. Raport można wygenerować z poziomu ekranu **Slide setup** (konfiguracja szkiełek), ekranu **Slide history** (historia szkiełek) lub okna dialogowego **Slide identification** (identyfikacja szkiełek). W prawym górnym rogu raportu dla przypadku znajdują się następujące informacje:

Pole	Opis
Case ID (ID przypadku)	Identyfikator przypadku wprowadzony podczas konfiguracji szkiełka
Patient name (nazwa pacjenta)	Patient name (imię i nazwisko pacjenta)

<b>Pole</b>	<b>Opis</b>
Case comments (komentarze do przypadku)	Dodatkowe informacje o przypadku
Doctor (lekarz)	Imię i nazwisko lekarza lub patologa opiekującego się pacjentem
Doctor comment (komentarz dot. lekarza)	Dodatkowe informacje o lekarzu
Created (utworzono)	Data i godzina utworzenia przypadku
Case N° (nr przypadku)	Unikalny identyfikator przypadku wygenerowany przez system BOND

Treść raportu zawiera następujące informacje o każdym szkiełku przypisanym do przypadku:

<b>Pole</b>	<b>Opis</b>
Slide ID (ID szkiełka)	Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do każdego szkiełka
Slide created by (szkiełko utworzone przez)	Nazwa użytkownika, który utworzył szkiełko, lub „LIS” (w odpowiednich przypadkach)
Run (przebieg)	Numer przebiegu, w którym szkiełko zostało przetworzone
Run started by (przebieg uruchomiony przez)	Nazwa użytkownika, który uruchomił przebieg
Tissue type (typ tkanki)	Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna
Dispense volume (objętość dozowania)	Dozowana objętość odczynnika (zob. <a href="#">6.5.8 - Objętość dozowania i pozycja tkanek na szkiełkach</a> )
Staining protocol (protokół barwienia)	Zastosowany protokół barwienia
Preparation (przygotowanie)	Zastosowany protokół przygotowania (jeśli dotyczy)
HIER protocol (protokół HIER)	Zastosowany protokół HIER (jeśli dotyczy)
Enzyme protocol (protokół enzymatyczny)	Zastosowany protokół odsłaniania enzymatycznego (jeśli dotyczy)
Denaturacja	Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokół denaturacji (jeśli dotyczy)
Hybrydyzacja	Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokół hybrydyzacji (jeśli dotyczy)
LIS reference (2 to 7) (odniesienie LIS (2–7))	Dodatkowe informacje referencyjne LIS dla systemów z zainstalowanym LIS-ip (zob. <a href="#">11.2.6 - Pola danych szkiełek LIS</a> )
Stain (barwienie)	Używany tryb barwienia, na przykład barwienie pojedyncze

Pole	Opis
Completion status (status ukończenia)	Wskazuje, czy dane szkiełko jest aktualnie przetwarzane, zostało ukończony lub zostało poddane ocenie. Wskazuje też, czy zaraportowano jakiegokolwiek powiadomienia o zdarzeniu.
Comments (komentarze)	Komentarze można wprowadzić w oknie właściwości szkiełka w dowolnym momencie
Sign off: (zatwierdzenie:)	Zarezerwowany obszar na wydrukowanym raporcie, gdzie przełożony może zatwierdzić ocenę i dodać komentarze
<b>Reagents Used (użyte odczynniki)</b>	
UPI	Unikalny identyfikator opakowania każdego odczynnika użytego na danym szkiełku
Nazwa	Nazwa każdego odczynnika użytego na danym szkiełku
Public name (nazwa publiczna)	Nazwa publiczna dla systemów z zainstalowanym LIS-ip
Lot N <sup>o</sup> (nr partii)	Numer partii każdego odczynnika użytego na danym szkiełku
Expiration date (termin ważności)	Termin ważności każdego odczynnika użytego na danym szkiełku

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).

## 9.7 Raport dot. protokołu

Aby wygenerować raport dot. protokołu zastosowanego do danego szkiełka, zaznaczyć szkiełko i kliknąć **Protocol report** (raport dot. protokołu). Wybrać protokół z listy protokołów zastosowanych do szkiełka, a następnie kliknąć przycisk **Report** (raport), aby utworzyć raport. Opis raportu znajduje się w części [7.5 - Raporty dot. protokołów](#).

## 9.8 Podsumowanie szkiełek

Ekran podsumowania przetwarzania szkiełek wyświetla liczbę szkiełek rozpoczętych w określonym okresie. Informacje są wyświetlane w formacie tabelarycznym i graficznym jako liczba szkiełek przetwarzanych na jednostkę czasu w danym okresie.

Aby zaraportować liczbę przetworzonych szkiełek, kliknąć **Slides summary** (podsumowanie szkiełek) na ekranie **Slide history** (historia szkiełek). Otwarte zostanie okno dialogowe **Slides summary** (podsumowanie szkiełek).

Z listy rozwijanej **Processing module** (moduł przetwarzania) wybrać nazwężądanego modułu przetwarzania lub opcję **All** (wszystkie) (wszystkie moduły przetwarzania lub, w przypadku systemu BOND-ADVANCE, wszystkie moduły z grupy, do której aktualnie podłączony jest klient).

W polu **Resolution** (rozdzielczość) wybrać jednostkę czasu, która będzie używana do raportowania liczby rozpoczętych szkiełek, np. „Day” (dzień) generuje raport pokazujący liczbę szkiełek rozpoczętych w każdym dniu w wybranym okresie, natomiast „Month” (miesiąc) – liczbę szkiełek rozpoczętych w każdym miesiącu.

Ustawić daty **To** (do) i **From** (od). Jednostka czasu ustawiona w polu **Resolution** (rozdzielczość) jest stosowana (w pełnych jednostkach) od daty określonej w polu **From** (od) do daty określonej w polu **To** (do), w której do ukończenia okresu może być wymagane zastosowanie połowy jednostki.

Kliknąć **Generate** (generuj), aby wyświetlić podgląd raportu.

Więcej szczegółów na temat okna raportów i opcji drukowania znajduje się w części [3.7 - Raporty](#).


## 9.9 Eksport danych

Kliknąć **Export data** (eksportuj dane) na ekranie **Slide history** (historia szkiełek), aby utworzyć plik zawierający szczegóły wszystkich szkiełek, których przetwarzanie zostało zakończone w wybranym okresie. Wyeksportowany plik ma standardowy format „wartości rozdzielonych przecinkami” (csv) i może zostać łatwo zaimportowany do arkusza kalkulacyjnego dowolnego producenta, np. arkusza Microsoft Excel. Po zaimportowaniu do arkusza kalkulacyjnego dane są prezentowane w formacie umożliwiającym (zależnie od funkcji arkusza) sortowanie, wyszukiwanie i tworzenie niestandardowych raportów i wykresów.

Wyeksportowany plik zawiera następujące informacje dla każdego szkiełka przetworzonego w wybranym okresie:

- Data przetworzenia
- Numer seryjny modułu przetwarzania
- Slide ID (ID szkiełka)
- Run started by (przebieg uruchomiony przez)
- UPI markera
- UPI markera 2
- Patient name (imię i nazwisko pacjenta)
- Typ tkanki (testowa lub dodatnia bądź ujemna tkanka kontrolna)
- Status
- Comments (komentarze)
- Nazwa protokołu przygotowywania
- Nazwa protokołu HIER
- Nazwa protokołu enzymatycznego
- Nazwa protokołu denaturacji
- Nazwa protokołu hybrydyzacji
- Nazwa protokołu barwienia
- Nazwa protokołu HIER 2
- Nazwa modułu przetwarzania
- ID przebiegu
- Slide created by (szkiełko utworzone przez)
- Stain (barwienie)
- Nazwa markera
- Nazwa markera 2
- Case ID (ID przypadku)
- Doctor (lekarz)
- Dispense volume (objętość dozowania)
- Wersja protokołu przygotowywania
- Wersja protokołu HIER
- Wersja protokołu enzymatycznego
- Wersja protokołu denaturacji
- Wersja protokołu hybrydyzacji
- Wersja protokołu barwienia
- Wersja protokołu HIER 2

- Nazwa protokołu enzymatycznego 2
- Nazwa protokołu denaturacji 2
- Nazwa protokołu hybrydyzacji 2
- Nazwa protokołu barwienia 2
- Nazwa systemu detekcji
- Nazwa systemu detekcji 2
- Wersja protokołu enzymatycznego 2
- Wersja protokołu denaturacji 2
- Wersja protokołu hybrydyzacji 2
- Wersja protokołu barwienia 2
- Numer seryjny systemu detekcji
- Numer seryjny systemu detekcji 2



 Kolumny oznaczone cyfrą 2 w tytule odnoszą się wyłącznie do szkiełek barwionych metodą sekwencyjnego barwienia podwójnego i zawierają informacje związane z drugim barwieniem danego szkiełka.

Aby wyeksportować szczegóły szkiełka, wykonać następującą procedurę:

1. Wybrać żądany zakres dat (zob. [9.2 - Wybór szkiełek](#)).
2. Kliknąć **Export data** (eksportuj dane).
3. Na wyświetlonym monicie potwierdzić chęć zapisu pliku.
4. Plik zostanie zapisany w folderze „Downloads” (pobrane) (lub w innym folderze, jeśli wybrana zostanie opcja **Save as** (zapisz jako)).

Zapisany plik można otworzyć w standardowym arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel, i manipulować nim zależnie od funkcji dostępnych w aplikacji. Podczas otwierania pliku może być konieczne określenie pewnych parametrów. Dla pliku w formacie csv parametry są następujące:

- Typ pliku: **Delimited** (rozdzielany)
- **Delimiter** (ogranicznik) lub **Separator: Comma** (przecinek)
- Format kolumny: **General** (ogólny)

 **Uwaga:** Czas rozpoczęcia przetwarzania w eksportowanych szczegółach szkiełka nie będzie dokładnie odpowiadał czasowi rozpoczęcia na ekranie historii szkiełek. Czas rozpoczęcia wyświetlany na ekranie historii szkiełek wskazuje moment naciśnięcia przycisku uruchamiania przebiegu . Jednak czas wskazany w wyeksportowanych danych to czas rzeczywistego rozpoczęcia przetwarzania przebiegu w module przetwarzania.



## 9.10 Krótka historia szkiełek

Raport skrócony historii szkiełek zawiera informacje na temat wszystkich szkiełek w grupie, które zostały przetworzone (lub są nadal przetwarzane) w okresie wybranym na ekranie **Slide history** (historia szkiełek). Raport zawiera miejsce na zatwierdzenie i może być wykorzystywany jako rejestr przetworzonych szkiełek.

Aby utworzyć skrócony raport historii szkiełek, otworzyć ekran **Slide history** (historia szkiełek) i ustawić daty i godziny **From** (od) i **To** (do). Wyświetlone zostaną wszystkie przetworzone w tym czasie szkiełka z danej grupy (zob. [9.2 - Wybór szkiełek](#)). Kliknąć **Brief slide history** (krótka historia szkiełek) aby wygenerować raport.



W laboratoriach wykonujących dużo badań domyślny zakres czasu na ekranie **Slide history** (historia szkiełek) – tydzień – może obejmować tysiące szkiełek. Wygenerowanie raportu dla tylu szkiełek może potrwać pewien czas, dlatego też należy rozważyć określenie krótszego okresu niż ustawiony domyślnie.

Raport zawiera następujące szczegóły dla każdego szkiełka:


- Case ID (ID przypadku)
- Patient name (imię i nazwisko pacjenta)
- Slide ID (ID szkiełka)
- Marker
- Tissue type (typ tkanki)
- Dispense volume (objętość dozowania)
- Status
- Zatwierdzenie

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

Wszystkie ogólne ustawienia systemu BOND (poza protokołami i odczytnikami) są konfigurowane w oddzielnej aplikacji zwanej „klientem administracyjnym”. Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą obsługiwać klienta administracyjnego i mieć dostęp do wszystkich funkcji.

Klient administracyjny ma następujące ekrany, które otwierają się po kliknięciu ikon na pasku funkcji u góry ekranu klienta:




- [10.1 - Users \(użytkownicy\)](#)
- [10.2 - LIS](#)
- [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)
- [10.4 - BDD](#)
- [10.5 - Settings \(ustawienia\)](#)
- [10.6 - Hardware \(urządzenia\)](#)

## 10.1 Users (użytkownicy)

Użytkownikami systemu BOND można zarządzać z poziomu ekranu **User management** (zarządzanie użytkownikami) klienta administracyjnego. Można tworzyć, edytować i dezaktywować użytkowników. Nie można usuwać użytkowników – pozostają oni w systemie na zawsze. Można jednak dezaktywować użytkowników, uniemożliwiając im dostęp do klienta.




Aktywowani użytkownicy mają przypisane role, które dają im różne uprawnienia w ramach oprogramowania. Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą obsługiwać klienta administracyjnego (i mieć dostęp do wszystkich funkcji). Użytkownicy z uprawnieniami operatora mogą rejestrować odczynniki, konfigurować i przetwarzać szkiełka oraz generować raporty, ale nie mogą edytować szczegółów odczynników, paneli odczynników ani protokołów. Użytkownicy z uprawnieniami przełożonego mają wszystkie uprawnienia operatora, ale mogą również edytować szczegóły odczynników, paneli i protokołów. Użytkownicy mogą mieć przypisaną więcej niż jedną rolę.

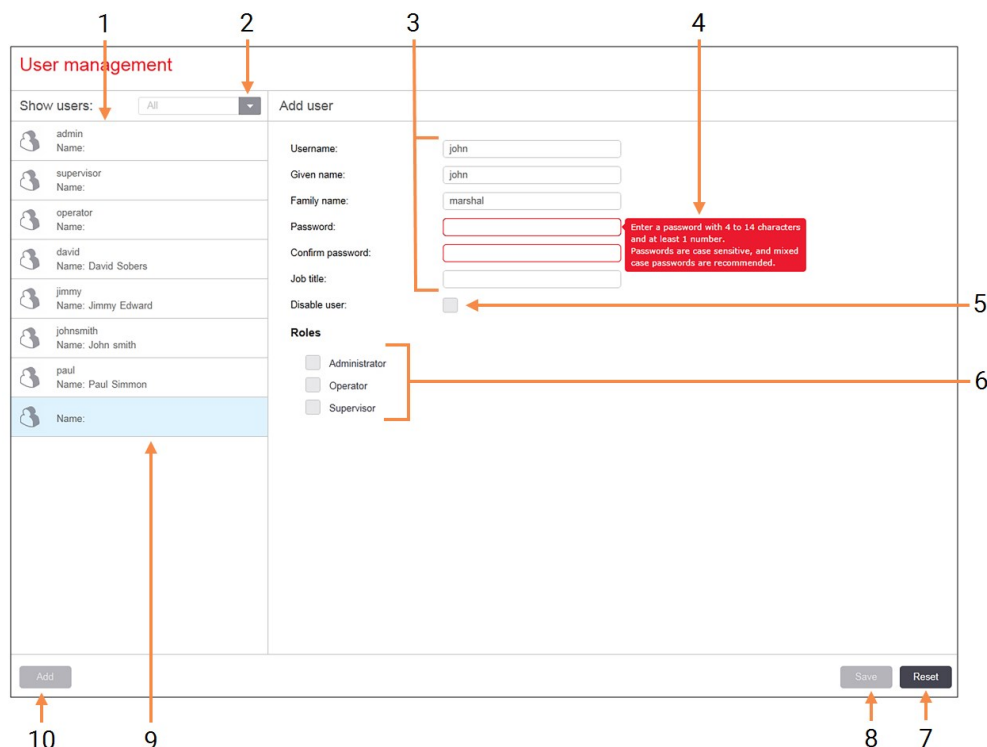

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Lista wszystkich użytkowników BOND	7	<b>Reset (resetuj)</b> Cofnięcie niezapisanych zmian
2	Filtrowanie w celu wyświetlenia wszystkich użytkowników lub tylko aktywowanych lub dezaktywowanych użytkowników	8	<b>Save (zapisz)</b> Zapisywanie zmian dla bieżącego użytkownika
3	Szczegóły wybranego użytkownika	9	Aktualnie wybrany użytkownik – jego szczegóły są wyświetlane po prawej stronie ekranu
4	Komunikat informujący o wymaganiach dotyczących hasła	10	<b>Add (dodaj)</b> Kliknąć, aby wyczyścić pola po prawej stronie ekranu i dodać szczegóły nowego użytkownika
5	<b>Disable user (dezaktywuj użytkownika)</b> Dezaktywacja (lub ponowna aktywacja) aktualnie wybranego użytkownika		
6	<b>Roles (role)</b> Wybierz role użytkownika		

Postać 10-1: Ekran **User management** (zarządzanie użytkownikami)


Każdy nowy użytkownik wymaga nazwy użytkownika i hasła. Obie te informacje są wymagane do zalogowania się do klienta klinicznego i klienta administracyjnego. Po utworzeniu użytkownika nie można zmienić nazwy użytkownika, ale hasło może zostać zmienione. Użytkownicy mogą zmienić swoje hasła w dowolnym momencie w oknach dialogowych logowania do BOND. Administratorzy mogą również zmienić hasło z poziomu ekranu **User management** (zarządzanie użytkownikami). Hasła muszą składać się z 4–14 znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę.

-  W hasłach rozróżniane są wielkie i małe litery; zalecane jest utworzenie hasła składającego się z wielkich i małych liter. Oprogramowanie BOND weryfikuje hasła podczas ich zmiany; nie można zapisać hasła, dopóki nie spełnia minimalnych wymagań. Nie należy udostępniać haseł innym pracownikom. Należy zawsze wylogować się z konta przed oddaleniem się od urządzenia.

Inne dane użytkownika (imiona i nazwiska oraz stanowisko) są opcjonalne. Pojawiają się one w dziennikach i raportach.

## 10.2 LIS

W większości konfiguracja LIS jest przeprowadzana przez personel serwisowy podczas instalacji systemu BOND LIS-ip, jednakże niewielka liczba opcji jest również dostępna dla użytkowników na ekranie **LIS configuration** (konfiguracja LIS). Na tym ekranie wyświetlany jest również dziennik komunikatów o błędach.



## 10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 10-2</a> )	Nr	Nazwa ( <a href="#">Postać 10-2</a> )
1	<b>License (licencja)</b> Pokazuje hasło licencji LIS-ip.	5	<b>Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs) (aktywuj okres ważności nieprzetworzonych szkiełek LIS (godz.))</b> Usuwanie szkiełek otrzymanych z systemu LIS, które nie są przetwarzane w ciągu określonej liczby godzin.
2	<b>Duplicate case ID (zduplikowane ID przypadku)</b> Ustawianie działania dla przypadków o takim samym ID, co istniejące przypadki.	6	<b>Log Messages (komunikaty dziennika)</b> Komunikaty są wyświetlane w postaci listy po kliknięciu View log (wyświetl dziennik) (po prawej stronie).
3	<b>Force LIS printing in BOND (wymuś drukowanie LIS w systemie BOND)</b> Wymuszenie drukowania wszystkich szkiełek LIS przez system BOND. Zob. <a href="#">11.7 - Etykiety szkiełek</a> .	7	<b>Edit LIS data fields (edytuj pola danych LIS)</b> Konfiguracja wyświetlania danych szkiełek w systemie BOND.
4	<b>Enable LIS to update LIS slides (włącz opcję aktualizacji szkiełek LIS przez system LIS)</b> Zastąpienie (aktualizacja) nieprzetworzonych szkiełek, jeśli szkiełka z tym samym ID kodu kreskowego są ponownie przesyłane przez LIS. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, system BOND odrzuci wszelkie próby ponownego wykorzystania tego samego identyfikatora kodu kreskowego przez system LIS.	8	<b>View log (wyświetl dziennik)</b> Wyświetlanie listy błędów wynikających z komunikatów LIS wysłanych do BOND, lub odpowiedzi systemu BOND na komunikaty LIS. Kliknąć ponownie, aby zaktualizować listę o ostatnie błędy.

Postać 10-2: Ekran **LIS configuration** (konfiguracja LIS)



## License (licencja)

BOND LIS-ip wymaga licencji aktywowanej hasłem dostarczonym przez Leica Biosystems. Zazwyczaj hasło jest wprowadzane przez personel serwisowy, który konfiguruje połączenie LIS-ip, ale jeśli nie zostało ono wprowadzone, na ekranie będzie widoczne tylko pole **License** (licencja). Wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję LIS-ip i wyświetlić opcje konfiguracji oraz dziennika pokazane na [Postać 10-2](#).

## Duplicate Case ID (zduplikowane ID przypadku)

W ustawieniu **Duplicate case ID** (zduplikowane ID przypadku) wybierany jest sposób postępowania z przypadkami otrzymanymi z systemu LIS z tym samym ID, co wygasły lub usunięty przypadek LIS znajdujący się już w systemie BOND. (Jeśli przypadek LIS ma taki sam identyfikator jak istniejący przypadek BOND, np. utworzony w systemie BOND, jest on automatycznie odrzucany. Dostępne są dwie opcje:

- **Resurrect existing case** (przywróć istniejący przypadek): po otrzymaniu nowego przypadku, pod warunkiem, że ma on takie samo imię i nazwisko pacjenta jak istniejący przypadek, istniejący przypadek zostanie przywrócony (tj. zostanie ponownie użyty). Jeśli nowy przypadek ma to samo ID przypadku, ale inne imię i nazwisko pacjenta, zostanie odrzucony. Jeśli imię i nazwisko lekarza zmieniło się, zostanie użyte nowe imię i nazwisko.
- **Reject message** (odrzuć komunikat): nowy przypadek LIS nie jest przenoszony do systemu BOND. Komunikat jest rejestrowany w dzienniku systemu LIS. Należy zmienić ID przypadku w systemie LIS i ponownie przesłać przypadek.

Sposób postępowania ze zduplikowanymi ID przypadków poza systemem LIS opisano w rozdziale [6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku](#). Ogólne informacje na temat przypadków LIS podano w rozdziale [11.2.2 - Przypadki LIS](#).

## Pola danych szkiełek LIS

Instalacja BOND LIS-ip może być skonfigurowana tak, aby system LIS przysyłał do systemu BOND do siedmiu parametrów dla każdego szkiełka. Służą one wyłącznie do celów poglądowych i są wyświetlane na karcie **LIS** w oknie dialogowym **Slide properties** (właściwości szkiełka). Podstawowa konfiguracja tych parametrów jest wykonywana przez technika serwisu, ale użytkownik może ukrywać dowolne pola parametrów i ustawiać ich nazwy.

Zaznaczyć pola, które mają być wyświetlane i wprowadzić nazwy pól.

## 10.3 Labels (etykiety)

Przejsć do ekranu **Label templates** (szablony etykiet), aby utworzyć i edytować szablony etykiet szkiełek oraz wybrać szablony do użycia.





Dostępnych jest osiem typów szablonów, które można użyć z ośmioma typami szkiełek w systemie BOND:

- BOND single stain (barwienie pojedyncze BOND)
- BOND Oracle
- BOND sequential double stain (sekwencyjne barwienie podwójne BOND)
- BOND parallel double stain (równoczesne barwienie podwójne BOND)
- LIS single stain (barwienie pojedyncze LIS)
- LIS Oracle
- LIS sequential double stain (sekwencyjne barwienie podwójne LIS)
- LIS parallel double stain (równoczesne barwienie podwójne LIS)

Szablony „BOND” są przeznaczone dla szkiełek utworzonych w systemie BOND, a szablony „LIS” – dla szkiełek utworzonych w systemie LIS, ale wydrukowanych przez system BOND.

Dostępne są trzy wstępnie zdefiniowane szablony (kod kreskowy 2D, kod kreskowy 1D i OCR) dla każdego typu szkiełka. Nie można ich edytować ani usuwać. W ustawieniu **BOND label ID** (ID etykiety BOND) przedstawionym w części [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#) określany jest domyślny szablon: OCR lub kod kreskowy 2D.


-  Podczas aktualizacji z BOND 5.1 do wersji BOND 6.0 lub nowszej istniejące szablony domyślne są zachowywane, a szablony kodów kreskowych 2D są również dostępne do użycia.
-  Jeśli system BOND został zaktualizowany z poprzedniej wersji, można nadal korzystać z istniejącego skanera kodów kreskowych. Poprzedni model nie obsługuje jednak kodów kreskowych 2D.

Aby użyć innego szablonu dla danego typu szkiełka, należy skopiować domyślny szablon i edytować otrzymany „szablon użytkownika”. Następnie należy go „aktywować”, aby system BOND używał go dla szkiełek tego typu. Można utworzyć dowolną liczbę szablonów dla każdego typu szkiełka, ale jednocześnie można aktywować tylko jeden.



Należy zawsze umieszczać odpowiednie informacje na etykietach, aby mieć pewność, że w przypadku niepowodzenia automatycznej identyfikacji etykiety mogą zostać zidentyfikowane ręcznie. Leica Biosystems zaleca, aby dla wszystkich szkiełek dostępne były następujące informacje:

- ID przypadku lub imię i nazwisko pacjenta
- ID szkiełka, jeśli używane są kody kreskowe
- Typ tkanki – w celu identyfikacji tkanek kontrolnych; oraz
- Marker – przeciwiało pierwszorzędowe lub sonda, które mają być zastosowane.

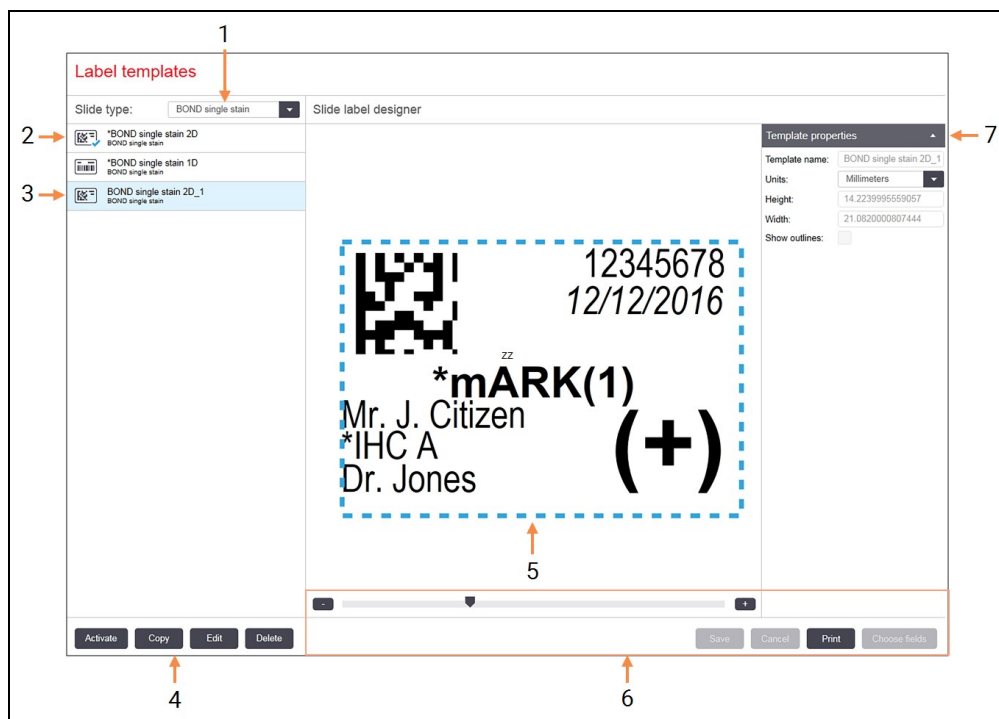


Nr	Opis	Nr	Opis
1	<b>Slide type (typ szkiełka)</b> Wybrać typ szkiełka – wszystkie szablony dla danego typu są wyświetlane w okienku poniżej	5	Okienko edycji z układem wybranego szablonu po lewej stronie
2	Aktywny szablon (z niebieskim symbolem zaznaczenia)	6	Polecenia dotyczące edytowania szablonu – zob. <a href="#">Postać 10-5 - Polecenia dotyczące edytowania szablonu etykiet</a>
3	Wybrany szablon, wyświetlany w okienku edycji po prawej stronie	7	<b>Template properties (właściwości szablonu)</b> Ogólne właściwości aktualnie wybranego układu szablonu (tylko do odczytu do momentu kliknięcia przycisku Edit (edytuj) w okienku po lewej stronie)
4	Polecenia dotyczące zarządzania szablonem – zob. <a href="#">Postać 10-4 - Polecenia dotyczące zarządzania szablonem etykiet</a>		

Postać 10-3: Ekran **Label templates** (szablony etykiet)



Nr	Opis	Nr	Opis
1	Ustawianie aktualnie wybranego szablonu jako szablonu, który ma być używany dla wszystkich etykiet szkiełek dla aktualnie wybranego typu szkiełka.	3	Edytowanie aktualnie wybranego szablonu za pomocą okienka edycji i poleceń z prawej strony ekranu. Nie można edytować domyślnych szablonów.
2	Kopiowanie aktualnie wybranego szablonu w celu utworzenia nowego szablonu „użytkownika”.	4	Usuwanie aktualnie wybranego szablonu. Nie można usuwać domyślnych szablonów.

Postać 10-4: Polecenia dotyczące zarządzania szablonem etykiet

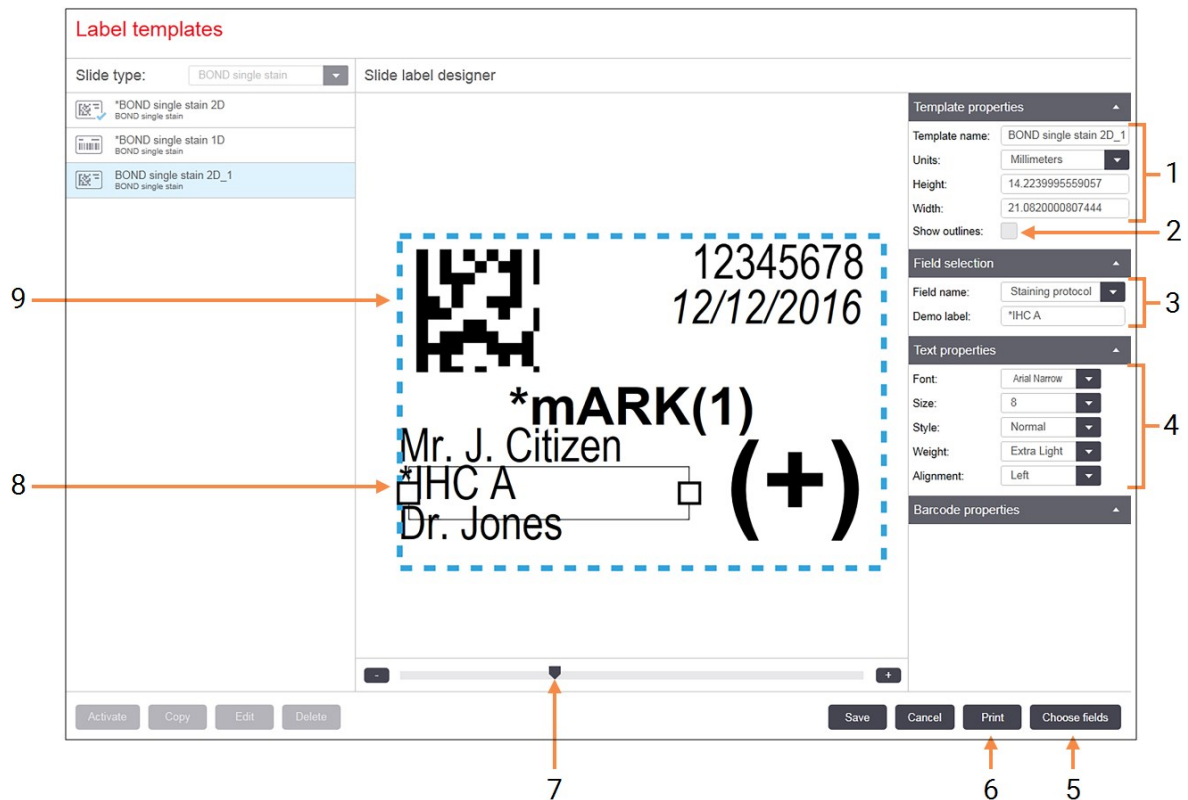

Nr	Opis	Nr	Opis
1	<b>Template properties (właściwości szablonu)</b> Wprowadzanie nazwy i rozmiaru szablonu	5	<b>Choose fields (wybierz pola)</b> Otwieranie okna dialogowego, w celu dodania lub usunięcia pól z układu
2	<b>Show outlines (pokaż kontury)</b> Wyświetlanie konturów pól w okienku edycji	6	<b>Print (drukuj)</b> Drukowanie bieżącego układu na wybranej drukarce
3	<b>Field selection (wybór pola)</b> Wybieranie typu pola, które zostanie podświetlone w okienku edycji. Wprowadzanie tekstu demonstracyjnego dla tego pola.	7	Suwak do powiększania i pomniejszania widoku etykiety demonstracyjnej
4	<b>Text properties (właściwości tekstu)</b> Konfiguracja właściwości tekstu dla wybranego pola	8	Aktualnie wybrane pole – można je skonfigurować w okienku Text properties (właściwości tekstu) po prawej stronie. Przeciągnąć kwadraciki na brzegach pola, aby zmienić szerokość lub położenie całego pola.
		9	Pole z ID etykiety lub kodem kreskowym – nie można zmieniać rozmiaru tego pola

Postać 10-5: Polecenia dotyczące edytowania szablonu etykiet

Zob. również:

- [10.3.1 - Tworzenie, edycja i aktywacja szablonów etykiet](#)
- [10.3.2 - Typy informacji](#)


### 10.3.1 Tworzenie, edycja i aktywacja szablonów etykiet

Nowe szablony można utworzyć poprzez skopiowanie i edycję istniejących szablonów. Można również edytować istniejące szablony użytkownika (ale nie szablony domyślne). Aktywacja szablonu oznacza, że dany szablon będzie używany do etykiet wydrukowanych w systemie BOND systemu.

- [10.3.1.1 - Tworzenie nowego szablonu](#)
- [10.3.1.2 - Edycja szablonu](#)
- [10.3.1.3 - Aktywacja szablonu](#)

#### 10.3.1.1 Tworzenie nowego szablonu

1. Wybrać typ szkiełka, dla którego tworzony jest nowy szablon.  
Wyświetlone zostaną wszystkie istniejące szablony dla danego typu szkiełka.
2. Wybrać szablon do skopiowania (wybrać szablon najbardziej podobny do tego, który ma być utworzony).
3. Kliknąć **Copy** (kopiuj).


 Skopiowanie szablonu z kodem kreskowym 1D spowoduje utworzenie nowego „szablonu użytkownika” z kodem kreskowym 1D.

Skopiowanie szablonu z kodem kreskowym 2D spowoduje utworzenie nowego „szablonu użytkownika” z kodem kreskowym 2D.

Skopiowanie szablonu z OCR spowoduje utworzenie nowego „szablonu użytkownika” z OCR.


#### 10.3.1.2 Edycja szablonu

1. Wybrać szablon w okienku po lewej stronie i kliknąć **Edit** (edytuj).  
Okienko edycji, przyciski i listy właściwości po prawej stronie ekranu umożliwiają edycję układu szablonu.
2. Opcjonalnie można wybrać opcję **Show outlines** (pokaż kontury) (w części **Template properties** (właściwości szablonu) w prawym górnym rogu), aby wyświetlić granice pola w okienku edycji.
3. Wprowadzić nazwę szablonu w polu **Template properties** (właściwości szablonu).


 Nazwa szablonu etykiety może składać się maksymalnie z 64 znaków, a wszystkie nazwy używane w tej samej kategorii typu szkiełka muszą być unikatowe.

4. Edycja układu:
  - i. Dodawanie lub usuwanie pól – kliknąć **Choose fields** (wybierz pola) i wybrać właściwości szkiełka, które mają być wyświetlane (lista wszystkich dostępnych właściwości znajduje się w części [10.3.2 - Typy informacji](#)).
  - Należy pamiętać, że nie można usunąć pola **Label ID** (ID etykiety), które jest używane do automatycznej identyfikacji.
  - ii. Pozycjonowanie pól – wybrać i przeciągnąć pola w okienku edycji.
  - iii. Zmiana szerokości pola – przeciągnąć okienka na obu końcach pola. (Wysokość pola jest ustawiana na podstawie rozmiaru czcionki tekstu).


Jeśli ustawiona szerokość pola nie jest wystarczająca dla danej etykiety w przypadku korzystania z szablonu, tekst jest przycięty i dodawany jest wielokropek w celu zaznaczenia, że nastąpiło przycięcie.

 Nie wolno zmieniać rozmiaru pola **Label ID** (ID etykiety) – należy pozostawić ustawienie domyślne, aby można było odczytać identyfikator za pomocą czytnika modułu przetwarzania.

iv. Ustawianie właściwości tekstu – wybrać pole i ustawić rodzaj oraz rozmiar czcionki, styl i wagę w polu **Text properties** (właściwości tekstu). Ustawić również wyrównanie tekstu w polu.

 Nie można zmieniać parametrów czcionki w polu **Label ID** (ID etykiety) – należy pozostawić ustawienie domyślne, aby można było odczytać identyfikator za pomocą czytnika modułu przetwarzania.

5. Kliknąć **Save** (zapisz).

 Upewnić się, że wokół pola **Label ID** (ID etykiety) znajduje się wolne miejsce. Jeśli tekst z innych pól zachodzi na ten obszar, może to zakłócić automatyczną identyfikację.

### 10.3.1.3 Aktywacja szablonu

1. Wybrać szablon w okienku po lewej stronie i kliknąć **Activate** (aktywuj).

Szablon oznaczany jest niebieskim symbolem zaznaczenia, który wskazuje, że szablon jest teraz aktywny.

### 10.3.2 Typy informacji

Szablony etykiet można skonfigurować tak, aby wyświetlały wybrane informacje o szkiełkach podane w oknie dialogowym **Choose fields** (wybierz pola) na ekranie **Labels** (etykiety).

Pole **Label ID** (ID etykiety) używane do automatycznej identyfikacji nie może zostać usunięte z żadnego szablonu.

Pole jest wyświetlane w postaci kodu kreskowego lub znaków alfanumerycznych, w zależności od ustawień systemu.

Pole	Opis
Case ID (ID przypadku)	ID przypadku dla szkiełka (uwaga: to nie jest numer przypadku – zob. <a href="#">6.3.2 - Identyfikator przypadku</a> ).
Slide created by (szkiełko utworzone przez)	Nazwa użytkownika, który utworzył szkiełko lub „LIS”, w odpowiednich przypadkach
Denaturation protocol (protokół denaturacji)	Skrócona nazwa protokołu denaturacji.
Denaturation protocol 2 (protokół denaturacji 2)	Skrócona nazwa drugiego protokołu denaturacji (może być wymagana dla protokołów barwienia podwójnego).
Dispense volume (objętość dozowania)	Objętość dozowania 100 µl lub 150 µl.
Doctor comment (komentarz lekarza)	Komentarz zapisany w systemie BOND dla lekarza kierującego (zob. <a href="#">6.4 - Zarządzanie lekarzami</a> ).
Doctor (lekarz)	Imię i nazwisko lekarza kierującego.
EIER protocol (protokół EIER)	Skrócona nazwa protokołu enzymu.
EIER protocol 2 (protokół EIER 2)	Skrócona nazwa drugiego protokołu enzymu (może być wymagana dla protokołów barwienia podwójnego).
Facility (placówka)	Nazwa placówki wprowadzona w polu <b>Facility</b> (placówka) na ekranie <b>Laboratory settings</b> (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego – zob. <a href="#">10.5.1 - Ustawienia laboratorium</a> .
HIER protocol (protokół HIER)	Skrócona nazwa protokołu HIER.
HIER protocol 2 (protokół HIER 2)	Skrócona nazwa drugiego protokołu HIER (może być wymagana dla protokołów barwienia podwójnego).
Hybridization protocol (protokół hybrydyzacji)	Skrócona nazwa protokołu hybrydyzacji ISH.
Hybridization protocol 2 (protokół hybrydyzacji 2)	Skrócona nazwa drugiego protokołu hybrydyzacji ISH (może być wymagana dla protokołów barwienia podwójnego).
LIS doctor comment (komentarz lekarza LIS)	W przypadku systemów LIS-ip: komentarz dla lekarza w systemie LIS.
LIS doctor (lekarz LIS)	W przypadku systemów LIS-ip: imię i nazwisko lekarza.



Pole	Opis
LIS reference [2–8] (odniesienie LIS [2–8])	Właściwości szkiełek LIS zaimportowane do systemu BOND. Zob. <a href="#">11.2.6 - Pola danych szkiełek LIS</a> .
Marker	Skrócona nazwa pierwszorzędowego przeciwciała lub sondy dla pojedynczego barwienia, równoczesnego barwienia podwójnego lub pierwszego barwienia w przypadku sekwencyjnego barwienia podwójnego.
Marker 2	Skrócona nazwa pierwszorzędowego przeciwciała lub sondy dla drugiego barwienia w przypadku barwienia podwójnego.
Patient comment (komentarz dot. pacjenta)	Komentarz dot. przypadku (zob. <a href="#">6.3.3 - Dodawanie przypadku</a> ).
Patient (pacjent)	Imię i nazwisko pacjenta.
Preparation protocol (protokół przygotowywania)	Skrócona nazwa protokołu przygotowywania.
Pulic name (nazwa publiczna)	W przypadku systemów LIS-ip nazwa publiczna przeciwciała pierwszorzędowego lub sondy (zob. <a href="#">11.2.4 - Nazwy publiczne markerów</a> ), dla pojedynczego barwienia lub pierwszego barwienia w przypadku barwienia podwójnego.
Public name 2 (nazwa publiczna 2)	W przypadku systemów LIS-ip nazwa publiczna przeciwciała pierwszorzędowego lub sondy (zob. <a href="#">11.2.4 - Nazwy publiczne markerów</a> ), dla drugiego barwienia w przypadku barwienia podwójnego.
Slide comment (komentarz dot. szkiełka)	Komentarz dotyczący szkiełka (zob. <a href="#">6.5.2 - Tworzenie szkiełek</a> ).
Slide date (data szkiełka)	Data wydrukowania etykiety (krótki format określony w opcjach regionalnych i językowych systemu Windows (panel sterowania)).
Slide ID (OCR mode) (ID szkiełka (tryb OCR))	Identyfikator szkiełka złożony z 4 znaków alfanumerycznych, unikalny dla szkiełka w systemie BOND. Jest to pierwsza część ID etykiety.
Slide ID (barcode mode) (ID szkiełka (tryb kodu kreskowego))	Identyfikator szkiełka złożony z 8 cyfr, unikalny dla szkiełka w systemie BOND.
Slide priority (priorytet szkiełka)	W przypadku systemów LIS-ip: priorytet dla szkiełka.
Staining mode (tryb barwienia)	Barwienie pojedyncze, barwienie podwójne, badanie diagnostyczne lub teranostyczne.
Staining protocol (protokół barwienia)	Skrócona nazwa protokołu barwienia w przypadku barwienia pojedynczego lub pierwszego barwienia w przypadku barwienia podwójnego.
Staining protocol 2 (protokół barwienia 2)	Skrócona nazwa protokołu barwienia dla drugiego barwienia w przypadku barwienia podwójnego.

10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

---

<b>Pole</b>	<b>Opis</b>
Tissue type (typ tkanki)	Tkanka testowa lub dodatnia lub ujemna tkanka kontrolna. BOND drukuje „(-)” w przypadku ujemnej próbki kontrolnej, „(+)” w przypadku dodatniej próbki kontrolnej lub nic w przypadku tkanki testowej.

---

## 10.4 BDD

Przejdź do ekranu **BDD update** (aktualizacja BDD), aby zaktualizować definicje danych BOND i wygenerować pliki dziennika audytu.



**BDD update**

Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Data Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents.

File selected: \_\_\_\_\_

Import status: Successful

Update log

Time	Level	Category	Log entry
23-Aug-13 11:30:52 AM	Information	Test management	Finished
23-Aug-13 11:30:52 AM	Information	Instrument management	Started
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Instrument management	Finished
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Case management	Started
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Case management	Finished
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Rules management	Started
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Rules management	Finished
23-Aug-13 11:31:49 AM	Information	Import SQL scripts	Started
23-Aug-13 11:31:50 AM	Information	Import SQL scripts	Finished
23-Aug-13 11:31:50 AM	Information	Label management	Started
23-Aug-13 11:31:51 AM	Information	Label management	Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM	Information	BDD update	Finished

Export audit trail

Nr	Opis
1	Dziennik aktualizacji BDD
2	Wybrany plik aktualizacji BDD
3	Pasek postępu i status aktualizacji BDD
4	Browse (przełącznik) – lokalizacja pliku aktualizacji BDD i otwieranie pliku w polu po lewej stronie
5	<b>Load (wczytaj)</b> Kliknąć, aby zainstalować plik aktualizacji BDD w polu po lewej stronie
6	<b>Export audit trail (eksportuj dziennik audytu)</b> Kliknąć, aby wygenerować pliki dziennika audytu – <a href="#">10.4.2 - Dziennik audytu</a>

Postać 10-6: Ekran **BDD update** (aktualizacja BDD)

Zob.

- [10.4.1 - Aktualizacje BDD](#)
- [10.4.2 - Dziennik audytu](#)

### 10.4.1 Aktualizacje BDD


Leica Biosystems okresowo publikuje aktualizacje BDD (definicji danych BOND) na stronie internetowej, np. w celu dodania nowo wprowadzonych odczytników. Pliki aktualizacji BDD dla BOND 6.0 mają rozszerzenie „\*.bdd”. Aktualizacje należy zainstalować z poziomu ekranu **BDD update** (aktualizacja BDD).




Dostępne są różne pliki aktualizacji BDD dla różnych regionów świata, odzwierciedlające różne przepisy obowiązujące w tych regionach. Należy pamiętać, aby zainstalować odpowiedni plik aktualizacji dla swojego regionu (informacje o regionie wyświetlają się w oknie dialogowym **About BOND** (o systemie BOND), zob. [3.9 - O systemie BOND](#) (o systemie BOND)). W przypadku wątpliwości dotyczących użycia właściwego pliku, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Aktualizację BDD można zainstalować w dowolnym momencie.

1. Pobrać plik aktualizacji i zapisać w kontrolerze BOND (lub w dowolnym terminalu BOND w systemach BOND-ADVANCE).
2. Przejść do ekranu **BDD update** (aktualizacja BDD) w kliencie administracyjnym.
3. Kliknąć **Browse** (przełóż) i zlokalizować plik aktualizacji w oknie dialogowym **Open** (otwórz) systemu Windows.
4. Kliknąć **Open** (otwórz), aby wyświetlić plik BDD w polu w pobliżu lewego górnego rogu ekranu.
5. Kliknąć **Load** (wczytaj), aby zaktualizować definicje i zapisać nowe dane.
6. Wiadomości są zapisywane w oknie **Update Log** (dziennik aktualizacji) w miarę postępu aktualizacji. W ostatnim wierszu wyświetlany jest komunikat „BDD update: (aktualizacja BDD:) Finished (zakończono)” po zakończeniu aktualizacji, a poniżej paska postępu w górnym okienku pojawi się status „Successful” (zakończono pomyślnie).

 Jedynym sposobem sprawdzenia, czy aktualizacja BDD została pomyślnie zakończona, jest sprawdzenie informacji na ekranie **BDD update** (aktualizacja BDD). Jedynym sposobem sprawdzenia, czy aktualizacja BDD została pomyślnie zakończona, jest sprawdzenie informacji na ekranie **BDD update** (aktualizacja BDD). Proces trwa tylko kilka minut, dlatego zalecamy, aby poczekać na zakończenie aktualizacji przed przejściem do innego ekranu.

 Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, definicje danych powrócą do stanu sprzed aktualizacji, a w oknie Update Log (dziennik aktualizacji) pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

## 10.4.2 Dziennik audytu

Można wygenerować dziennik audytu zawierający wszystkie zmiany w systemie, w tym informacje o osobach wprowadzających zmiany i daty zmian. Dziennik audytu jest zapisywany w kilku plikach CSV, z których każdy zawiera inne kategorie informacji. Pliki są zapisywane w folderze: BOND Drop-box\Audit\RRRRMMDD-GGmmss w kontrolerze.

Aby utworzyć pliki dziennika audytu:

1. Przejść do ekranu **BDD update** (aktualizacja BDD) i kliknąć **Export audit trail** (eksportuj dziennik audytu).
2. Wybrać **All data** (wszystkie dane), aby zaraportować wszystkie zmiany w całym okresie eksploatacji systemu lub **Custom date range** (niestandardowy zakres dat), aby wybrać określony okres, a następnie zdefiniować daty i godziny w polach **From** (od) oraz **To** (do).
3. Kliknąć **Export** (eksportuj).

## 10.5 Settings (ustawienia)


Ekran **Settings** (ustawienia) zawiera ogólne ustawienia dotyczące laboratorium dla systemu BOND (**Laboratory settings** (ustawienia laboratorium)) oraz domyślne ustawienia przypadków i szkiełek, a także opcje przebiegu pracy (**Case and slide settings** (ustawienia przypadków i szkiełek)).



- [10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#)
- [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)
- [10.5.3 - Kopie zapasowe bazy danych](#)

### 10.5.1 Ustawienia laboratorium

W okienku **Laboratory settings** (ustawienia laboratorium) można ustawić ogólne opcje laboratorium:

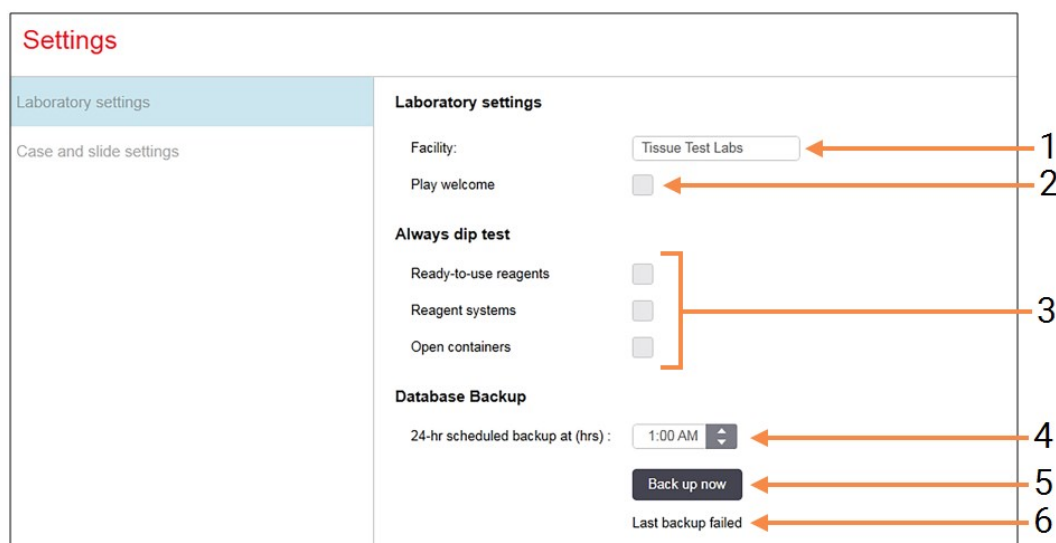

Nr	Opis	Nr	Opis
1	<b>Facility (placówka)</b> Wpisać nazwę laboratorium, która będzie pojawiała się w raportach	4	<b>24-hr scheduled backup at (hrs) (zaplanowana kopia zapasowa wykonywana co 24 godziny o (godz.))</b> Ustawić godzinę wykonywania codziennych kopii zapasowych bazy danych (format 24-godzinny) – zob. <a href="#">10.5.3 - Kopie zapasowe bazy danych</a> .
2	<b>Play welcome (odtwórz powitanie)</b> Odtwarzanie wiadomości powitalnej przy uruchamianiu oprogramowania BOND	5	<b>Back up now (wykonaj kopię zapasową teraz)</b> Natychmiastowe wykonywanie kopii zapasowej bazy danych – <a href="#">10.5.3 - Kopie zapasowe bazy danych</a> .
3	<b>Always dip test (zawsze wykonuj test zanurzeniowy)</b> Zaznaczyć tę opcję, aby przed każdym przebiegiem wykonywać test zanurzeniowy określonych typów pojemników na odczynnik – zob. <a href="#">8.3.1 - Określanie objętości odczynnika</a>	6	Informacje o ostatniej kopii zapasowej lub pasek postępu w trakcie tworzenia kopii zapasowej

Postać 10-7: Ekran **Settings** (ustawienia), okienko **Laboratory settings** (ustawienia laboratorium)

## 10.5.2 Ustawienia przypadków i szkiełek

Ustawienia przypadków i szkiełek umożliwiają ustawienie:

- domyślnych wartości w konfigurowalnych polach dotyczących tworzenia przypadków i szkiełek
- opcji przebiegu pracy podczas tworzenia przypadków i szkiełek.

Zob. opcje dotyczące przypadków i szkiełek na [Postać 10-8](#) oraz [Postać 10-9](#).

Nr	Opis	Nr	Opis
1	<b>Default preparation (domyślne przygotowanie)</b> Domyślny protokół przygotowania dla nowych przypadków.	4	<b>Processed case lifetime (czas wyświetlania przetworzonego przypadku)</b> Liczba dni, w których przypadek pozostaje na ekranie konfiguracji szkiełek po przetworzeniu ostatniego szkiełka w danym przypadku – zob. <a href="#">6.3.4.2 - Czas wyświetlania przetworzonego przypadku</a> .
2	<b>Default dispense volume (domyślna objętość dozowania)</b> Domyślna objętość dozowania dla nowych przypadków.	5	<b>Create daily case (utwórz przypadek dzienny)</b> Automatycznie utwórz jeden przypadek każdego dnia dla wszystkich szkiełek przetwarzanych w danym dniu – zob. <a href="#">6.3.7 - Opcja przypadku dziennego</a>
3	<b>Create impromptu cases/slides (utwórz przypadki/szkiełka ręcznie)</b> Ustawienie opcji tworzenia przypadków i/lub szkiełek po załadowaniu szkiełek – zob. <a href="#">6.8.2 - Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu</a>		

Postać 10-8: Ustawienia przypadków w okienku **Case and slide settings** (ustawienia przypadków i szkiełek)

---

Nr	Opis	Nr	Opis
1	<b>Staining mode (tryb barwienia)</b> Domyślne ustawienie dla nowych szkiełek – zob. <a href="#">6.5.2 - Tworzenie szkiełek</a> .	3	<b>Force printing in BOND (wymuś drukowanie w systemie BOND)</b> Zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie szkiełek z etykietami wydrukowanymi w systemie BOND – zob. <a href="#">6.8.2 - Opcje identyfikacji szkiełek w urządzeniu</a>
2	<b>BOND label ID (ID etykiety BOND)</b> Ustawienie identyfikatorów głównych etykiet dla szkiełek utworzonych w systemie BOND w postaci kodów kreskowych 1D lub 2D, lub tekstu alfanumerycznego (OCR).		

---

Postać 10-9: Ustawienia szkiełek w okienku **Case and slide settings** (ustawienia przypadków i szkiełek)

### 10.5.3 Kopie zapasowe bazy danych

W bazie danych przechowywane są kluczowe informacje o pacjencie. Jest ona niezbędna do prawidłowego działania systemu BOND, dlatego aby mieć pewność, że w przypadku uszkodzenia bazy danych możliwe będzie jej odzyskanie, system BOND posiada opcje automatycznego i ręcznego wykonywania kopii zapasowych:

- Automatyczne codzienne kopie zapasowe
- „Ręczne” wykonywanie kopii zapasowych na żądanie

Wszystkie pliki kopii zapasowej są zapisywane w kontrolerze BOND w podfolderach folderu:

B:\BOND Drop-box\Backups

Dla każdego typu kopii zapasowej tworzone są dwa pliki, zawsze o nazwie w tym samym formacie:

[Nazwa placówki]\_BOND\_RRRR-MM-DD-GG-mm-ss

gdzie nazwa placówki odpowiada nazwie wprowadzonej na ekranie **Settings** (ustawienia) klienta administracyjnego (zob. [10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#)) (lub domyślnie jako „Facility”, jeśli nie wprowadzono nazwy placówki). Nazwa zawiera datę i godzinę wykonania kopii zapasowej. Główny plik kopii zapasowej posiada rozszerzenie „.dump”. Tworzony jest również plik dziennika z rozszerzeniem „.log”.

Automatyczne codzienne tworzenie kopii zapasowych odbywa się w czasie ustawionym na ekranie **Settings** (ustawienia) klienta administracyjnego ([10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#)). Najnowsza kopia zapasowa znajduje się w folderze „Scheduled\_Latest” (zaplanowane\_najnowsze). Zostanie ona przeniesiona do folderu „Scheduled\_1\_Days\_Old” (zaplanowane\_1\_dzień\_temu), podczas wykonywania kopii zapasowej następnego dnia i tak dalej przez kolejne sześć dni (do folderu „Scheduled\_7\_Days\_Old” (zaplanowane\_7\_dni\_temu)).

Jeśli kontroler BOND jest wyłączony w zaplanowanym czasie tworzenia kopii zapasowej, kopia zapasowa nie jest wykonywana. Należy upewnić się, że w ustawionym czasie kontroler będzie włączony i najprawdopodobniej żaden przebieg nie będzie uruchomiony.

Kopię zapasową można wykonać ręcznie w dowolnym momencie (z wyjątkiem sytuacji, gdy w danej chwili wykonywana jest automatyczna kopia zapasowa), z poziomu ekranu **Settings** (ustawienia) klienta administracyjnego. Kliknąć **Back up now** (wykonaj kopię zapasową teraz) w części **Database backup** (kopia zapasowa bazy danych) (zob. [10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#)).



Okno dialogowe informuje o zakończeniu tworzenia kopii zapasowej. Pliki kopii zapasowej i dziennika są zapisywane w folderze „Manual” (ręczna). Przy kolejnej ręcznej kopii zapasowej pliki są przenoszone do folderu „Manual\_Previous” (ręczna\_poprzednia). Pliki są usuwane po wykonaniu trzeciej ręcznej kopii zapasowej – tj. zapisywane są tylko dwie ostatnie ręczne kopie zapasowe.

Jeśli wykonywanie jakiegokolwiek typu kopii zapasowej nie zakończy się pomyślnie, po prawej stronie paska funkcji w kliencie administracyjnym i klinicznym pojawi się ikona (pokazana po prawej). Ikona jest wyświetlana do czasu pomyślnego wykonania kopii zapasowej.



W przypadku pojawienia się tej ikony, należy jak najszybciej wykonać ręczną kopię zapasową. Jeśli wykonanie tej kopii również nie powiedzie się, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Szczególnie w przypadku starszych systemów BOND, w których zgromadzono więcej danych, należy od czasu do czasu sprawdzać, czy dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na pliki kopii zapasowych. Zazwyczaj jeden plik kopii zapasowej jest usuwany przy zapisywaniu nowego, więc użycie dysku wzrasta tylko w stosunkowo małym stopniu. Jednak w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba zapewnienia dodatkowego miejsca na dysku – w takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, pliki kopii zapasowych należy regularnie kopiować do innego miejsca (poza kontrolerem BOND). Jeśli to możliwe, należy zorganizować automatyczne kopie zapasowe we współpracy z działem informatycznym. Jeśli nie jest to możliwe, należy kopiować pliki ręcznie raz w tygodniu (lub częściej w przypadku laboratoriów o dużym obrocie). Kontroler BOND uruchamia bezpieczny serwer FTP. Pracownicy działu informatycznego mogą zalogować się i pobrać pliki kopii zapasowej z folderu BOND Drop-box poprzez bezpieczne połączenie FTP.

W przypadku konieczności przywrócenia bazy danych należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

## 10.6 Hardware (urządzenia)

Przejdź do ekranu **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia), aby skonfigurować moduły przetwarzania, grupy (grupy modułów przetwarzania sterowanych przez jednego klienta) i drukarki etykiet do szkiełek.




Konfiguracja urządzenia jest przeprowadzana na trzech kartach:

- [10.6.1 - Processing Modules \(moduły przetwarzania\)](#)
- [10.6.2 - Pods \(grupy\)](#)
- [10.6.3 - Slide Labelers \(drukarki etykiet do szkiełek\)](#)

### 10.6.1 Processing Modules (moduły przetwarzania)


Wyświetlanie modułów przetwarzania w systemie BOND i konfiguracja zbiorczych pojemników na odczynniki w karcie **Processing modules** (moduły przetwarzania).

Gdy moduł przetwarzania jest fizycznie podłączony do kontrolera BOND za pomocą kabla sieciowego, automatycznie pojawia się w okienku po lewej stronie na karcie **Processing modules** (moduły przetwarzania).

 Kontroler BOND umożliwia podłączenie tylko zgodnych modułów przetwarzania. W przypadku podłączenia niezgodnego modułu przetwarzania wyświetli się ikona i komunikat błędu (zob. tabela ikon i ich znaczenie na następnym stronie).

Wybrać moduł przetwarzania, aby wyświetlić jego szczegóły z prawej strony karty. Należy podać unikatową nazwę modułu przetwarzania i, w razie potrzeby, wyłączyć część pojemników zbiorczych (zob. [10.6.1.1 - Wyłączanie zbiorczych pojemników na odczynniki](#)). Po zapisaniu tych ustawień moduł przetwarzania zostanie uznany za „oddany do eksploatacji”.





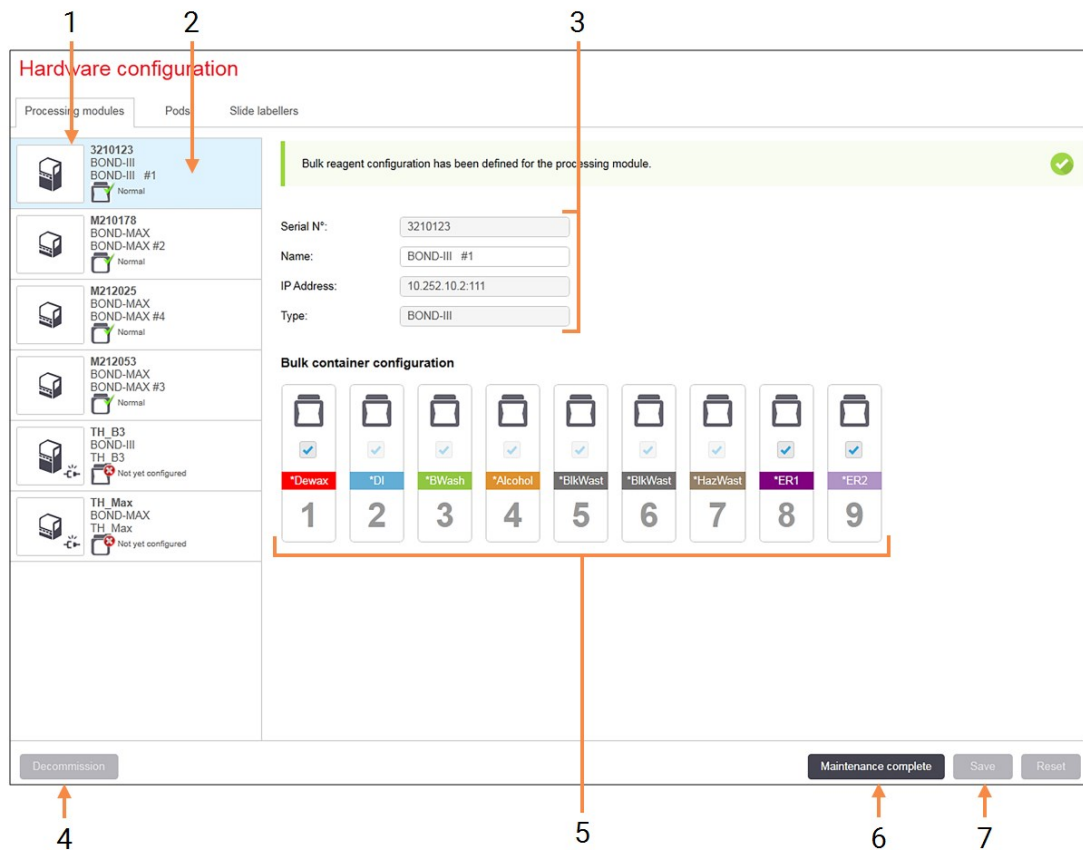
Pozostaje na karcie, nawet po wyłączeniu lub odłączeniu, aż do wycofania z eksploatacji (zob. [10.6.1.2 - Wycofanie modułu przetwarzania z eksploatacji](#)).



Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wszystkie podłączone moduły przetwarzania.	6	<b>Maintenance complete (konserwacja zakończona)</b> Kliknąć, aby zresetować liczniki dni i szkiełek po konserwacji zapobiegawczej – zob. <a href="#">Konserwacji zapobiegawczej</a> w <a href="#">12 - Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)</a> (BOND-III i BOND-MAX).
2	Aktualnie wybrany moduł przetwarzania – jego szczegóły są wyświetlane po prawej stronie ekranu.	7	<b>Save (zapisz)</b> Należy zapisać ustawienia konfiguracji w celu oddania do eksploatacji nowo podłączonego modułu przetwarzania. Aby zapisać ustawienia konfiguracji modułu przetwarzania, należy najpierw upewnić się, że wszystkie jego zespoły barwienia szkiełek są odblokowane.
3	Numer seryjny, nazwa (edytowalna), adres IP i typ urządzenia dla wybranego modułu przetwarzania.		
4	<b>Decommission (wycofanie z eksploatacji)</b> Wycofywanie wybranego modułu przetwarzania z eksploatacji – zob. <a href="#">10.6.1.2 - Wycofanie modułu przetwarzania z eksploatacji</a> poniżej.		
5	Bulk container configuration (konfiguracja pojemników zbiorczych) – można odznaczyć niektóre stacje, jeśli nie będą używane – zob. <a href="#">10.6.1.1 - Wyłączenie zbiorczych pojemników na odczynniki</a> poniżej.		

Postać 10-10: Karta **Processing modules** (moduły przetwarzania) na ekranie **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia)

Ikony obok obrazów modułów przetwarzania w okienku po lewej stronie wskazują różne statusy modułów:

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Moduł przetwarzania nie jest podłączony.		Moduł przetwarzania jest poddawany konserwacji.  Ta ikona jest również wyświetlana (razem z komunikatem błędu), jeśli podłączony moduł przetwarzania jest niezgodny z systemem BOND.
	Trwa inicjalizacja modułu przetwarzania.		Moduł przetwarzania <b>nie</b> otrzymał konfiguracji zbiorczego pojemnika na odczynnik. Kliknąć <b>Save</b> (zapisz), aby przesłać konfigurację.
	Trwa serwisowanie modułu przetwarzania.		Moduł przetwarzania otrzymał konfigurację zbiorczego pojemnika na odczynnik.

#### 10.6.1.1 Wyłączanie zbiorczych pojemników na odczynniki

Laboratoria, które nie przeprowadzają procesów odsłaniania epitopu i/lub odparafinowania w systemie BOND, mogą wyłączyć pojemniki za pośrednictwem oprogramowania i wyjąć odpowiednie pojemniki z urządzenia. Nie ma konieczności utrzymywania pojemników wypełnionych odczynnikami, a inicjalizacja urządzenia jest szybsza, ponieważ przewody płynu podłączone do pojemników nie są zalane. Aby wyłączyć pojemniki zbiorcze, należy odznaczyć je w okienku **Bulk container configuration** (konfiguracja pojemników zbiorczych) i kliknąć **Save** (zapisz). Po wyświetleniu komunikatu należy ponownie uruchomić moduł przetwarzania, aby wprowadzić zmiany. Można wyjąć wyłączone pojemniki z urządzenia lub pozostawić je w odpowiednim miejscu na urządzeniu.


#### 10.6.1.2 Wycofanie modułu przetwarzania z eksploatacji

Jeśli moduł przetwarzania nie jest już potrzebny, należy wycofać go z eksploatacji, aby został usunięty z karty **Processing modules** (moduły przetwarzania). Upewnić się, że moduł przetwarzania jest wyłączony, a następnie wybrać go na karcie **Processing modules** (moduły przetwarzania) i kliknąć **Decommission** (wycofanie z eksploatacji). Jeśli moduł przetwarzania znajduje się nadal w grupie, zostanie on automatycznie usunięty z grupy po jego wycofaniu z eksploatacji.

Aby ponownie przywrócić moduł przetwarzania do eksploatacji, należy podłączyć ponownie jego kabel sieciowy.

## 10.6.2 Pods (grupy)

Grupy to zbiory modułów przetwarzania (i drukarek etykiet do szkiełek), które mogą być kontrolowane przez jednego klienta klinicznego – zob. [3.1 - Architektura systemu](#). Grupę można utworzyć nawet w przypadku instalacji jednostanowiskowych, w których wszystkie moduły przetwarzania są obsługiwane z poziomu kontrolera BOND. Tworzenie i edytowanie grup odbywa się na karcie **Pods** (grupy).

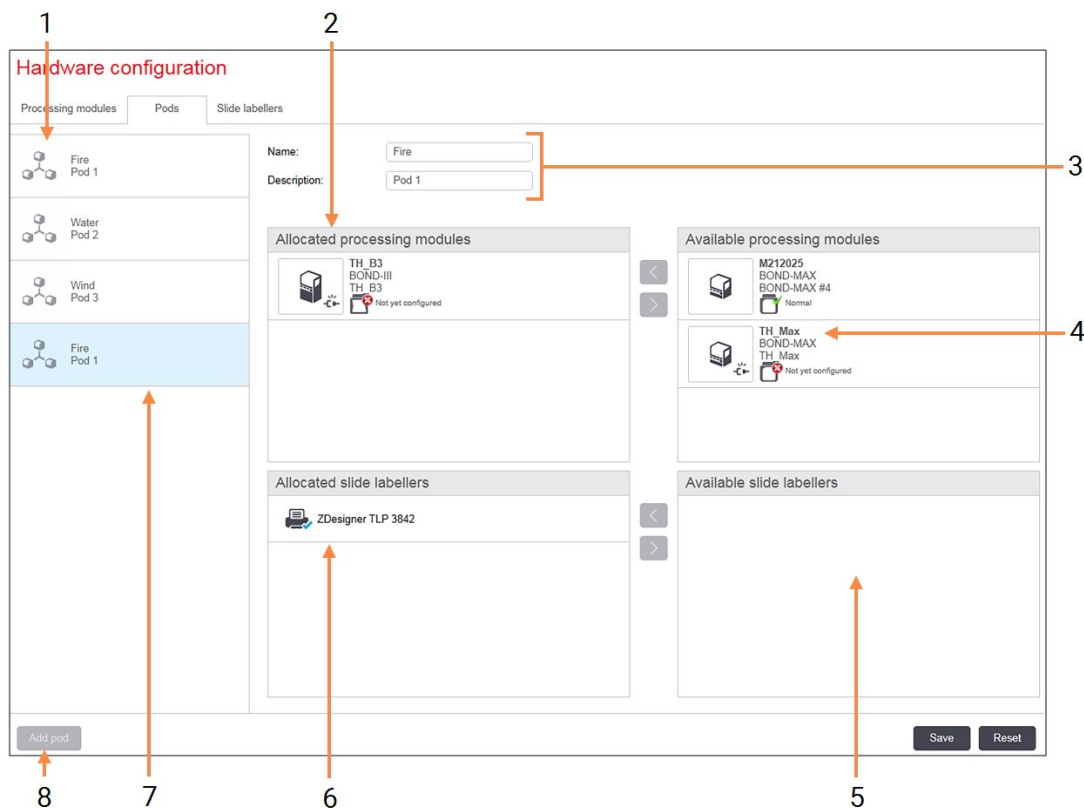


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Lista wszystkich grup.	6	Drukarki etykiet do szkiełek w wybranej grupie. Domyślna drukarka jest oznaczona niebieskim symbolem zaznaczenia – zob. <a href="#">10.6.2.1 - Tworzenie nowej grupy</a> poniżej.
2	Moduły przetwarzania w wybranej grupie. Ta sama kolejność jest stosowana w kliencie klinicznym – zob. <a href="#">10.6.2.1 - Tworzenie nowej grupy</a> poniżej.	7	Aktualnie wybrana grupa – jej szczegóły są wyświetlane po prawej stronie ekranu.
3	Nazwa i opis (edytowalne) wybranej grupy.	8	<b>Add pod (dodaj grupę)</b> Kliknąć, aby skonfigurować nową grupę – zob. <a href="#">10.6.2.1 - Tworzenie nowej grupy</a> poniżej.
4	Wszystkie moduły przetwarzania, które znajdują się w grupie.		<b>Delete (usuń)</b> Kliknąć prawym przyciskiem myszy pustą grupę i wybrać Delete (usuń), aby ją usunąć.
5	Wszystkie drukarki etykiet do szkiełek, które nie znajdują się w grupach.		

Postać 10-11: Karta **Pods** (grupy) na ekranie **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia)

Aby moduły przetwarzania mogły zostać włączone do grupy, należy je skonfigurować na karcie **Processing modules** (moduły przetwarzania) (zob. [10.6.1 - Processing Modules \(moduły przetwarzania\)](#)). Aby drukarki etykiet do szkiełek mogły zostać włączone do grupy, należy je skonfigurować na karcie **Slide labelers** (drukarki etykiet do szkiełek) (zob. [10.6.3 - Slide Labelers \(drukarki etykiet do szkiełek\)](#)).

### 10.6.2.1 Tworzenie nowej grupy

1. Kliknąć **Add pod** (dodaj grupę).
2. Wprowadzić unikatową nazwę grupy i opcjonalnie opis.
3. Wybrać moduły przetwarzania z okienka **Available processing modules** (dostępne moduły

przetwarzania) w prawym górnym rogu i kliknąć strzałkę w lewo , aby dodać je do okienka **Allocated processing modules** (przydzielone moduły przetwarzania) w lewym górnym rogu.

W przypadku dodawania wielu urządzeń należy je dodać w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane karty w kliencie klinicznym, np. jeśli wybrano urządzenie A jako pierwsze i urządzenie B jako drugie, A pojawi się nad B w okienku i na kartach **System status** (stan systemu) w klientach połączonych z grupą. Aby zmienić kolejność modułów przetwarzania, należy usunąć je za pomocą przycisku

strzałki w prawo  i ustawić we właściwej kolejności.

4. Wybrać jedną lub więcej drukarek etykiet do szkiełek z okienka **Available slide labelers** (dostępne drukarki etykiet do szkiełek) w prawym dolnym rogu i dodać do okienka **Allocated slide labelers** (przydzielone drukarki etykiet do szkiełek) w lewym dolnym rogu.


W przypadku dodania kilku drukarek można je wybrać podczas drukowania szkiełek. Ustawić domyślną drukarkę, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję **Set as default printer** (ustaw jako drukarkę domyślną). Drukarka domyślna oznaczona jest niebieskim symbolem zaznaczenia.

5. Kliknąć **Save** (zapisz).

Aby usunąć grupę, należy usunąć wszystkie moduły przetwarzania i drukarki, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na lewym okienku i wybrać **Delete** (usuń).

### 10.6.3 Slide Labelers (drukarki etykiet do szkiełek)

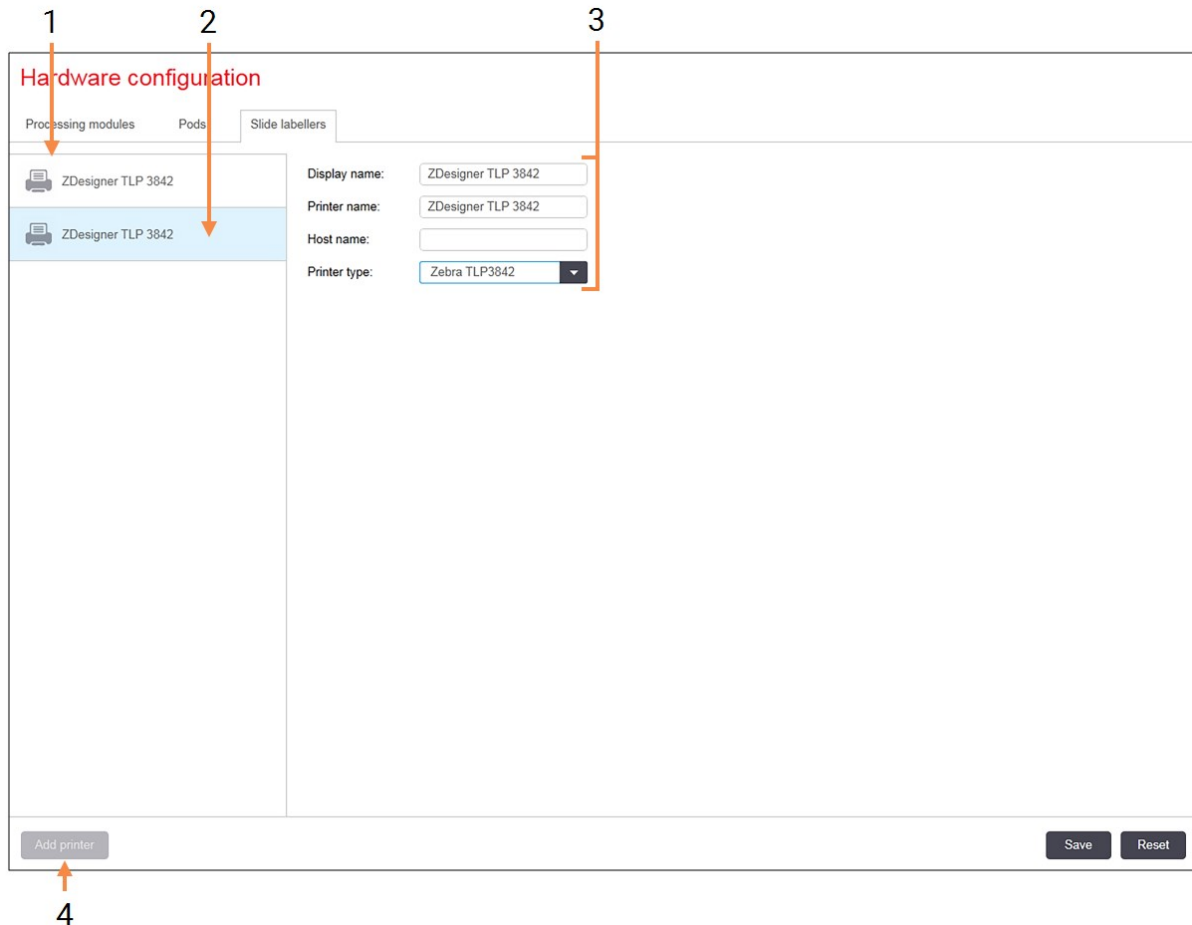

Drukarki etykiet do szkiełek używane przez system BOND muszą być zlokalizowane, zidentyfikowane i aktywowane w kliencie administracyjnym na ekranie **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia) na karcie **Slide labelers** (drukarki etykiet do szkiełek). Dzięki temu można je łączyć w grupy (zob. [10.6.2 - Pods \(grupy\)](#)).



Nr	Opis	Nr	Opis
1	Lista wszystkich drukarek etykiet do szkiełek.	3	Szczegóły drukarki etykiet do szkiełek – zob. <a href="#">10.6.3.1 - Szczegóły drukarki etykiet do szkiełek</a> poniżej.
2	Aktualnie wybrana drukarka etykiet do szkiełek – jej szczegóły są wyświetlane po prawej stronie ekranu.	4	<b>Add printer (dodaj drukarkę)</b> Kliknąć, aby dodać nową drukarkę etykiet do szkiełek – należy ją skonfigurować po prawej stronie ekranu.

Postać 10-12: Karta **Slide labelers** (drukarki etykiet do szkiełek) na ekranie **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia)

Aby nowo podłączona drukarka etykiet do szkiełek mogła zostać włączona do grupy, należy kliknąć **Add printer** (dodaj drukarkę), a następnie wprowadzić szczegóły drukarki po prawej stronie ekranu.


-  Nie wszystkie instalacje mają grupy. Jeśli nie ma grup, drukarką domyślną jest pierwsza drukarka na liście.
-  W przypadku wymiany drukarki etykiet do szkiełek nie trzeba dodawać nowej drukarki – można wpisać dane nowej drukarki w miejsce danych poprzedniej drukarki.

Aby usunąć drukarkę z listy, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Delete** (usuń).


### 10.6.3.1 Szczegóły drukarki etykiet do szkiełek


System BOND wymaga następujących danych dla każdej drukarki etykiet do szkiełek:

- **Display name** (nazwa wyświetlana): nazwa drukarki etykiet, która będzie wyświetlana w oprogramowaniu BOND
- **Printer name** (nazwa drukarki): nazwa drukarki używana przez Windows

-  Nazwa drukarki w instalacjach BOND-ADVANCE to w rzeczywistości **Share name** (nazwa udostępniona) wyświetlana w systemie Windows w oknie dialogowym **Printers and Faxes** (drukarki i fakсы).

- **Host name** (nazwa hosta): pozostawić puste, chyba że jest to drukarka **Zebra** (na przykład **ZDesigner TLP 3842**) w instalacji BOND-ADVANCE; wówczas należy wprowadzić **Computer name** (nazwa komputera) dla terminala, do którego podłączona jest drukarka etykiet do szkiełek.

-  Nazwę komputera **Computer name** można znaleźć w systemie Windows w oknie dialogowym **System** (zob. [Postać 10-13](#)).

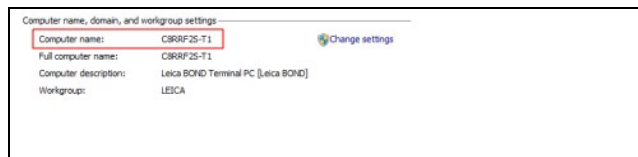

Postać 10-13: Nazwa komputera w oknie dialogowym System w systemie Windows

- **Printer type** (typ drukarki): model drukarki (na przykład **ZDesigner TLP 3842**)



### 10.6.3.2 Drukowanie etykiet testowych

Aby sprawdzić wyrównanie wydruku:

1. Przejdź do ekranu **Labels** (etykiety) w kliencie administracyjnym.
2. Wybrać etykietę w panelu po lewej stronie i kliknąć **Print** (drukuj).

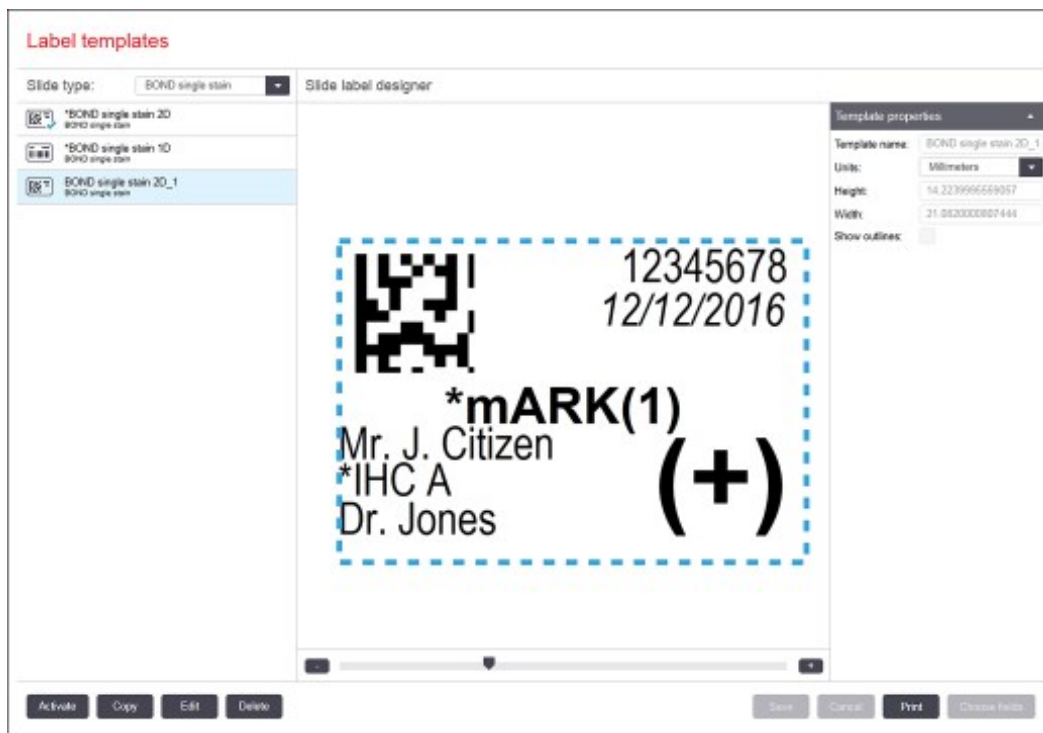


Figure 10-14: Drukowanie etykiety testowej

3. W okien dialogowym **Select a Printer** (wybierz drukarkę) wybrać odpowiednią drukarkę i kliknąć **Print** (drukuj).
4. Powtórzyć krok 3 od trzech do pięciu razy. Upewnić się, że wszystkie znaki są wyraźnie i dokładnie wydrukowane na etykiecie.
5. Jeśli położenie obrazu na etykiecie jest nieprawidłowe, zob. [Dostosowanie parametrów drukarki Zebra on page 235](#) lub [Dostosowanie parametrów drukarki Cognitive on page 239](#).

#### **Dostosowanie parametrów drukarki Zebra**

- Poniższa procedura dotyczy obu typów drukarki Zebra: TLP 3842 lub GX430t. Istnieją pewne różnice, które opisano w odpowiednich ustawieniach.
- W przypadku instalacji BOND-ADVANCE należy wykonać poniższe czynności na terminalu BOND-ADVANCE.

## 10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknąć przycisk **Start** i wybrać **Devices and Printers** (urządzenia i drukarki).
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki (na przykład **ZDesigner TLP 3842**) i wybrać **Printer Properties** (właściwości drukarki).

System wyświetli okno dialogowe Printer Properties (właściwości drukarki), jak pokazano na [Figure 10-15](#).

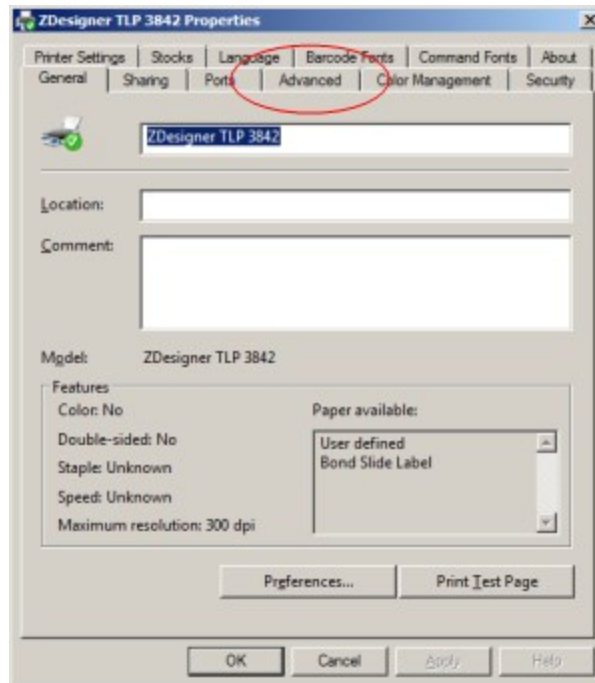


Figure 10-15: Właściwości drukarki

3. Wybrać kartę **Advanced** (zaawansowane).

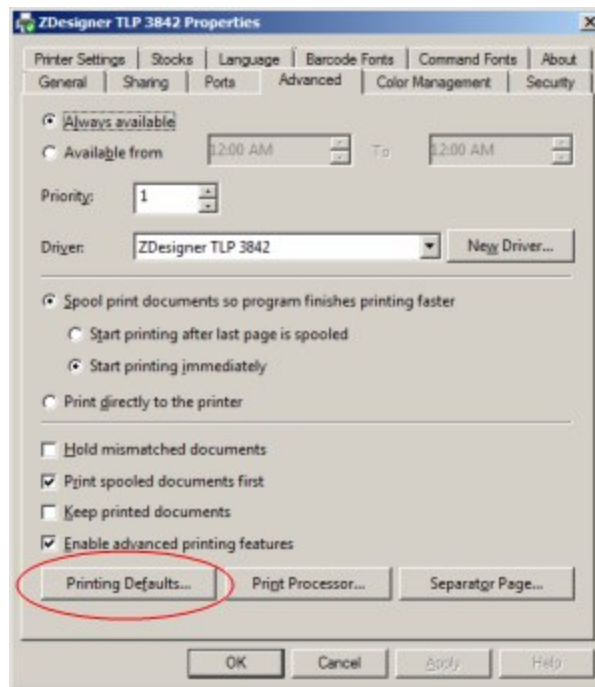


Figure 10-16: Właściwości drukarki – karta Advanced (zaawansowane)

4. Kliknąć przycisk **Printing Defaults...** (domyślne ustawienia drukowania).

System wyświetli okno dialogowe Printing Defaults (domyślne ustawienia drukowania), jak pokazano na [Figure 10-17](#).

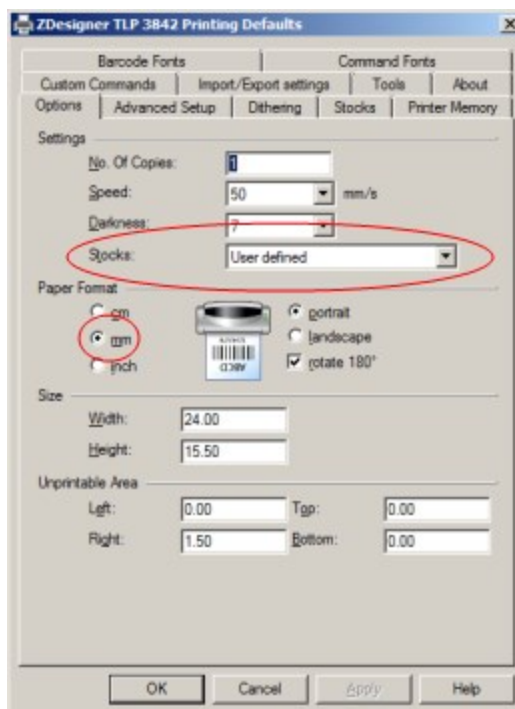


Figure 10-17: Domyślne ustawienia drukowania



W niniejszym dokumencie ustawienia drukarki podawane są w milimetrach. Dlatego też należy ustawić format papieru (opcja Paper Format) na mm.

5. Wybrać „BOND Slide Label” z listy rozwijanej Stocks (zasoby).
6. Wybrać kartę **Stocks** (zasoby).


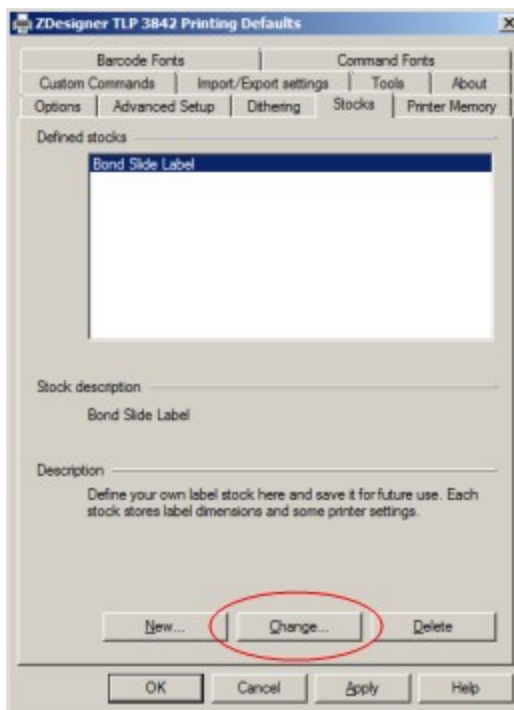


Figure 10-18: Domyślne ustawienia drukowania – karta Stocks (zasoby)

7. Kliknąć przycisk **Change...** (zmień).  
System wyświetli okno **Define Stock** (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na [Postać 10-19](#).  
Przed zmianą ustawień zaleca się przywrócenie ustawień domyślnych drukarki, jak pokazano w poniższej tabeli, a następnie wydrukowanie kilku etykiet testowych.


	<b>TLP 3842</b>	<b>GX430t</b>
Szerokość etykiety	24.00 mm	40.00 mm
Wysokość etykiety	15.50 mm	15.00 mm
Obszar bez druku – strona lewa	0.00 mm	4.50 mm
Obszar bez druku – strona prawa	1.50 mm	0.00 mm

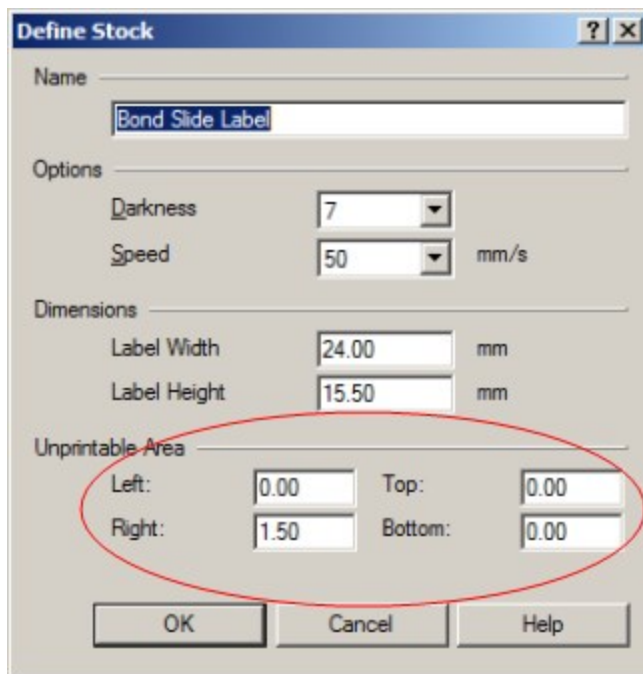

Postać 10-19: Okno dialogowe Define Stock (zdefiniuj zasoby)

- Jeśli lewa krawędź jest obcięta, nieznacznie zmniejszyć wartość **Right** (strona prawa) w części **Unprintable Area** (obszar bez druku), na przykład z 1.50 mm do 1.00 mm.
  - Jeśli prawa krawędź jest obcięta, nieznacznie zwiększyć wartość **Right** (strona prawa) w części **Unprintable Area** (obszar bez druku), na przykład z 1.50 mm do 2.00 mm.
8. Kliknąć **OK**.
  9. Należy powtarzać procedurę drukowania i dostosowania parametrów etykiety aż do momentu, gdy etykieta będzie akceptowalna (brak obciętego tekstu).

**i** Może pojawić się komunikat o błędzie **Stock name already used by system form database** (nazwa zasobów jest już używana przez systemową bazę danych) po kliknięciu **OK**. W tym przypadku należy zmodyfikować dane w polu **Name** (nazwa) w oknie dialogowym **Define Stock** (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na [Postać 10-20](#), a następnie kliknąć **OK**.

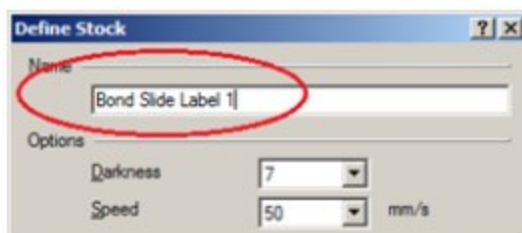

Postać 10-20: Zmiana nazwy zasobów etykiet

### Dostosowanie parametrów drukarki Cognitive

**i** W przypadku instalacji BOND-ADVANCE należy zalogować się do kontrolera BOND-ADVANCE jako BONDDashboard. Jeśli aktualnie wyświetlany jest pulpit Dashboard, naciśnięcie **Alt+F4**, aby go zamknąć.

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknąć przycisk **Start** i wybrać **Devices and Printers** (urządzenia i drukarki).
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki (na przykład **Cognitive Terminal 1**) i wybrać **Printer Properties** (właściwości drukarki).



Figure 10-21: Wybieranie właściwości drukarki

**i** Nie wybierać opcji **Printing Preferences** (preferencje drukowania), okna dialogowe są podobne, ale ustawienia nie aktualizują się prawidłowo.

System wyświetli okno dialogowe **Cognitive Printer Properties** (właściwości drukarki Cognitive), jak pokazano na [Figure 10-22](#).

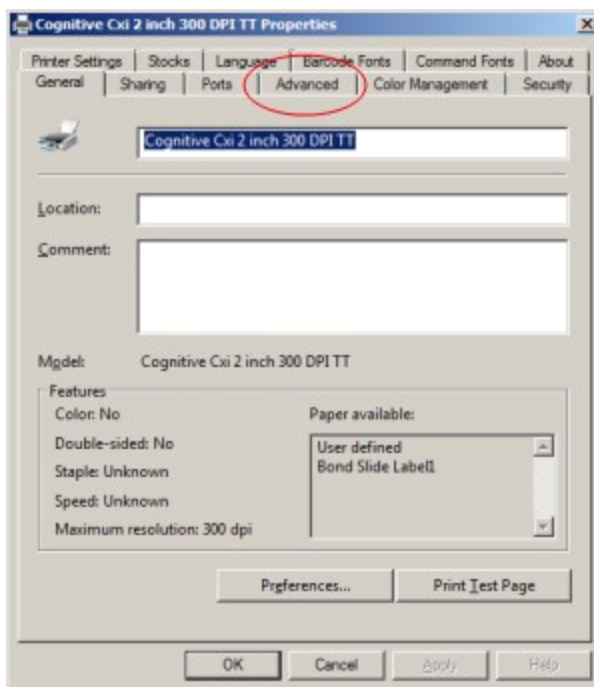


Figure 10-22: Właściwości drukarki Cognitive

3. Wybrać kartę **Advanced** (zaawansowane).

System wyświetli kartę **Advanced** (zaawansowane), jak pokazano na [Figure 10-23](#).

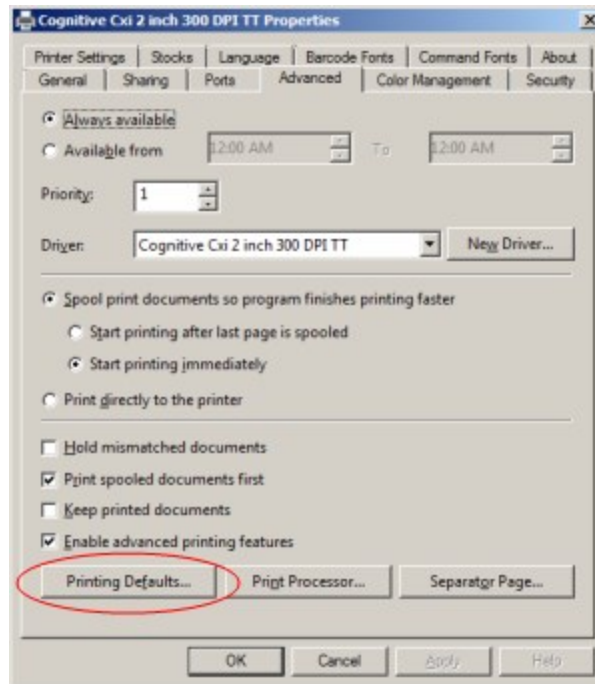


Figure 10-23: Karta Advanced (zaawansowane)

4. Kliknąć przycisk **Printing Defaults...** (domyślne ustawienia drukowania).

System wyświetli okno dialogowe **Printing Defaults** (domyślne ustawienia drukowania), jak pokazano na [Figure 10-24](#).

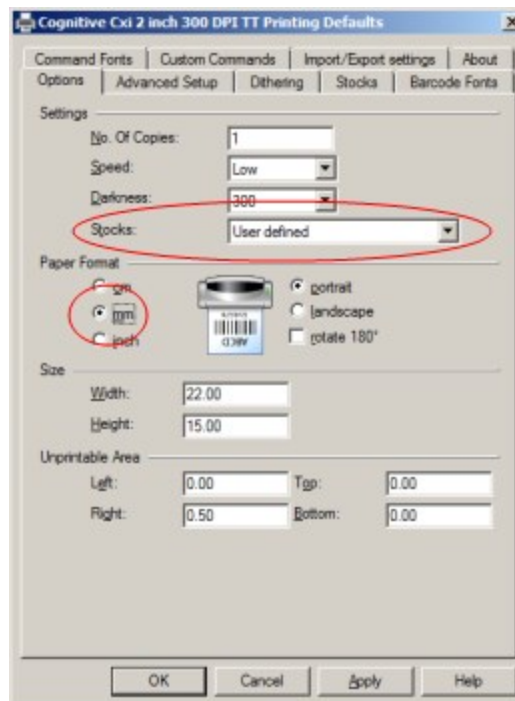


Figure 10-24: Okno dialogowe Printing Defaults (domyślne ustawienia drukowania)



**i** W niniejszym dokumencie ustawienia drukarki podawane są w milimetrach. Dlatego też należy ustawić format papieru (opcja Paper Format) na mm.

- Wybrać „BOND Slide Label” z listy rozwijanej Stocks (zasoby).
- Wybrać kartę **Stocks** (zasoby).

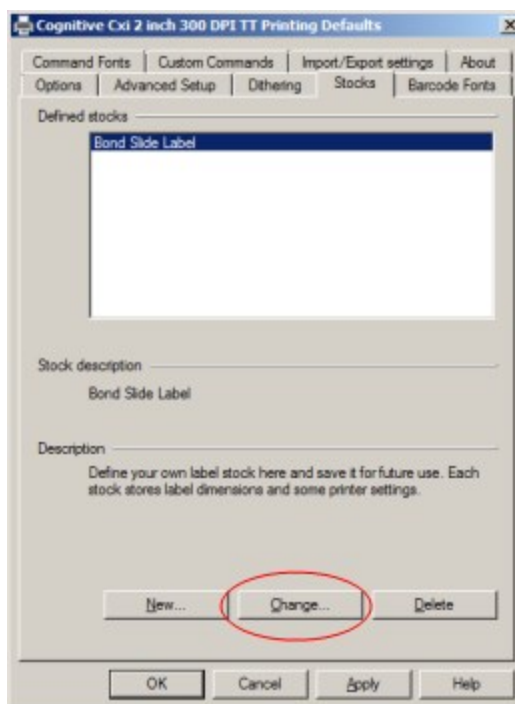


Figure 10-25: Domyślne ustawienia drukowania – karta Stocks (zasoby)

- Kliknąć przycisk **Change...** (zmień). System wyświetli okno **Define Stock** (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na [Postać 10-19](#).

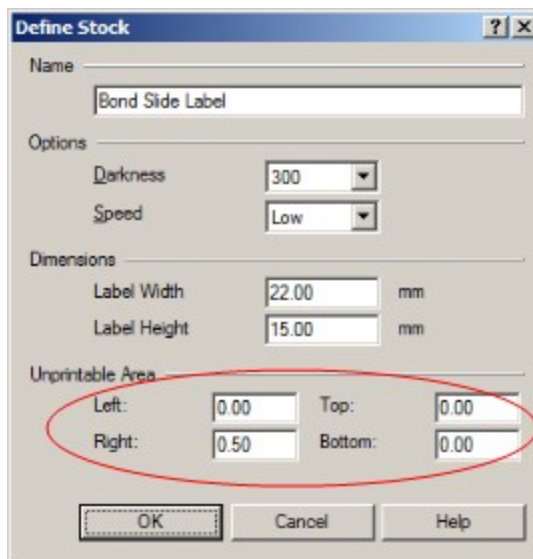


Figure 10-26: Okno dialogowe Define Stock (zdefiniuj zasoby)



- Jeśli lewa krawędź jest obcięta, nieznacznie zmniejszyć wartość **Right** (strona prawa) w części **Unprintable Area** (obszar bez druku), na przykład z 0.50 mm do 0.30 mm.
- Jeśli prawa krawędź jest obcięta, nieznacznie zwiększyć wartość **Right** (strona prawa) w części **Unprintable Area** (obszar bez druku), na przykład z 0.50 mm do 0.70 mm.
- Jeśli górna lub dolna krawędź jest obcięta, zob. [Dostosowanie pozycji etykiety w pionie na drukarce Cognitive Cxi on page 243](#).

8. Kliknąć **OK**.

**i** Może pojawić się komunikat o błędzie **Stock name already used by system form database** (nazwa zasobów jest już używana przez systemową bazę danych) po kliknięciu **OK**. W tym przypadku należy zmodyfikować dane w polu **Name** (nazwa) w oknie dialogowym **Define Stock** (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na [Figure 10-27](#), a następnie kliknąć **OK**.

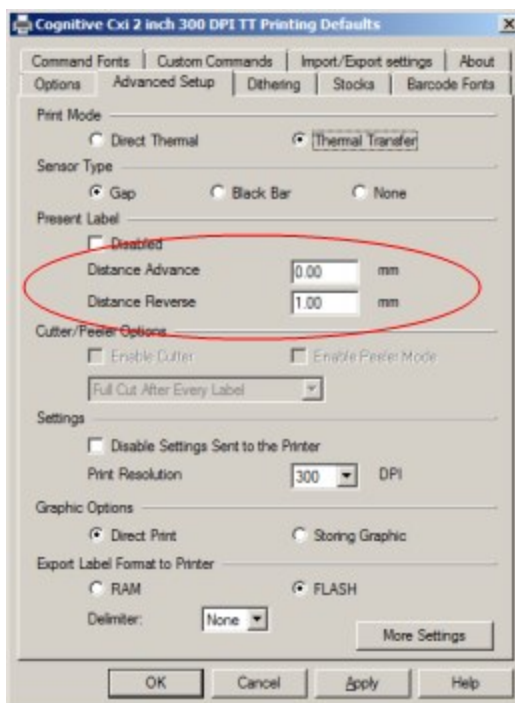


Figure 10-27: Zmiana nazwy zasobów etykiet

9. Wydrukować etykietę, aby sprawdzić rezultat. Należy powtarzać procedurę aż do momentu, gdy etykieta będzie akceptowalna (brak obciętego tekstu).


### Dostosowanie pozycji etykiety w pionie na drukarce Cognitive Cxi

Jeśli etykieta jest zbyt wysoko lub zbyt nisko, należy wybrać kartę **Advanced Setup** (konfiguracja zaawansowana) w oknie dialogowym **Printing Defaults** (domyślne ustawienia drukowania), jak pokazano na [Postać 10-28](#).



Postać 10-28: Karta Advanced Setup (konfiguracja zaawansowana)

- Jeśli górna krawędź jest obcięta, nieznacznie zwiększyć wartość **Distance Advance** (odległość z przodu) w części **Present Label** (obecna etykieta), na przykład z 0.00 mm do 1.00 mm.
- Jeśli dolna krawędź jest obcięta, nieznacznie zwiększyć wartość **Distance Reverse** (odległość z tyłu) w części **Present Label** (obecna etykieta), na przykład z 0.00 mm do 1.00 mm.

 Zmiany należy wprowadzić tylko w jednym ustawieniu. Jeśli w polu **Distance Advance** (odległość z przodu) ustawiono już pewną wartość, a dolna krawędź jest obcięta, należy zmniejszyć wartość **Distance Advance** (odległość z przodu) zamiast zwiększania wartości **Distance Reverse** (odległość z tyłu). W jednym ustawieniu musi pozostać wartość zero, a wartość w drugim ustawieniu kontroluje pozycję.

10. Kliknąć **OK**.

11. Wydrukować etykietę, aby sprawdzić rezultat. Należy powtarzać procedurę aż do momentu, gdy etykieta będzie akceptowalna (brak obciętego tekstu).

# 11. Pakiet integracji LIS (kontroler BOND )

Opcjonalnie pakiet integracji LIS BOND (LIS-ip) umożliwia połączenie systemu BOND z dowolnym zgodnym systemem informatycznym laboratorium (Laboratory Information System, LIS). LIS-ip przekazuje informacje dotyczące przypadków i szkiełek z LIS do systemu BOND, a system BOND zwraca informacje o przetwarzaniu przez LIS-ip do LIS.

LIS-ip jest wysoce konfigurowalny i może współpracować z wieloma różnymi typami LIS i przebiegami pracy laboratorium. LIS-ip można skonfigurować tak, aby zapewnić bezproblemową integrację pomiędzy LIS a systemem BOND, umożliwiając automatyczne rozpoznawanie szkiełek LIS, co eliminuje konieczność ponownego etykietowania szkiełek. Ogólny przegląd dostępnych przebiegów pracy znajduje się w części [Przebieg pracy \(Section 11.8 on page 255\)](#).

Leica Biosystems organizuje kompleksowe szkolenia dotyczące poszczególnych instalacji w danej placówce.

Informacje dotyczące BOND LIS-ip znajdują się w następujących rozdziałach:

- Terminy związane z działaniem LIS-ip  
Zob. [11.1 - Terminologia LIS](#)
- Szczegóły dotyczące dodatkowych funkcji oprogramowania  
Zob. [11.2 - Dodatkowe funkcje oprogramowania](#)
- Informacje dotyczące podłączania i konfiguracji LIS  
Zob. [11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS](#)
- Opis wskazań błędów LIS i sposobu postępowania  
Zob. [11.4 - Powiadomienia LIS](#)
- Lista referencyjna danych przypadków i szkiełek  
Zob. [11.5 - Wymagania dotyczące danych przypadków i szkiełek](#)
- Opis danych dotyczących statusu szkiełek, które BOND LIS-ip może zaraportować do LIS  
Zob. [11.6 - Przesyłanie danych dotyczących szkiełek z powrotem do LIS](#)
- Wymagania dotyczące etykiet szkiełek  
Zob. [11.7 - Etykiety szkiełek](#)
- Przegląd typowych wdrożeń LIS  
Zob. [11.8 - Przebieg pracy](#).

## 11.1 Terminologia LIS

W celu opisanego funkcjonalności systemu LIS i rozróżnienia pomiędzy zwykłymi elementami systemu BOND a elementami LIS wymagane jest użycie kilku nowych terminów. Terminy te opisano na poniższej liście.

- LIS – Laboratory Information System; oprogramowanie, które zarządza informacjami związanymi z pracą laboratorium.
- LIS-ip – pakiet integracji LIS BOND, opcjonalny dodatek umożliwiający współpracę systemu BOND z LIS.
- Szkiełko LIS – szkiełko utworzone przez LIS i przesłane do systemu BOND w celu przetwarzania.
- Przypadek LIS – przypadek utworzony przez LIS i przesłany do systemu BOND.
- Etykieta szkiełka z automatycznym ID – etykieta szkiełka, która może zostać automatycznie rozpoznana przez system BOND. Tego rodzaju etykiety mogą być drukowane przez system BOND lub LIS, o ile używany jest rozpoznawalny format kodu kreskowego. Zob. [11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS](#).
- Etykieta szkiełka z ręcznym ID – etykieta szkiełka, która nie może zostać automatycznie rozpoznana przez system BOND.
- Etykieta szkiełka LIS – etykieta szkiełka z drukarki podłączonej do LIS. Etykieta szkiełka LIS zawiera kod kreskowy LIS i wszelkie inne informacje skonfigurowane dla tej etykiety w systemie LIS.
- Etykieta szkiełka BOND-LIS – etykieta szkiełka utworzonego w LIS, ale wydrukowana na drukarce podłączonej do systemu BOND. Etykieta BOND-LIS wykorzystuje konfigurację etykiety szkiełka BOND LIS, którą można edytować przy użyciu oprogramowania BOND.
- Numer dostępu – powszechnie używany termin LIS dla numeru lub innego ID identyfikującego konkretny przypadek. Numer dostępu jest równoważny z „ID przypadku” w systemie BOND.
- Dane pacjenta – dane pacjenta, które tworzą „przypadek” w systemie BOND.
- Dane demograficzne – powszechnie używany termin LIS dla danych pacjenta lub danych przypadku.
- Kod kreskowy LIS – kod kreskowy przypisany przez LIS, który jednoznacznie identyfikuje każde szkiełko LIS.

## 11.2 Dodatkowe funkcje oprogramowania

Systemy BOND wykorzystujące systemu LIS mają dodatkowe funkcje oprogramowania, których nie ma w standardowej wersji. BOND Systemy LIS-ip zachowują wszystkie funkcje i właściwości standardowego oprogramowania BOND.

Zob.

- [11.2.1 - Ikona statusu LIS](#)
- [11.2.2 - Przypadki LIS](#)
- [11.2.3 - Szkiełka LIS](#)
- [11.2.4 - Nazwy publiczne markerów](#)
- [11.2.5 - Szkiełka priorytetowe](#)
- [11.2.6 - Pola danych szkiełek LIS](#)
- [11.7 - Etykiety szkiełek](#)

### 11.2.1 Ikona statusu LIS



Postać 11-1: Ikona statusu LIS w prawym górnym rogu ekranu oprogramowania BOND

Oprogramowanie BOND z LIS-ip zawiera ikonę statusu LIS z prawej strony standardowego paska funkcji. Pokazuje następujące elementy:

- Status połączenia LIS (zob. [11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS](#))
- Wskazanie błędów LIS (zob. [11.4 - Powiadomienia LIS](#))

### 11.2.2 Przypadki LIS

Przypadki LIS to przypadki utworzone w LIS, a następnie przesłane do systemu BOND. Przypadki BOND to przypadki tworzone w systemie BOND.


- Przypadki LIS zawierają te same pola właściwości co przypadki BOND, ale po wysłaniu przypadku do systemu BOND nie można edytować żadnych informacji.
- System BOND automatycznie przydziela unikalny numer przypadku do każdego przypadku LIS.
- Numer dostępu lub ID przypadku LIS staje się ID przypadku w systemie BOND.
- Jeśli ID przypadku jest taki sam, jak ID istniejącego przypadku BOND, nowy przypadek LIS zostanie odrzucony. Należy zmienić ID przypadku w systemie LIS.
- Jeśli ID przypadku i imię i nazwisko pacjenta nowego przypadku LIS są takie same, jak dane aktywnego przypadku LIS znajdujące się już na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek), automatycznie używany jest istniejący przypadek. Szkiełka w „nowym” przypadku są dodawane do szkiełek istniejącego przypadku. Jeśli ID przypadku są takie same, ale imiona i nazwiska pacjentów są różne, nowy przypadek zostanie odrzucony.
- Jeśli ID przypadku i imię i nazwisko pacjenta dla przypadku LIS są takie same, jak dane wygasłego lub usuniętego przypadku LIS w systemie BOND, istniejący przypadek jest przywracany lub nowy przypadek jest odrzucany, w zależności od wybranych ustawień na ekranie LIS klienta administracyjnego (zob. [Duplicate Case ID \(zdublikowane ID przypadku\) on page 211](#)).
- Szkiełka dodane do przypadku LIS za pomocą oprogramowania BOND są tworzone jako szkiełka BOND.

- Przypadki LIS mają ten sam domyślny protokół przygotowania i objętość dozowania co przypadki BOND, zgodnie z ustawieniami w kliencie administracyjnym (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)).

### 11.2.3 Szkiełka LIS

Szkiełka LIS to szkiełka utworzone w LIS, a następnie przesłane do systemu BOND. Szkiełka BOND to szkiełka utworzone w systemie BOND w przypadku BOND lub w przypadku LIS.

Szkiełka LIS można zidentyfikować na liście szkiełek według koloru etykiety: Szkiełka LIS mają szarą etykietę.

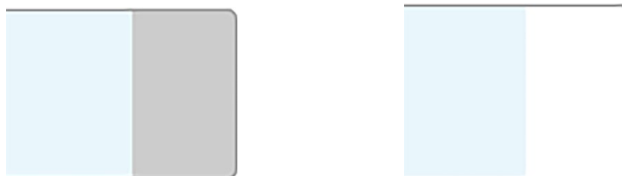

Postać 11-2: Szkiełko LIS (po lewej) i szkiełko BOND do pojedynczego barwienia (po prawej)

Następujące punkty dotyczą szkiełek LIS:

- Etykiety wydrukowane z systemu LIS zazwyczaj zawierają kod kreskowy. Jeśli kod kreskowy jest w jednym z sześciu formatów obsługiwanych przez system BOND i system BOND został skonfigurowany do odczytu tego formatu, wówczas system BOND może zidentyfikować szkiełko po załadowaniu. Zob. [11.3 - Podłączanie i inicjalizacja LIS](#).
- Etykiety wydrukowane z systemu BOND dla szkiełek LIS używają konfiguracji etykiety szkiełka BOND LIS. Zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#).
- Szkiełka LIS mogą zawierać dodatkowe pola dotyczące systemu LIS. Zob. [11.2.6 - Pola danych szkiełek LIS](#).
- Właściwości szkiełek pochodzących z systemu LIS nie mogą być edytowane za pomocą oprogramowania BOND.
- Gdy do kopiowania szkiełka LIS wykorzystywane jest oprogramowanie BOND, kopia jest tworzona jako szkiełka BOND z konfiguracją etykiety szkiełka BOND. Wszystkie pola dotyczące systemu LIS są usuwane i od tej pory można edytować wszystkie pola.

### 11.2.4 Nazwy publiczne markerów

Nazwy publiczne markerów (przeciwiał pierwszorzędowych i sond) zapewniają powiązanie pomiędzy markerami określonymi przez LIS a tymi zarejestrowanymi w systemie BOND. Gdy system LIS określa marker do testu, system BOND wykorzystuje odczynnik z identyczną nazwą publiczną markera dla tego testu. System BOND odrzuci test określony w systemie LIS w przypadku braku nazwy publicznej odpowiadającej nazwie markera LIS.

Nazwy publiczne markerów są określane w polu **Public name** (nazwa publiczna) w oknie dialogowym **Edit reagent properties** (edytuj właściwości odczynnika) (zob. [8.2 - Ekran konfiguracji odczynników](#)). To pole staje się widoczne dopiero po zainstalowaniu LIS-ip.

Każda nazwa publiczna musi być unikatowa. Nazwy publiczne można zamieniać pomiędzy odczynnikiem BOND w dowolnym momencie. Taka zmiana nie ma wpływu na szkiełka, które zostały już utworzone.

## 11.2.5 Szkiełka priorytetowe

W systemie LIS można określić szkiełka priorytetowe wymagające pilnego przetworzenia. Każdy przypadek zawierający szkiełko priorytetowe jest oznaczony czerwonym paskiem na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek).

Case ID	Patient name	Doctor name	Slides
LS0012 - 45216	Shady, Albert	Joseph	1
20130416-ISHRefine	Benjamin Hightower	Kevin Pannell	10
20130416-IHC	Fannie Hurley	Arthur Josey	10

Postać 11-3: Przypadek ze szkiełkami priorytetowymi zaznaczony na czerwono na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek)

**i** Obecnie priorytetowy przypadek LIS jest dodawany na dole listy. Taki przypadek jest wyświetlany u góry listy dopiero w kolejnych sesjach klienta klinicznego.

Szkiełka priorytetowe oznaczone są czerwoną literą „P”.



Postać 11-4: Priorytetowe szkiełko LIS wyświetlające się na ekranie **Slide setup** (konfiguracja szkiełek)

## 11.2.6 Pola danych szkiełek LIS





Oprócz standardowych właściwości szkiełek BOND LIS-ip ma siedem konfigurowalnych pól danych, w których mogą wyświetlać się wybrane informacje z systemu LIS. Podstawowa łączność jest konfigurowana przez serwisanta Leica Biosystems podczas instalacji, jednak gdy zostanie to już wykonane, użytkownicy mogą zdecydować, czy wyświetlać pola, czy nie, a także mogą ustawić nazwę dla każdego pola – zob. [Pola danych szkiełek LIS on page 211](#).

Pola są wyświetlane na specjalnej karcie **LIS** w oknie dialogowym **Slide properties** (właściwości szkiełka) i można je również wydrukować na etykietach szkiełek (zob. [10.3 - Labels \(etykiety\)](#)). Wykorzystywane są wyłącznie w celach raportowania i nie mają wpływu na działanie urządzenia.

## 11.3 Podłączanie i inicjalizacja LIS

Każdy moduł BOND LIS-ip musi być zainstalowany przez autoryzowanego przedstawiciela Leica Biosystems, który skonfiguruje pracę zgodnie z indywidualnymi wymaganiami laboratorium.

System BOND można skonfigurować tak, aby odczytywał kody kreskowe w następujących formatach:

Kody kreskowe 1D	Kody kreskowe 2D
Kod 128 	QR 
	Aztec 
	DataMatrix 

Po zainstalowaniu modułu LIS w prawym górnym rogu ekranu oprogramowania BOND pojawi się ikona LIS wskazująca status połączenia ([Postać 11-5](#))



Postać 11-5: LIS niepodłączony (po lewej) i podłączony (po prawej)



## 11.4 Powiadomienia LIS

Oprogramowanie BOND wskazuje błędy połączenia z LIS lub błędy dotyczące danych poprzez wyświetlenie ikony statusu LIS w prawym górnym rogu ekranu oprogramowania BOND (zob. [11.2.1 - Ikona statusu LIS](#)). Jeśli istnieją jakieś oczekujące powiadomienia LIS, wyświetlany jest licznik oczekujących powiadomień. Gdy pojawi się nowe powiadomienie, licznik będzie migać przez krótki czas.



Postać 11-6: Ikona statusu LIS

Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę statusu i wybrać **Show LIS report** (pokaż raport LIS), aby otworzyć okno dialogowe **LIS service events** (zdarzenia serwisowe LIS). W oknie dialogowym wyświetlane są błędy i informacje o szkiełkach, które nie zostały pomyślnie przeniesione. Podana jest również przyczyna błędu. Typowe błędy LIS obejmują brakujące dane, konflikty danych (np. ten sam numer dostępu użyty dla różnych przypadków) lub sytuacje, w których nazwa publiczna markera nie jest zarejestrowana w systemie BOND (zob. [11.2.4 - Nazwy publiczne markerów](#)).

LIS service events					
ID	Date	Event N°	Details	Message	
1...	24-Jan-17 2:33...	7012	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP Marker2 ID Tissue type test Message ID 002.1 Barcode 88820	Unable to add LIS slide - Barcode already used	Acknowledge
1...	24-Jan-17 2:34...	7007	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP Marker2 ID Tissue type tesst Message ID 002.1 Barcode 88820	Cannot map tissue type	Acknowledge
1...	24-Jan-17 2:35...	7006	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP	Marker does not exist	Acknowledge


Close

Postać 11-7: Okno dialogowe **LIS service events** (zdarzenia serwisowe LIS)

W zależności od konfiguracji LIS możliwe jest skorygowanie błędów i ponowne przesłanie przypadku lub szkiełka. Jeśli LIS nie jest w stanie ponownie wysłać danych, można utworzyć przypadek lub szkiełka bezpośrednio za pomocą oprogramowania BOND.


Po przeczytaniu każdego komunikatu o błędzie należy kliknąć odpowiedni przycisk **Acknowledge** (potwierdź), aby usunąć powiadomienie z okna dialogowego.

Gdy wszystkie komunikaty o błędach zostaną usunięte z okna dialogowego, licznik powiadomień zniknie z ekranu.

-  W razie potrzeby nadal można przeglądać komunikaty w dzienniku serwisowym LIS, klikając najpierw logo Leica Biosystems w prawym górnym rogu ekranu klienta administracyjnego, aby wyświetlić okno dialogowe **About BOND** (o systemie BOND). Następnie kliknąć **Service log** (dziennik serwisowy) i wybrać **\*LIS\*** z listy rozwijanej **Serial N°**. (nr seryjny). Opcjonalnie można ustawić przedział czasowy i kliknąć **Generate** (generuj), aby wygenerować raport dziennika serwisowego LIS.

## 11.5 Wymagania dotyczące danych przypadków i szkiełek

Dane, których system BOND wymaga od LIS w celu zaimportowania przypadków i szkiełek przedstawiono w poniższych punktach (zob. [11.5.1 - Dane przypadku](#) oraz [11.5.2 - Dane szkiełka](#)).

-  Dane dotyczące przypadków i szkiełek LIS nie mogą zostać zmienione w systemie BOND, z wyjątkiem komentarzy dotyczących szkiełek.

### 11.5.1 Dane przypadku

#### 11.5.1.1 Pola obowiązkowe

Nazwa pola BOND	Opis	Wspólne terminy LIS
Case ID (ID przypadku)	Numer lub nazwa identyfikująca przypadek	Numer dostępu Numer zamówienia

#### 11.5.1.2 Pola opcjonalne

Nazwa pola BOND	Opis	Wspólne terminy LIS
Patient name (imię i nazwisko pacjenta)	Imię i nazwisko pacjenta	Patient name (imię i nazwisko pacjenta) ID przypisane przez laboratorium (labAssId)
Doctor (lekarz)	Lekarz kierujący	Imię i nazwisko i/lub ID lekarza Lekarz prowadzący Lekarz zamawiający

## 11.5.2 Dane szkiełka

### 11.5.2.1 Pola obowiązkowe

Nazwa pola BOND	Opis	Wspólne terminy LIS	Komentarze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeciwciało pierwszorzędowe (IHC) lub sonda (ISH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeciwciało pierwszorzędowe (IHC)</li> <li>Sonda (ISH)</li> <li>Marker (albo)</li> <li>Barwnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nazwa publiczna zapewnia powiązanie pomiędzy markerami określonymi przez LIS a tymi zarejestrowanymi w systemie BOND. Należy podać nazwę publiczną dla każdego markera, który zostanie określony w LIS. Zob. <a href="#">11.2.4 - Nazwy publiczne markerów</a>.</li> <li>Każdy marker ma domyślne protokoły barwienia i obróbki wstępnej, które można zmienić przy użyciu oprogramowania BOND, jeśli jest to konieczne.</li> </ul>

### 11.5.2.2 Pola opcjonalne

Nazwa pola BOND	Opis	Wspólne terminy LIS	Komentarze
[Kod kreskowy LIS]  <b>Uwaga:</b> Kod kreskowy nie jest widoczny dla użytkownika w systemie BOND	Unikalne ID w postaci kodu kreskowego dla każdego szkiełka LIS (nie można ponownie używać ID usuniętych szkiełek)	Kod kreskowy	Pełny kod kreskowy musi być dostarczony do systemu BOND, aby można było rozpoznać szkiełko. Jest to wymagane podczas korzystania z przebiegu pracy LIS 1 (zob. <a href="#">11.8 - Przebieg pracy</a> ).

Nazwa pola BOND	Opis	Wspólne terminy LIS	Komentarze
Tissue type (typ tkanki)	Tkanka testowa lub kontrolna (dodatnia lub ujemna)	Typ testu	Jeśli te informacje nie są dostarczane przez LIS, domyślna nazwa to „Test”. Zob. <a href="#">6.2.1 - Tkanka kontrolna</a> .
Komentarze	Wszelkie komentarze lub instrukcje dotyczące szkiełka	Komentarz	Jeśli aktualizacja szkiełka LIS zostanie wysłana przez LIS, wszelkie nowe komentarze dotyczące szkiełek zostaną dodane do istniejących komentarzy.

## 11.6 Przesyłanie danych dotyczących szkiełek z powrotem do LIS

BOND LIS-ip może zraportować dane dotyczące statusu szkiełek do LIS. BOND LIS-ip może zraportować następujące informacje:

- Slide created (szkiełko utworzone) – określone szkiełko zostało utworzone w oprogramowaniu BOND
- Slide printed (szkiełko wydrukowane) – dla określonego szkiełka została wydrukowana etykieta
- Slide in progress (szkiełko w toku) – określone szkiełko jest przetwarzane
- Slide processed (szkiełko przetworzone) – dla określonego szkiełka zakończył się proces przetwarzania (z błędami lub bez)
- Slide deleted (szkiełko usunięte) – określone szkiełko zostało usunięte z systemu BOND.

## 11.7 Etykiety szkiełek

Dla każdego fizycznego szkiełka wymagana jest etykieta identyfikacyjna, aby można było dopasować szkiełko do odpowiedniego przypadku i testu. Najbardziej wygodny przebieg pracy jest wówczas, gdy szkiełka LIS mają etykiety wydrukowane przez system LIS („etykiety szkiełek LIS”) i te etykiety są rozpoznawane przez system BOND. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy:

1. LIS zapewnia unikalny kod kreskowy dla każdego szkiełka w systemie. Dla każdego fizycznego szkiełka wymagana jest etykieta identyfikacyjna, aby można było dopasować szkiełko do odpowiedniego przypadku i testu.
2. Drukarka LIS wykorzystuje jeden z formatów kodów kreskowych obsługiwanych przez system BOND.

Jeśli LIS nie spełnia tych wymagań, wówczas system BOND może utworzyć własne etykiety dla szkiełek LIS – „etykiety szkiełek BOND-LIS”. W tym przypadku można opcjonalnie skonfigurować system BOND, tak aby przetwarzał szkiełka LIS tylko wtedy, gdy posiadają one etykiety wydrukowane przez system BOND. Opcję tę można ustawić na ekranie **LIS** klienta administracyjnego – zob. [10.2 - LIS](#).

Można również używać etykiet wydrukowanych na drukarce innej firmy lub wykonanych ręcznie. Etykiety te należy wówczas zidentyfikować ręcznie w systemie BOND przed przetworzeniem (zob. [5.1.5.2 - Ręczna identyfikacja szkiełek w urządzeniu](#)).

## 11.8 Przebieg pracy

Każda instalacja LIS-ip jest w dużym stopniu dostosowana do potrzeb użytkownika, jednak nadal warto przedstawić ogólne opisy przebiegów pracy BOND LIS-ip w oparciu o główne opcje LIS-ip. W poniższej tabeli przedstawiono cztery przebiegi pracy. Możliwe są również inne przebiegi pracy. Organizowane są kompleksowe szkolenia dotyczące poszczególnych instalacji w danej placówce.

Przebieg pracy	Dane z LIS	Dane wprowadzone w systemie BOND	Etykiety wydrukowane przez	Identyfikacja
1	Dane przypadków i szkiełek (z kodem kreskowym LIS)	Brak	LIS	Automatyczna
2	Dane przypadków i szkiełek	Brak	System BOND	Automatyczna
3		Dodatkowe szkiełko	System BOND	Automatyczna
4		Brak	Urządzenie zewnętrzne	Ręczna

Przebieg pracy 1 jest najwygodniejszy, ponieważ zapewnia bezproblemową integrację pomiędzy systemem LIS i systemem BOND. System BOND automatycznie rozpoznaje szkiełka LIS i może natychmiast rozpocząć przetwarzanie bez konieczności ponownego etykietowania szkiełek lub wprowadzania dodatkowych informacji.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)



Zawsze należy wyłączać moduł przetwarzania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji (oprócz sytuacji, w których uruchamiany jest przebieg czyszczenia sondy aspiracyjnej lub czyszczenia robota odczynników zbiorczych).



Niektóre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ są niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynności należy odbyć odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas tej procedury.

- a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urządzenia należy nosić rękawiczki lateksowe lub nitylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie środki ochronne.
- b. Odczynniki i kondensat należy transportować i utylizować zgodnie ze wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowiązującymi w laboratorium.



Moduły przetwarzania wyposażone są w podgrzewacze i gorące powierzchnie, które mogą tworzyć ryzyko zapłonu, jeśli materiały łatwopalne zostaną umieszczone w bliskiej odległości:

Nie umieszczać łatwopalnych materiałów na podgrzewaczach ani w ich pobliżu.

Nie umieszczać materiałów łatwopalnych na jakichkolwiek gorących powierzchniach modułu przetwarzania.

Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.



Unikać kontaktu z zespołami barwienia szkiełek i podzespołami znajdującymi się w ich pobliżu. Mogą one być bardzo gorące i powodować poważne oparzenia. Po wyłączeniu odczekać dwadzieścia minut, aż zespoły barwienia szkiełek i ich otoczenie ostygną.



Wszystkie wyjmowane elementy należy czyścić wyłącznie ręcznie. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć żadnego elementu w zmywarce. Nie czyścić żadnych części przy użyciu rozpuszczalników, środków czyszczących zawierających substancje ściernie ani szorstkich ściereczek.

W niniejszym rozdziale podano procedury czyszczenia i konserwacji. W kliencie klinicznym dostępny jest ekran konserwacji dla każdego modułu przetwarzania w systemie. Kliknąć kartę modułu przetwarzania po lewej stronie głównego okna, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu), a następnie kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja). Więcej informacji można znaleźć w rozdziale [5.3 - Ekran konserwacji](#). Przy każdym użyciu systemu BOND należy sprawdzić go pod kątem wycieków i zużytych lub uszkodzonych części. Postępować zgodnie z podanymi w niniejszym rozdziale instrukcjami dotyczącymi naprawy lub wymiany zużytej lub uszkodzonej części, jeśli są dostępne. W przeciwnym razie skontaktować się z działem obsługi klienta.

### Konserwacja zapobiegawcza

Oprócz regularnych czynności konserwacyjnych wymienionych w niniejszym rozdziale (przeprowadzanych przez użytkowników), moduły przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX muszą być regularnie serwisowane przez serwisanta Leica Biosystems.

Oprogramowanie BOND powiadamia o konieczności przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej dla każdego modułu przetwarzania raz w roku lub po przetworzeniu 15 600 szkiełek (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).




Licznik zostanie zresetowany po naciśnięciu przycisku **Maintenance complete** (konserwacja zakończona) na karcie **Processing modules** (moduły przetwarzania) klienta administracyjnego ([10.6.1 - Processing Modules \(moduły przetwarzania\)](#)).

Ten rozdział zawiera następujące części:

- [12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwacji](#)
- [12.2 - Pojemniki zbiorcze](#)
- [12.3 - Szkiełka nakrywkowe Covertile](#)
- [12.4 - Zespół barwienia szkiełek](#)
- [12.5 - Ponowne uruchamianie modułu przetwarzania](#)
- [12.6 - Sonda aspiracyjna](#)
- [12.7 - Blok myjący i stacja mieszania](#)
- [12.8 - Osłony, drzwi i pokrywy](#)
- [12.9 - Czytnik ID](#)
- [12.10 - Tace ociekowe](#)
- [12.11 - Tace na szkiełka](#)
- [12.12 - Sondy robota odczynników zbiorczych \(tylko BOND-III\)](#)
- [12.13 - Strzykawki](#)
- [12.14 - Bezpieczniki zasilania](#)



## 12.1 Harmonogram czyszczenia i konserwacji

 Wykonać czynności podane w poniższym harmonogramie w przypadku barwienia około 300 szkiełek tygodniowo przez jedno urządzenie. W przypadku przetwarzania większej liczby szkiełek skontaktować się z działem obsługi klienta w celu dostosowania harmonogramu.

Czynność	Część
<b>Codziennie – na początku dnia</b>	
Sprawdzić, czy zbiorcze pojemniki na odpady są napełnione maksymalnie w połowie*	<a href="#">12.2</a>
Sprawdzić, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki są przynajmniej w połowie pełne oraz czy zawierają odpowiedni odczynnik*	<a href="#">12.2</a>
<b>Codziennie – na końcu dnia</b>	
Wyczyścić szkiełka nakrywkowe Covertile	<a href="#">12.3</a>
<b>Co tydzień</b>	
Wyczyścić zespoły barwienia szkiełek*	<a href="#">12.4</a>
Skontrolować zaciski szkiełek nakrywkowych Covertile	<a href="#">12.4</a>
Uruchomić ponownie moduły przetwarzania	<a href="#">12.5</a>
Przetrzeć sondę aspiracyjną głównego robota	<a href="#">12.6</a>
Sprawdzić bloki myjące i stację mieszania – w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić	<a href="#">12.7</a>
Wyczyścić osłony, drzwi (jeśli są zamontowane) i pokrywę	<a href="#">12.8</a>
Wyczyścić czytnik ID	<a href="#">12.9</a>
Wyczyścić ręczny skaner kodów kreskowych	<a href="#">13.1</a>
<b>Co miesiąc</b>	
Wyczyścić wszystkie tace ociekowe*	<a href="#">12.10</a>
Wymenić stację mieszania	<a href="#">12.7</a>
Wyczyścić zbiorcze pojemniki na odczynniki	<a href="#">12.2</a>
Wyczyścić zbiorcze pojemniki na odpady	<a href="#">12.2</a>
Wyczyścić tace na szkiełka	<a href="#">12.11</a>
Wyczyścić sondy robota odczynniki zbiorczych (BOND)	<a href="#">12.12</a>
Wyczyścić drukarkę etykiet do szkiełek	<a href="#">13.2</a>
Sprawdzić strzykawki	<a href="#">12.13</a>
<b>Po wyświetleniu monitu</b>	
Wyczyścić sondę aspiracyjną głównego robota	<a href="#">12.6.1</a>
Wymenić sondę aspiracyjną głównego robota	<a href="#">12.6.2</a>
Wymenić strzykawki	<a href="#">12.13</a>

\* W razie potrzeby czynności te należy wykonywać częściej niż określono w harmonogramie.

### 12.1.1 Listy kontrolne czyszczenia i konserwacji

Na następnej stronie podano harmonogram konserwacji w postaci tabeli, którą można wydrukować i używać w formie listy kontrolnej. Uwzględniono miejsce na zapisywanie numerów partii roztworów BOND Wash, ER1, ER2 i Dewax. Zaznaczyć lub wstawić parafkę w odpowiednich komórkach w miarę wykonywania poszczególnych czynności.

**Harmonogram czyszczenia i konserwacji**

	Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.	Sob.	Nd.
<b>CODZIENNE</b>							
Sprawdzić zbiorcze pojemniki na odczynniki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numer partii BOND Wash							
Numer partii ER1							
Numer partii ER2							
Numer partii Dewax Solution							
Sprawdzić pojemniki na odpady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wyczyścić szkiełka nakrywkowe Covertile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CO TYDZIEŃ</b>				<b>Dla BOND-MAX:</b>			
Wyczyścić zespoły barwienia szkiełek*	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli na zewnętrznym pojemniku na odpady znajduje się tylko jedna nakrętka, przed jej odkręceniem należy odłączyć kabel i przewody płynu.</li> <li>• Jeśli pojemniki zbiorcze są nieprzezroczyste, należy unieść końce pojemników w celu oszacowania objętości – nie ma potrzeby wyjmowania pojemników z urządzenia.</li> </ul> <p>* W razie potrzeby czyścić częściej niż określono w harmonogramie</p>					
Skontrolować zaciski szkiełek nakrywkowych Covertile	<input type="checkbox"/>						
Uruchomić ponownie moduły przetwarzania	<input type="checkbox"/>						
Przetrzeć sondę aspiracyjną	<input type="checkbox"/>						
Sprawdzić blok myjący i stację mieszania	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić osłony, drzwi (jeśli są zamontowane) i pokrywę	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić czytnik ID	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić ręczny skaner	<input type="checkbox"/>						
<b>CO MIESIĄC</b>							
Wyczyścić tace ociekowe*	<input type="checkbox"/>						
Wymienić stację mieszania	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić zbiorcze pojemniki na odczynniki	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić zbiorcze pojemniki na odpady	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić tace na szkiełka	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić sondy robota odczynników zbiorczych (tylko BOND)	<input type="checkbox"/>						
Wyczyścić drukarkę etykiet do szkiełek	<input type="checkbox"/>						

12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)

	Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.	Sob.	Nd.
Sprawdzić strzykawki	<input type="checkbox"/>	Na tydzień od _____ do _____ – Na miesiąc _____					
<b>PO WYŚWIETLENIU MONITU</b>							
Wyczyścić sondę aspiracyjną	<input type="checkbox"/>						
Wymenić sondę aspiracyjną	<input type="checkbox"/>						
Wymenić strzykawki	<input type="checkbox"/>						

## 12.2 Pojemniki zbiorcze



Niektóre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ są niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynności należy odbyć odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas tej procedury.

- a. Podczas pracy z odczynnikiem lub czyszczenia urządzenia należy nosić rękawiczki lateksowe lub nitylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie środki ochronne.
- b. Odczynniki i kondensat należy transportować i utylizować zgodnie ze wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowiązującymi w laboratorium.



Niektóre z odczynników używanych w modułach przetwarzania BOND są łatwopalne:

Nie umieszczać płomienia ani źródła zapłonu w pobliżu modułów przetwarzania.

Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.

Codziennie (nie rzadziej) sprawdzać poziomy pojemników zbiorczych i raz miesiącu wyczyścić pojemniki zbiorcze. Więcej szczegółów:

- [12.2.1 - Sprawdzanie poziomów w pojemnikach](#)
- [12.2.2 - Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych](#)
- [12.2.3 - Czyszczenie pojemników zbiorczych](#)
- [12.2.4 - Zewnętrzny pojemnik na odpady \(tylko BOND-MAX\)](#)

### 12.2.1 Sprawdzanie poziomów w pojemnikach

Sprawdzać poziomy w pojemnikach zbiorczych na początku każdego dnia. Należy je sprawdzać również przed rozpoczęciem nocnego lub wydłużonego przebiegu. W przypadku laboratoriów o dużym obrocie może być konieczne zaplanowanie dwóch kontroli pojemników zbiorczych dziennie.

W modułach przetwarzania BOND-III i najnowszym modelu BOND-MAX (oraz w przypadku wszystkich zewnętrznych pojemników na odpady BOND-MAX), poziomy cieczy są widoczne przez ścianki pojemników. W przypadku modeli BOND-MAX z nieprzezroczystymi pojemnikami należy unieść końce pojemników w celu oszacowania objętości – nie należy wyjmować pojemników z urządzenia, ponieważ spowoduje to aktywację zalewania przewodów płynów po ponownym umieszczeniu pojemników w urządzeniu.

Ikony na ekranie **System status** (stan systemu) wskazują poziomy w pojemnikach zbiorczych w systemie BOND i służą do powiadamiania o wysokim poziomie odpadów lub niskim poziomie odczynników w systemie BOND-MAX. Ikony służą jedynie do potwierdzania poziomów i/lub wyświetlania powiadomień – nie zastępują codziennej kontroli.



Moduły przetwarzania BOND są wyposażone w system oświetlenia pojemnika zbiorczego (zob. [System oświetlenia pojemnika zbiorczego \(BOND-III\) on page 34](#)).

Napełnić lub opróżnić pojemniki, gdy spełnione są następujące warunki:

- Opróżnić pojemniki na odpady, które są napełnione przynajmniej w połowie
- Napełnić pojemniki na odczynniki, które są napełnione mniej niż w połowie.

Zob. [12.2.2 - Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych](#).



Sprawdzić poziom pojemników zbiorczych i opróżnić lub napełnić je, w zależności od potrzeb, na początku każdego dnia (częściej, jeśli jest to konieczne – zob. powyższe instrukcje). Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do konieczności wstrzymania przebiegu, co może negatywnie wpłynąć na barwienie.

## 12.2.2 Uzupełnianie lub opróżnianie pojemników zbiorczych

Podczas kontroli poziomu pojemników zbiorczych należy opróżnić pojemniki na odpady, które są zapełnione powyżej połowy objętości i napełnić pojemniki na odczynniki, których poziom wynosi mniej niż połowę objętości. Podczas napełniania lub opróżniania pojemników zbiorczych należy zawsze wycierać wszelkie wycieki. Wyczyścić zewnętrzne powierzchnie pojemników i nakrętek przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu.

Zob. instrukcje opróżniania i napełniania poniżej. W części [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#) znajdują się instrukcje dotyczące opróżniania lub napełnienia pojemnika podczas przebiegu.

- [12.2.2.1 - Napełnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki – BOND-III](#)
- [12.2.2.2 - Opróżnianie pojemnika na odpady niebezpieczne – BOND-III](#)
- [12.2.2.3 - Opróżnianie standardowego pojemnika na odpady – BOND-III](#)
- [12.2.2.4 - Opróżnianie pojemnika na odpady niebezpieczne lub napełnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki – BOND-MAX](#)
- [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#)

Instrukcje dotyczące opróżniania zewnętrznego pojemnika BOND znajdują się w części [12.2.4 - Zewnętrzny pojemnik na odpady \(tylko BOND-MAX\)](#).



Zawsze wkładać napełnione lub opróżnione pojemniki do tych samych miejsc w module przetwarzania. W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia odczynników i pogorszenia jakości barwienia.



Nie zmieniać typu odczynnika w zbiorczych pojemnikach na odczynniki. W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia i pogorszenia jakości barwienia.



Nie używać siły podczas ponownego montażu pojemników zbiorczych w odpowiedniej pozycji, ponieważ może dojść do uszkodzenia pojemnika i czujnika cieczy.

### 12.2.2.1 Napełnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki – BOND-III



Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-III można napełniać bez konieczności wyjmowania z urządzenia. Nie ma potrzeby wyjmowania ich z przedziału na pojemniki zbiorcze.

1. Odkręcić nakrętkę zbiorczego pojemnika na odczynniki i napełnić pojemnik.
2. Gdy pojemnik jest pełny, założyć nakrętkę i dokręcić.



W przypadku stosowania lejka podczas wlewania odczynnika do pojemników w urządzeniu BOND-III należy upewnić się, że lejek jest czysty. W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia odczynników i pogorszenia jakości barwienia.

### 12.2.2.2 Opróżnianie pojemnika na odpady niebezpieczne – BOND-III

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania nie działa. (Jeśli podczas przebiegu wyświetla się powiadomienie, że pojemnik na odpady jest pełny, należy go opróżnić zgodnie z poniższymi instrukcjami – zob. również [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#))
2. Wyciągnąć pojemnik z przedziału na pojemniki zbiorcze.
3. Odkręcić nakrętkę i usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
4. Założyć nakrętkę i dokręcić.
5. Umieścić pojemnik ponownie w urządzeniu. Delikatnie wcisnąć pojemnik do momentu, gdy złącze pojemnika wyrówna się ze złączem z tyłu obudowy. Następnie mocno popchnąć pojemnik do momentu całkowitego zaczeplenia złącza, aby zapewnić szczelność połączenia.

### 12.2.2.3 Opróżnianie standardowego pojemnika na odpady – BOND-III


Urządzenie posiada dwa standardowe pojemniki na odpady, dlatego można wyjąć pełny pojemnik (na ekranie **System status** (stan systemu) przy ikonie tego pojemnika widnieje informacja o jego zapełnieniu) w dowolnym momencie, nawet w trakcie przetwarzania (zob. [5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego](#)). Nie wolno jednak wyjmować obu zbiorczych pojemników na odpady podczas pracy urządzenia. Jeśli pojemnik nie jest oznaczony jako pełny na ekranie **System status** (stan systemu) zaleca się, aby poczekać na zakończenie przetwarzania przed wyjęciem pojemnika. Gdy już można bezpiecznie wyjąć zbiorczy pojemnik na odpady, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania odpadów niebezpiecznych podanymi w punkcie (2) powyżej.



Postać 12-1: Umieszczanie pojemnika na odpady w odpowiedniej pozycji

### 12.2.2.4 Opróżnianie pojemnika na odpady niebezpieczne lub napełnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki – BOND-MAX

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania nie działa. (Jeśli podczas przebiegu wyświetla się powiadomienie, że pojemnik na odpady jest pełny, należy go opróżnić zgodnie z poniższymi instrukcjami – zob. również [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#))
2. Wyciągnąć pojemnik z przedziału na pojemniki zbiorcze.

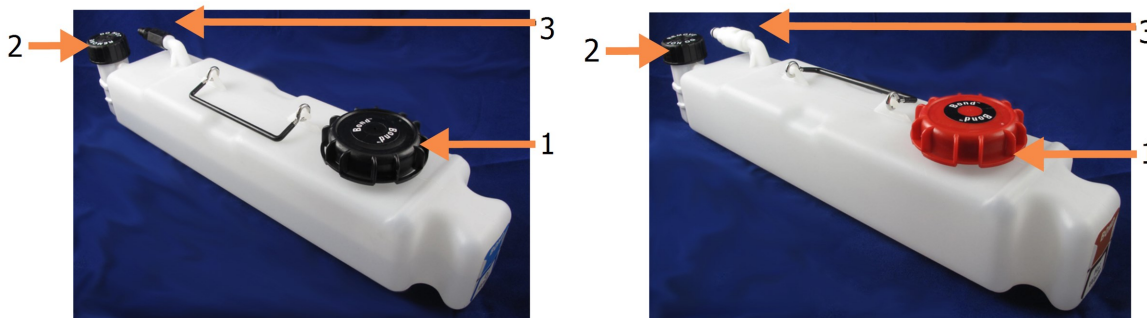

Postać 12-2: Pojemnik na odpady niebezpieczne BOND-MAX (po lewej) i zbiorczy pojemnik na odczynniki (po prawej)

Nr	Nazwa
1	Nakrętka do napełniania/opróżniania
2	Nakrętka czujnika poziomu cieczy
3	Złącze

3. Napełnianie lub opróżnianie pojemnika:
  - Pojemnik na odpady: odkręcić nakrętkę do napełniania/opróżniania (element 1 na [Postać 12-2](#)) i usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
  - Zbiorczy pojemnik na odczynniki: umieścić pojemnik na równej powierzchni, odkręcić nakrętkę do napełniania/opróżniania (element 1 na [Postać 12-2](#)) i napełnić do poziomu dolnej części szyjki, na którą wkręca się nakrętkę.



Nie zdejmować nakrętki czujnika poziomu cieczy z pojemnika zbiorczego, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu. Pojemniki zbiorcze należy opróżniać i napełniać wyłącznie przez otwór do napełniania/opróżniania.


4. Założyć nakrętkę i dokręcić.
5. Umieścić pojemnik ponownie w urządzeniu. Delikatnie wcisnąć pojemnik do momentu, gdy złącze pojemnika wyrówna się ze złączem z tyłu obudowy. Następnie mocno popchnąć pojemnik do momentu całkowitego zaczeplenia złącza, aby zapewnić szczelność połączenia.



### 12.2.2.5 Podczas przebiegów

Jeśli przeprowadzane są codzienne kontrole pojemników zbiorczych (łącznie z dodatkową kontrolą przed nocnym i wydłużonym przebiegiem, a także regularnymi dodatkowymi kontrolami w przypadku laboratoriów o dużym obrocie), pojemniki na odpady nigdy nie powinny się zapełnić, a pojemniki na odczynniki nigdy nie powinny się całkowicie opróżnić podczas przetwarzania. Jeśli jednak wystąpi którakolwiek z tych sytuacji podczas przebiegu, należy opróżnić lub napełnić odpowiednie pojemniki. Należy przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że procedura jest prawidłowa.

#### **Pojemnik na odpady pełny – BOND-MAX**

Jeśli pojemnik na odpady będzie prawie pełny podczas przebiegu, na ekranie **System status** (stan systemu) na ikonie odpowiedniego pojemnika zostanie wyświetlony symbol powiadomienia  .


Należy natychmiast opróżnić pojemnik. Należy stosować wszystkie standardowe środki ostrożności i przestrzegać procedur usuwania odpadów obowiązujące w placówce. Poprzez szybkie działanie można uniknąć wstrzymania przebiegu pracy lub skrócić czas wstrzymania. Wstrzymanie przebiegu może skutkować pogorszeniem jakości barwienia.

Jeśli w trakcie opróżniania pojemnika zostanie przerwany przebieg pracy lub praca będzie kontynuowana do momentu automatycznego zatrzymania modułu przetwarzania, na ikonie pojemnika pojawi się symbol

alarmu  (migający) lub symbol ostrzeżenia  . Opróżniony pojemnik należy jak najszybciej umieścić ponownie w urządzeniu, zwracając uwagę na instrukcje i środki ostrożności wymienione powyżej.

Wygenerować raport dot. zdarzeń podczas przebiegu, aby zobaczyć wpływ wstrzymania na przebieg.

#### **Pojemnik na odczynniki pusty – BOND-MAX**

Jeśli pojemnik na odczynniki będzie bliski opróżnienia, na ekranie **System status** (stan systemu) na ikonie odpowiedniego pojemnika zostanie wyświetlony symbol powiadomienia  .

1. Przejdź do ekranu **Protocol status** (status protokołu), aby wyświetlić bieżące i kolejne etapy dla każdego przebiegu w module przetwarzania.
  2. Jeśli podczas jakiegokolwiek przebiegu używany jest zbiorczy pojemnik o niskim lub prawie zerowym poziomie odczynnika, należy poczekać na zakończenie etapów, w których wykorzystywany jest dany odczynnik.
  3. Po zakończeniu etapów, w których wykorzystywany jest dany odczynnik, należy wyjąć pojemnik, napełnić go i jak najszybciej umieścić ponownie (przy zachowaniu wszystkich standardowych środków ostrożności).
- Aby zaoszczędzić czas, nie trzeba napełniać pojemnika do maksymalnego poziomu.



Jeśli pojemnik zbiorczy BOND-MAX wymaga napełnienia podczas przetwarzania, należy zawsze sprawdzać ekran **Protocol status** (status protokołu) i upewnić się, że pojemnik nie jest używany ani nie będzie wkrótce używany. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować pogorszeniem jakości przetwarzania szkielek. Pojemnik należy umieścić ponownie natychmiast po napełnieniu.

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy codziennie sprawdzać poziom cieczy w pojemnikach zbiorczych (lub częściej, jeśli jest to wymagane – zob. [12.2.1 - Sprawdzanie poziomów w pojemnikach](#)).

## 12.2.3 Czyszczenie pojemników zbiorczych

Poniższe procedury czyszczenia należy wykonywać co miesiąc.

### 12.2.3.1 Pojemniki na ER1, ER2, BOND Wash i wodę dejonizowaną

1. Opróżnić zbiorcze pojemniki na odczynniki ER1, ER2, BOND Wash i wodę dejonizowaną.
2. Umyć pojemniki, używając detergentu przemysłowego o silnym działaniu, a następnie dokładnie spłukać wodą dejonizowaną.
3. Pozostawić pojemniki do wyschnięcia, a następnie napełnić świeżym odczynnikiem i umieścić ponownie w urządzeniu.

### 12.2.3.2 Pojemniki na środek do odparafinowania i alkohol

1. Opróżnić zbiorcze pojemniki na odczynniki ze środkiem do odparafinowania i alkoholem. Zutylizować środek do odparafinowania i alkohol w zbiorczych pojemnikach na odczynniki zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
2. Wlać niewielką ilość świeżego odczynnika do każdego pojemnika i obracać pojemnikiem tak, aby spłukać wszelkie zanieczyszczenia ze ścian pojemnika. Po zakończeniu opróżnić pojemnik. Usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.

**Uwaga:** Nigdy nie należy wlewać wody ani detergentów do pojemników z alkoholem lub środkiem do odparafinowania.

3. Napełnić pojemnik zbiorczy świeżym odczynnikiem i umieścić ponownie w urządzeniu.

### 12.2.3.3 Zbiorcze pojemniki na odpady

1. Usunąć wszystkie odpady z pojemników. Usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
2. Wyczyścić pojemniki na odpady za pomocą roztworu wybielacza 0.5% (w/v) lub detergentu przemysłowego o silnym działaniu i dokładnie spłukać wodą dejonizowaną.
3. Umieścić pojemniki na odpady ponownie w urządzeniu.

### 12.2.4 Zewnętrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)

Opróżnić 9-litrowy zewnętrzny pojemnik na odpady standardowe BOND-MAX na początku każdego dnia i sprawdzać poziom napełnienia przed rozpoczęciem nocnego lub wydłużonego przebiegu. Opróżnić pojemnik po osiągnięciu lub przekroczeniu połowy objętości; biała linia pozioma na etykiecie pojemnika oznacza połowę objętości pojemnika – zob. [Postać 12-3](#).



Nr	Nazwa
1	Nakrętka do napełniania/opróżniania
2	Pojemnik wypełniony do połowy

Postać 12-3: 9-litrowy zewnętrzny pojemnik na odpady standardowe BOND-MAX

Pojemnik należy czyścić co miesiąc, podobnie jak w przypadku innych pojemników zbiorczych (zob. [12.2.3 - Czyszczenie pojemników zbiorczych](#)).

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania nie działa. (Jeśli podczas przebiegu wyświetla się powiadomienie, że pojemnik na odpady jest pełny, należy go opróżnić zgodnie z poniższymi instrukcjami – zob. również [12.2.2.5 - Podczas przebiegów](#))
2. Pojemnik ma złącza podobne do tych pokazanych na [Figure 12-4](#) (uwaga: niektóre złącza czujnika są czarne, a nie srebrne):



Figure 12-4: Złącza zewnętrznego pojemnika na odpady

Nr	Nazwa
1	Złącze czujnika poziomu cieczy
2	Złącze cieczy

- i. Za pomocą kciuka podnieść czerwony zatrzask na złączu czujnika (1) i wyciągnąć złącze z nasadki.
  - ii. Nacisnąć metalowy przycisk na złączu cieczy (2) i wyciągnąć złącze z nasadki.
3. Aby opróżnić pojemnik, należy odkręcić nakrętkę do napełniania/oprózniania. Nie zdejmować nasadki ze złączami. Usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
  4. Umieścić ponownie nakrętkę do napełniania/oprózniania i mocno dokręcić, a następnie umieścić ponownie w module przetwarzania.
  5. Wcisnąć złącze cieczy z powrotem do nasadki do usłyszenia kliknięcia.
  6. Ponownie podłączyć złącze czujnika. Wepchnąć złącze w dół do podstawy nasadki.



Pełny zewnętrzny pojemnik na odpady jest ciężki.  
Podczas opróżniania zewnętrznego pojemnika na odpady należy stosować odpowiednie techniki podnoszenia.



Przed opróżnieniem pojemnika należy odłączyć złącza czujnika i cieczy, aby uniknąć uszkodzenia.

## 12.3 Szkiełka nakrywkowe Covertile

Wyczyścić szkiełka nakrywkowe Covertile po każdym użyciu (do tego celu można użyć statywu Leica Biosystems Covertile Cleaning Rack). Szkiełka nakrywkowe Covertile mogą być używane wielokrotnie, do 25 razy, pod warunkiem, że nie są uszkodzone lub mocno odbarwione, a także pod warunkiem, że są prawidłowo czyszczone. W razie uszkodzenia lub pogorszenia jakości barwienia należy wyrzucić szkiełka nakrywkowe Covertile.

### 12.3.1 Usuwanie pozostałości DAB (opcjonalne)

1. Moczyć przez co najmniej 30 minut w świeżym roztworze podchlorynu sodu w wodzie dejonizowanej o stężeniu 0.5% m/V.
2. Wyjąć i zanurzyć ponownie w świeżej wodzie dejonizowanej; czynność powtórzyć 10 razy.
3. Wykonać standardową procedurę czyszczenia (patrz poniżej).

### 12.3.2 Standardowe czyszczenie (obowiązkowe)

1. Namaczać przez co najmniej 10 minut w 100% roztworze IMS (przemysłowy spirytus metylowy), etanolu lub innego alkoholu odczynnikowego.
2. Mieszać przez 30 sekund i wyjąć z roztworu.
3. Suszenie:
  - wytrzeć do sucha ściereczką niepozostawiającą włókien lub
  - pozostawić do wyschnięcia.
4. Dokładnie sprawdzić szkiełka nakrywkowe Covertile pod kątem pęknięć lub odkształceń. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia wyrzucić.

## 12.4 Zespół barwienia szkiełek



Moduły przetwarzania wyposażone są w podgrzewacze i gorące powierzchnie, które mogą tworzyć ryzyko zapłonu, jeśli materiały łatwopalne zostaną umieszczone w bliskiej odległości:

- Nie umieszczać łatwopalnych materiałów na podgrzewaczach ani w ich pobliżu.
- Nie umieszczać materiałów łatwopalnych na jakichkolwiek gorących powierzchniach modułu przetwarzania.
- Po ponownym napełnieniu lub opróżnieniu upewnić się, że wszystkie pokrywy pojemnika zbiorczego są prawidłowo zamknięte.



Unikać kontaktu z zespołami barwienia szkiełek i podzespołami znajdującymi się w ich pobliżu. Mogą one być bardzo gorące i powodować poważne oparzenia. Po wyłączeniu odczekać dwadzieścia minut, aż zespoły barwienia szkiełek i ich otoczenie ostygną.



Należy czyścić określone elementy wyłącznie ręcznie. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć żadnego elementu w zmywarce. Nie czyścić żadnych części przy użyciu rozpuszczalników, środków czyszczących zawierających substancje ściernie ani szorstkich ściereczek.



Przed czyszczeniem lub demontażem płyty górnej należy upewnić się, że roboty odczynników zbiorczych (BOND-III) znajdują się w pozycji wyjściowej w tylnej części urządzenia i nie są umieszczone wzdłuż zespołów barwienia szkiełek.



Nie używać patyczków do uszu ani innych aplikatorów z bawełnianą końcówką do czyszczenia otworów w bloku myjącym lub słupków do odprowadzania wilgoci w zespole barwienia szkiełek, ponieważ końcówka bawełniana może się oderwać i zablokować otwór.

### Standardowe czyszczenie

Zespoły barwienia szkiełek należy czyścić raz w tygodniu lub częściej w przypadku widocznego nagromadzenia brudu.


Używać niepozostawiającej włókien ściereczki zwilżonej alkoholem o stężeniu 70% (jak najmniej wilgotnej). W przypadku trudności z usunięciem osadu należy użyć roztworu BOND Wash Solution (jak najmniejszej ilości), a następnie spłukać wodą dejonizowaną.

W przypadku BOND-III należy wytrzeć szynę prowadzącą robota odczynników zbiorczych (element 3 na [Figure 12-6](#)).

Otworzyć płytę górną (zob. [Zdejmowanie płyty górnej on page 274](#) na stronie 1) i wyczyścić:

- Podkładki grzewcze
- Otwory drenażowe i słupki do odprowadzania wilgoci
- Obszary między podkładkami grzewczymi
- Tacę ociekową wokół podkładek

Należy zawsze sprawdzać, czy w otworach drenażowych (oraz małych słupkach do odprowadzania wilgoci na brzegach otworów) nie ma ciał obcych oraz czy nie są zarysowane ani uszkodzone. W przypadku uszkodzenia tych lub innych elementów zespołów barwienia szkiełek należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

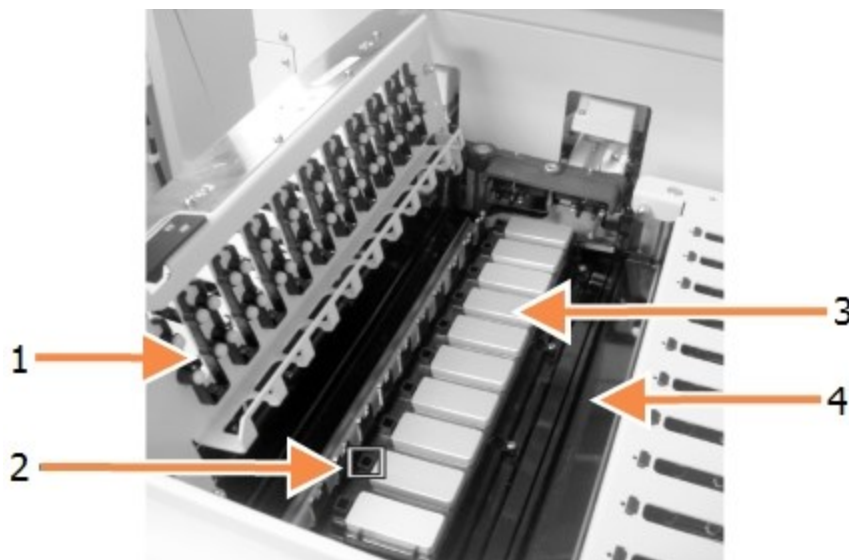

Nr	Nazwa
1	Zaciski szkiełek nakrywkowych Covertile
2	Otwór drenażowy i słupki do odprowadzania wilgoci
3	Podkładki grzewcze
4	Taca ociekowa

Postać 12-5: Zespół barwienia szkiełek z otwartą płytą górną

Gdy płyta górna jest otwarta, należy sprawdzić zaciski szkiełek nakrywkowych Covertile znajdujące się na spodzie płyty i upewnić się, że sprężyny poruszają się swobodnie. Jeśli sprężyny zaciskowe nie odskakują po naciśnięciu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany.

**Zdejmowanie płyty górnej**

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności i wyłączyć zasilanie.
2. Otworzyć płytę górną, naciskając ją i przekręcając niebieskie pokrętki mocujące na obu końcach płyty (element 1 na [Figure 12-6](#) oraz [Figure 12-7](#)) o ćwierć obrotu w lewo. Odchylić płytę górną, korzystając z zawiasów (patrzac w stronę urządzenia, prawa strona górnej płyty podniesie się).



Nr	Nazwa
1	Pokrętki mocujące
2	Zawiasy przegubowe
3	Szyna prowadząca robota odczynników zbiorczych

Figure 12-6: Płyta górna BOND-III



Nr	Nazwa
1	Pokrętki mocujące
2	Zawiasy przegubowe

Figure 12-7: Płyta górna BOND-MAX



3. Aby całkowicie zdjąć płytę górną (nie wymaga rutynowego czyszczenia), należy pociągnąć za sprężynowe łączniki przegubowe na każdym końcu płyty (element 2 na [Figure 12-6](#) oraz [Figure 12-7](#)), a następnie podnieść płytę i zdjąć ją z zespołu barwienia szkielek.

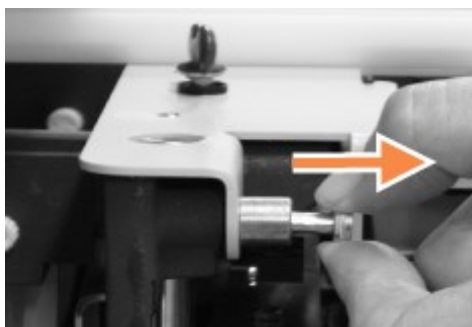


Figure 12-8: Zwalnianie łącznika przegubowego płyty górnej

#### 12.4.0.1 Wymiana płyty górnej

**Uwaga:** W przypadku urządzenia BOND-III płyty górne zespołu barwienia szkielek są ponumerowane; należy zawsze umieszczać właściwą płytę górną na odpowiednim zespole barwienia szkielek (patrząc w stronę urządzenia zespół barwienia szkielek po lewej stronie ma numer pierwszy).

1. Zlokalizować punkty przegubowe w zespole barwienia szkielek. Przytrzymać płytę górną w położeniu otwartym i umieścić jeden z łączników przegubowych w punkcie przegubowym zespołu barwienia szkielek.
2. Pociągnąć drugi łącznik obrotowy i umieścić koniec płytki w odpowiedniej pozycji, a następnie zwolnić łącznik.
3. Zamknąć płytę górną, sprawdzając, czy otwory na każdym końcu płyty prawidłowo zaczepiają o kołki ustalające.
4. Przytrzymać płytę górną i przekręcić pokrętła mocujące w prawo. Powinny one mocno zacisnąć się po przekręceniu o ćwierć obrotu w prawo.

## 12.4.1 Ręczne odblokowanie zespołów barwienia szkiełek

Każdy zespół barwienia szkiełek może być odblokowany ręcznie, na przykład w celu usunięcia szkiełek w przypadku awarii zasilania.



Zespoły barwienia szkiełek zawierają ruchome części, które mogą spowodować poważne obrażenia. Przed przystąpieniem do ręcznego odblokowania zespołów barwienia szkiełek: wyłączyć moduł przetwarzania za pomocą wyłącznika zasilania, wyłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazda ściennego.

- [12.4.1.1 - BOND-III](#)
- [12.4.1.2 - BOND-MAX](#)

### 12.4.1.1 BOND-III



Moduł pompy strzykawki (BOND-III) jest ciężki i może przewrócić się w przód po zwolnieniu. Procedura ta powinna być wykonywana wyłącznie przez operatorów, którzy zostali ostrzeżeni o potencjalnych zagrożeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.

Aby ręcznie odblokować zespół barwienia szkiełek w systemie BOND:

1. Wyłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć przewód zasilający.
2. Odkręcić cztery śruby z gniazdem sześciokątnym mocujące pokrywę modułu strzykawki, używając dołączonego klucza imbusowego 3 mm. Zdjąć pokrywę, aby uzyskać lepszy dostęp do kołków zwalniających i uchwytu modułu.
3. Zlokalizować dwa kołki zwalniające obok pierwszej i czwartej pompy strzykawki.



Figure 12-9: Położenie kołków zwalniających przy otwartej jednostce

4. Pociągnąć za dwa kołki w swoją stronę, aż do momentu usłyszenia kliknięcia sygnalizującego opuszczenie modułu. Należy uważać, aby nie pociągnąć ani nie ścisnąć żadnych przewodów płynów na głowicach strzykawek podczas przesuwania modułu do przodu.
5. Moduł pompy strzykawki otworzy się wystarczająco, aby umożliwić dostęp do zespołów barwienia szkiełek.
6. Zlokalizować ręczne pokrętło zwalniające pod zespołem barwienia szkiełek.



Figure 12-10: Ręczne pokrętło zwalniające

7. Obrócić pokrętło w kierunku pokazanym na [Figure 12-10](#). Podczas obracania pokrętła szkiełka nakrywkowe Covertile przesuną się nad szkiełka, a cały zespół i taca przesuną się w górę.
8. Kontynuować obracanie pokrętła zwalniającego aż do oporu. W tym momencie powinno być możliwe wyjęcie tacy na szkiełka z zespołu.
9. Szkiełka należy przechowywać zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
10. Delikatnie wepchnąć moduł pompy strzykawki na swoje miejsce, uważając, aby nie pociągnąć ani nie ścisnąć żadnych przewodów płynów na głowicach strzykawek.
11. Upewnić się, że dwa kołki po obu stronach modułu powrócą na swoje miejsce (kliknięcie oznacza zablokowanie w odpowiednim miejscu).



Upewnić się, że moduł strzykawki (BOND-III) jest całkowicie zamknięty przed rozpoczęciem przebiegu lub inicjalizacją modułu przetwarzania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia strzykawek podczas pracy.

12. Zamocować osłonę modułu strzykawki i zabezpieczyć za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.

Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić **Protocol status** (status protokołu) (zob. [5.2 - Ekran statusu protokołu](#)).

Po włączeniu modułu przetwarzania przeprowadzana jest inicjalizacja, a następnie moduł sprawdza stan zespołów i podejmuje wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Po inicjalizacji stan zespołu barwienia szkiełek zostanie odblokowany i na ekranie statusu protokołu nie będą wyświetlane żadne kroki. Możliwe jest zakończenie przetwarzania w systemie BOND-III lub ręczne ukończenie pozostałych kroków.

### 12.4.1.2 BOND-MAX

Aby ręcznie odblokować zespół barwienia szkiełek w systemie BOND-MAX, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć przewód zasilający.
2. Otworzyć drzwi pojemników zbiorczych i wyjąć pojemniki zbiorcze.
3. Wysunąć tacę znajdującą się w górnej części przedziału na pojemniki zbiorcze.
4. Zlokalizować ręczne pokrętło zwalniające (zob. [Figure 12-10](#)) pod zespołem barwienia szkiełek.
5. Obrócić pokrętło w kierunku pokazanym na [Figure 12-10](#). Podczas obracania pokrętła szkiełka nakrywkowe Covertile powinny przesunąć się nad szkiełka, a cały zespół i taca przesuną się w górę.
6. Kontynuować obracanie pokrętła zwalniającego aż do oporu. W tym momencie powinno być możliwe wyjęcie tacy na szkiełka z zespołu.
7. Szkiełka należy przechowywać zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.
8. W razie potrzeby wyczyścić dolne i górne tace ociekowe, a następnie ponownie włożyć górną tacę do przedziału na pojemniki zbiorcze – koniec tacy zakrzywiony pod kątem 45 stopni umieszczany jest z przodu; zakrzywiona część skierowana jest w górę.
9. Ponownie włożyć pojemniki zbiorcze.
10. Zamknąć drzwi przedziału na pojemniki zbiorcze.

Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić **Protocol status** (status protokołu) (zob. [5.2 - Ekran statusu protokołu](#)).

Po włączeniu modułu przetwarzania przeprowadzana jest inicjalizacja, a następnie moduł sprawdza stan zespołów i podejmuje wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Po inicjalizacji stan zespołu barwienia szkiełek zostanie odblokowany i na ekranie statusu protokołu nie będą wyświetlane żadne kroki. Możliwe jest zakończenie przetwarzania w systemie BOND-MAX lub ręczne ukończenie pozostałych kroków.

## 12.5 Ponowne uruchamianie modułu przetwarzania

Każdy moduł przetwarzania powinien być wyłączany i uruchamiany ponownie raz w tygodniu. Dzięki temu moduł przetwarzania może przeprowadzić samodzielną diagnostykę systemu.

Jednostanowiskowy kontroler BOND nie musi być wyłączany i uruchamiany regularnie. Jednak w przypadku zauważalnego spowolnienia działania oprogramowania BOND może być konieczne ponowne uruchomienie kontrolera z poziomu menu Start systemu Windows.

W przypadku posiadania systemu BOND-ADVANCE należy zapoznać się z częścią [16.1 - Ponowne uruchamianie systemu BOND-ADVANCE](#).

### **Moduł przetwarzania**

W przypadku modułów przetwarzania należy upewnić się, że nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów, a następnie wyłączyć go za pomocą wyłącznika zasilania po prawej stronie urządzenia. Odczekać 30 sekund, a następnie ponownie włączyć. Podczas uruchamiania system BOND zalewa układ płynów i przeprowadza szereg testów systemowych (zob. [2.2.2 - Inicjalizacja modułu przetwarzania](#)).

Uwaga: można wykonać częściowe zalewanie układu płynów bez wyłączania modułu przetwarzania (zob. [- Czyszczenie układu płynów](#)).

### Czyszczenie układu płynów

Naciśnięcie przycisku **Clean fluidics** (wyczyść układ płynów) na ekranie **Maintenance** (konserwacja) powoduje zalewanie przewodów w układzie płynów z pojemników zbiorczych (część inicjalizacji modułu roboczego przy uruchamianiu). Tę procedurę należy uruchomić w przypadku podejrzenia niedrożności lub obecności powietrza w układzie podawania płynów.

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie beczynności i nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów.
2. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
3. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie przycisk **Clean fluidics** (wyczyść układ płynów).
4. Kliknąć **Yes** (tak) w oknie z potwierdzeniem.
5. Układ płynów jest zalewany, co może zająć kilka minut.

## 12.6 Sonda aspiracyjna

Sonda aspiracyjna jest automatycznie czyszczona w bloku myjącym przed i po kontakcie z każdym odczynnikiem w ramach normalnego przebiegu pracy. Jednakże należy wykonywać dodatkowe cotygodniowe wycieranie i czyszczenie przy użyciu systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System. Odczynniki systemu czyszczenia są zoptymalizowane pod kątem pracy z systemem BOND, a oprogramowanie BOND wykorzystuje protokół czyszczenia opracowany w celu uzyskania maksymalnej wydajności mycia. Oprogramowanie BOND ostrzega użytkowników o zbliżającej się konieczności czyszczenia i wymiany sondy.



Nie przesuwaj ramienia głównego robota, gdy moduł przetwarzania jest włączony. Może dojść do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidłowego barwienia.

Jeśli ustawienie robota uległo zmianie: wyłączyć urządzenie, odczekać 30 sekund, a następnie ponownie je uruchomić.

Zob.

- [12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej](#)
- [12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej](#)

### 12.6.1 Czyszczenie sondy aspiracyjnej

Zawsze wyłączać moduł przetwarzania przed czyszczeniem i uważać, aby nie zginać sondy. Raz w tygodniu przetrzeć zewnętrzną powierzchnię sondy aspiracyjnej roztworem alkoholu o stężeniu 70% za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien lub gazika nasączonego alkoholem. Sprawdzić, czy przewody podłączone do sondy aspiracyjnej nie są pozginane oraz upewnić się, że wewnątrz przewodów nie ma żadnych przedmiotów. Przewody powinny być czyste.

Oprogramowanie BOND informuje o konieczności wyczyszczenia sondy za pomocą systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System po przetworzeniu 300 szkiełek (zob. [12.6.1.1 - Uruchamianie procesu czyszczenia sondy aspiracyjnej](#)). Licznik zostanie automatycznie zresetowany po zakończeniu czyszczenia lub wymianie sondy.



Systemy czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System należy rejestrować w systemie BOND w taki sam sposób, jak systemy detekcji (zob. [8.3.3 - Rejestrowanie odczynników i systemów odczynników](#)).

Oprogramowanie przechowuje dane dotyczące korzystania z systemu czyszczenia, umożliwiając przeprowadzenie 15 procesów czyszczenia dla każdego systemu.



Aby utrzymać skuteczność odczynników w systemach czyszczących, należy je umieszczać w modułach przetwarzania tylko wtedy, gdy mają być używane. Nie można wyczyścić sondy aspiracyjnej, gdy jakiegokolwiek inne odczynniki lub systemy odczynników są załadowane do urządzenia. Nie można również rozpocząć przetwarzania szkiełek, gdy system czyszczenia jest załadowany do urządzenia.

#### 12.6.1.1 Uruchamianie procesu czyszczenia sondy aspiracyjnej

Aby wyczyścić sondę aspiracyjną za pomocą systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Procedura czyszczenia trwa około 20 minut.

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności i nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów.
2. Wyjąć wszystkie tace na odczynniki lub system odczynników z modułu przetwarzania.
3. Włożyć system czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System do tacy na odczynniki w module przetwarzania.
4. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
5. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie kliknąć przycisk **Clean aspirating probe** (wyczyść sondę aspiracyjną).
6. Kliknąć **Yes** (tak), aby rozpocząć czyszczenie.  
Rozpoczyna się procedura czyszczenia, co symbolizuje ikona czyszczenia na karcie modułu przetwarzania.
7. Poczekać na wyświetlenie powiadomienia o zakończeniu czyszczenia.
8. Wyjąć system czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System z tacy na odczynniki.
9. Kliknąć **OK** w oknie dialogowym **Cleaning complete** (czyszczenie zakończone), aby kontynuować normalną pracę.

## 12.6.2 Wymiana sondy aspiracyjnej


Oprogramowanie BOND informuje o konieczności wymiany sondy aspiracyjnej po każdym przetworzeniu 7800 szkiełek. Zob. [5.1.2 - Status urządzenia](#).



Jeśli preferowana jest wymiana sondy aspiracyjnej przez inżyniera serwisu Leica Biosystems, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Można również wymienić sondę aspiracyjną samodzielnie, zgodnie z opisem poniżej.

Do wymiany sondy aspiracyjnej nie są potrzebne narzędzia.

### 12.6.2.1 Demontaż sondy aspiracyjnej

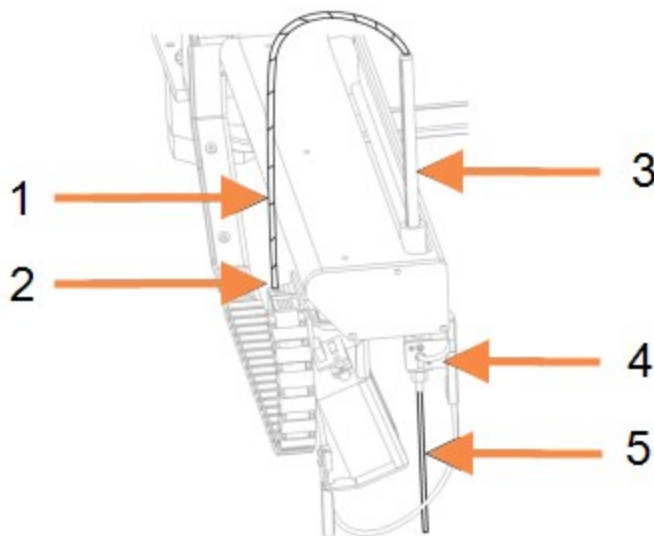


Postać 12-11: Zespół sondy aspiracyjnej:




Nr	Nazwa
1	Przewód sondy aspiracyjnej
2	Złącze
3	Statyw sondy aspiracyjnej
4	Blok izolatora ze śrubą radełkowaną w części tylnej
5	Sonda aspiracyjna

Zdemontować zespół sondy aspiracyjnej w następujący sposób:

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie beczynności i nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów.
2. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
3. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie kliknąć przycisk **Replace aspirating probe** (wymień sondę aspiracyjną).
4. Uważnie przeczytać instrukcje w oknie dialogowym **Replace aspirating probe**, a następnie kliknąć **Yes** (tak), aby kontynuować.
5. Moduł przetwarzania przygotowuje teraz układ płynów do wymiany sondy aspiracyjnej. Po zakończeniu przygotowania układu płynów (może to potrwać dłuższą chwilę) moduł

przetwarzania odłączy się od oprogramowania, co symbolizuje ikona  w karcie **Status screen** (ekran statusu).

6. Wyłączyć moduł roboczy i otworzyć pokrywę.
7. Przetrzeć końcówkę sondy chusteczką, aby usunąć wilgoć lub krople.
8. Całkowicie poluzować śrubę radełkowaną w tylnej części bloku izolatora (nie można wyjmować śruby). Zob. zdjęcie na następnej stronie.


 Jeśli śruba radełkowana nie zostanie całkowicie poluzowana, może dojść do uszkodzenia powłoki teflonowej na sondzie aspiracyjnej.

9. Trzymać odsłoniętą końcówkę poniżej bloku izolatora i delikatnie popchnąć w górę, aby upewnić się, że jest poluzowana.  
Nie wolno gwałtownie wyciągać przewodu z górnej części statywu sondy aspiracyjnej (element 3 na [Postać 12-11](#)), ponieważ może to skutkować odłączeniem przewodu od końcówki.
10. Gdy sonda jest poluzowana, delikatnie przeciągnąć przewód ku górze przez zacisk sondy aspiracyjnej i wyjąć.
11. Odkręcić złącze przewodu sondy aspiracyjnej (poz. 2 na [Postać 12-11](#)) od „łańcucha” po lewej stronie ramienia robota.



### 12.6.2.2 Montaż nowej sondy aspiracyjnej

Montaż sondy aspiracyjnej jest kluczowym zadaniem. Jeśli sonda nie zostanie prawidłowo zamontowana, może to skutkować nieprawidłowym barwieniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykonywania tej czynności należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

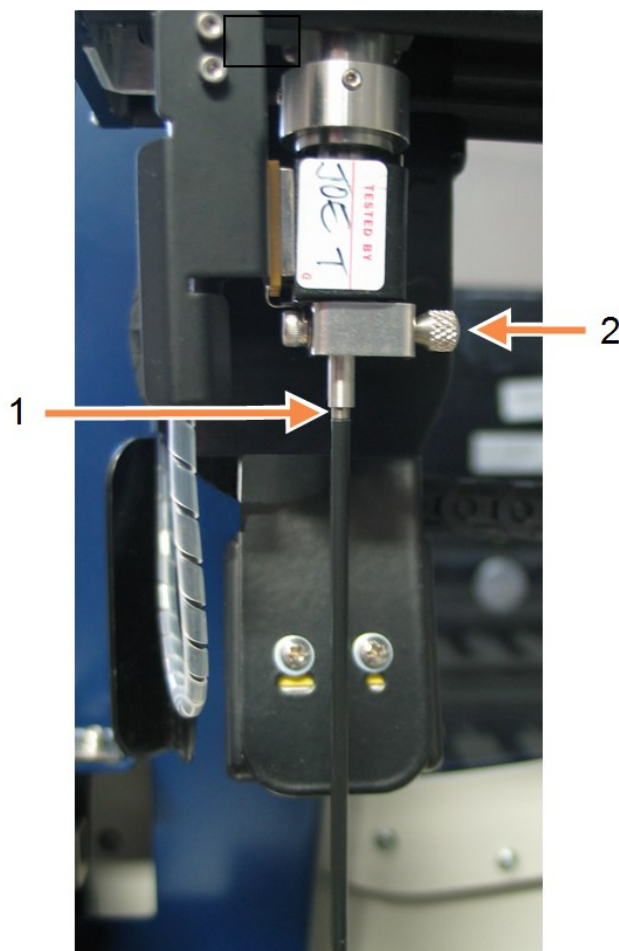

#### Legenda

- 1 2 mm
- 2 śruba radełkowana

Postać 12-12: Regulacja sondy aspiracyjnej

Zamontować nowy zespół sondy aspiracyjnej w następujący sposób, uważając, aby nie uszkodzić końcówki teflonowej:


1. Upewnić się, że statyw sondy aspiracyjnej jest całkowicie podniesiony.
2. Ostrożnie wyjąć nową sondę aspiracyjną z opakowania ochronnego.
3. Wkładać sondę aspiracyjną przez górną część statywu sondy aspiracyjnej, aż końcówka sondy aspiracyjnej wysunie się z bloku izolatora, a następnie zatrzymać.

W przypadku trudności podczas umieszczania sondy należy sprawdzić, czy śruba radełkowana jest poluzowana i zmienić położenie sondy, aż wsunie się prawidłowo. Użycie siły nie powinno być konieczne.

4. Przytrzymać statyw sondy aspiracyjnej jedną ręką, a drugą ręką chwycić końcówkę sondy aspiracyjnej.  
Powoli, ale stanowczo ciągnąć sondę w dół aż do zatrzymania.  
W górnej części sondy powinien być widoczny odcinek ze stali nierdzewnej o długości około **2 mm** (po prawej), pomiędzy powłoką teflonową na sondzie a przewodem u podstawy bloku izolatora.
5. Wciąż przytrzymując sondę aspiracyjną, dokręcić śrubę radełkowaną z tyłu bloku izolatora (element 4 na [Postać 12-11](#)). Dokręcić palcami.  
Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić sondę aspiracyjną.  
Ostrożnie sprawdzić, czy sondę aspiracyjną można obrócić lub przesunąć w górę lub w dół. Nie powinna się poruszać.  
Spojrzeć na sondę z przodu i z boku, aby upewnić się, że jest ona umieszczona pionowo we wszystkich płaszczyznach. Jeśli sonda nie jest w pozycji pionowej, poluzować śrubę radełkowaną i sprawdzić ponownie, czy sonda jest prawidłowo osadzona. Jeśli sonda nadal nie jest ułożona pionowo, tzn. jest zgięta, wymienić ją na nową.
6. Wkręcić złącze przewodu sondy aspiracyjnej (element 2 na [Postać 12-11](#)) do bloku „łańcuchowego” i dokręcić palcami. Nie dokręcać zbyt mocno.
7. Upewnić się, że statyw sondy aspiracyjnej jest całkowicie podniesiony, a następnie włączyć moduł przetwarzania. Moduł przetwarzania zalewa system podczas uruchamiania – sprawdzić połączenia i końcówkę sondy, aby upewnić się, że podczas zalewania płyn nie wycieka z systemu.
8. Po wymianie sondy aspiracyjnej kliknąć **Yes** (tak) w oknie dialogowym w celu potwierdzenia. W przypadku braku pewności, czy nowa sonda aspiracyjna jest prawidłowo zamontowana, kliknąć **No** (nie) i skontaktować się z działem obsługi klienta.
9. Aby sprawdzić, czy nowa sonda aspiracyjna została prawidłowo zamontowana, należy uruchomić przebieg z udziałem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzić, czy uzyskano odpowiednie wybarwienie.

## 12.7 Blok myjący i stacja mieszania

Stacja mieszania zawiera sześć wnęk do mieszania odczynników. Pasuje jako wkład do bloku myjącego.

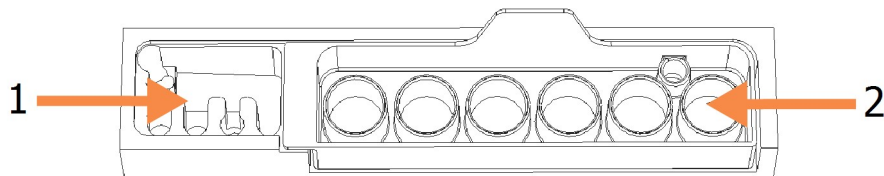

Postać 12-13: Blok myjący z obszarem mycia (1) i stacją mieszania (2), widok z góry



Niektóre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ są niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynności należy odbyć odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa.

Regularnie sprawdzać stację mieszania pod kątem odbarwień i kontrolować jej ogólny stan, a w razie potrzeby wymienić. Wymieniać stację co miesiąc w ramach normalnej konserwacji. Przed wyjęciem stacji należy upewnić się, że wszystkie przebiegi zostały zakończone.

Aby wyjąć stację mieszania, chwycić zakładkę znajdującą się z tyłu stacji mieszania i unieść.

### Czyszczenie stacji mieszania

Stacji mieszania można używać wielokrotnie do czasu comiesięcznej wymiany, pod warunkiem, że nie jest ona uszkodzona lub mocno odbarwiona i że jest ona odpowiednio czyszczona.

1. Jeśli stacja wymaga czyszczenia, moczyć przez co najmniej 30 minut w świeżym roztworze podchlorynu sodu w wodzie dejonizowanej o stężeniu 0.5% m/V.
2. Wyjąć i zanurzyć ponownie w świeżej wodzie dejonizowanej; czynność powtórzyć 10 razy.
3. Namoczyć przez co najmniej 10 minut w alkoholu odczynnikowym.
4. Mieszać przez 30 sekund i wyjąć.
5. Pozostawić do wyschnięcia.

### Czyszczenie bloku myjącego

Raz w tygodniu czyścić blok myjący za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien.



Nie używać patyczków do uszu ani innych aplikatorów z bawełnianą końcówką do czyszczenia otworów w bloku myjącym – końcówka bawełniana może się oderwać i zablokować otwór.

## 12.8 Osłony, drzwi i pokrywy


Osłony, drzwi (jeśli są zamontowane) i pokrywę modułu przetwarzania należy czyścić co tydzień za pomocą odkurzacza lub ściereczki.

Nie używać środków czyszczących; można użyć ściereczki nasączonej wodą do przetarcia osłon, drzwi i pokrywy, aby zapobiec nagromadzeniu się brudu.

Jeśli jakiegokolwiek osłony, drzwi lub pokrywa ulegną zniekształceniu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany.

## 12.9 Czytnik ID

Okno czytnika ID na ramieniu głównego robota musi być utrzymywane w czystości, aby zapewnić prawidłową identyfikację szkiełek. Co tydzień lub jeśli rejestrator często nie wykonuje prawidłowego obrazowania, wyczyścić okno ściereczką niepozostawiającą włókien nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.

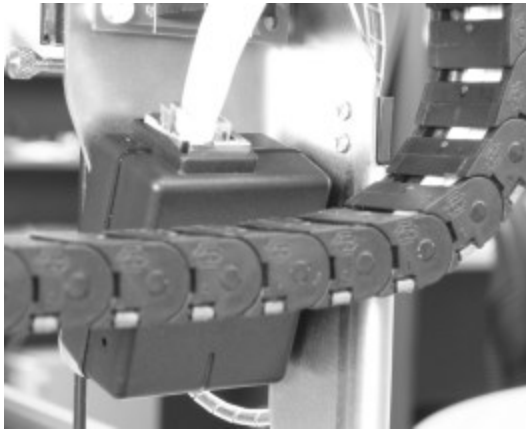

Postać 12-14: Czytnik ID

## 12.10 Tace ociekowe

Tace ociekowe należy czyścić co miesiąc lub częściej, jeśli doszło do rozlania odczynnika lub odpadów. W przypadku stwierdzenia nadmiernego rozlania lub nagromadzenia się soli na tacach należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

- [12.10.1 - Tace ociekowe do pojemników zbiorczych BOND-III](#)
- [12.10.2 - Taca ociekowa urządzenia BOND-III](#)
- [12.10.3 - Taca ociekowa do pojemników zbiorczych BOND-MAX](#)

### 12.10.1 Tace ociekowe do pojemników zbiorczych BOND-III

BOND-III wyposażony jest w dwie tace ociekowe do pojemników zbiorczych znajdujące się pod pojemnikami zbiorczymi na górnym i dolnym poziomie urządzenia.

Aby wyczyścić tace ociekowe do pojemników zbiorczych BOND-III, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania nie działa.
2. Wyjąć wszystkie pojemniki zbiorcze.

3. Zdjąć czarne osłony chroniące czujniki masy każdego pojemnika zbiorczego (zob. [Figure 12-15](#)). Przetrzeć każdą osłonę ściereczką lub gazą nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.



Figure 12-15: Tace ociekowe do pojemników zbiorczych BOND-III z widocznymi osłonami czujników masy

4. Przetrzeć tace ociekowe roztworem alkoholu o stężeniu 70%. Unikać kontaktu z odsłoniętymi metalowymi czujnikami masy.
5. Osuszyć tace ociekowe ręcznikiem papierowym.
6. Przetrzeć wszystkie pojemniki zbiorcze i umieścić je ponownie w odpowiednich pozycjach.

### 12.10.2 Taca ociekowa urządzenia BOND-III

BOND-III posiada trzecią tacę ociekową znajdującą się pod urządzeniem, widoczną na [Postać 12-16](#) poniżej.



Postać 12-16: Taca ociekowa urządzenia BOND-III

Aby uzyskać dostęp do tacy ociekowej urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

1. Zlokalizować tacę ociekową pod urządzeniem (zob. [Postać 12-16](#)) i wyciągnąć tacę. Przytrzymać tacę dwiema rękami, aby zapobiec rozlaniu płynu.
2. Wylać zawartość tacy i usunąć odpady zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.  
**Uwaga:** Taca posiada korytko w tylnym narożniku, które ułatwia wylewanie płynu i zapobiega rozlaniu.
3. Przetrzeć tacę roztworem alkoholu o stężeniu 70%, a następnie włożyć z powrotem w odpowiednie miejsce.

### 12.10.3 Taca ociekowa do pojemników zbiorczych BOND-MAX

BOND-MAX posiada jedną tacę ociekową znajdującą się pod pojemnikami zbiorczymi w przedziale na pojemniki zbiorcze.

Aby wyczyścić tacę ociekową do pojemników zbiorczych, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania nie działa i wyjąć wszystkie pojemniki zbiorcze.
2. Wyciągnąć tacę ociekową i przetrzeć ściereczką lub gazą nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.
3. Osuszyć tacę ociekową papierowym ręcznikiem i włożyć z powrotem w odpowiednie miejsce (zakrzywiona krawędź musi znajdować się z przodu urządzenia).
4. Przetrzeć wszystkie pojemniki zbiorcze i umieścić je ponownie w odpowiednich pozycjach.

## 12.11 Tace na szkiełka

Tace na szkiełka należy raz w miesiącu umyć ciepłą wodą z mydłem i spłukać bieżącą wodą. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że tace na szkiełka są suche. Wymienić zdeformowane lub uszkodzone tace.

## 12.12 Sondy robota odczynników zbiorczych (tylko BOND-III)

Sonda na każdym robocie odczynników zbiorczych wymaga comiesięcznego czyszczenia roztworem alkoholu o stężeniu 70% za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien lub gazika nasączonego alkoholem.

Podczas czyszczenia należy skontrolować sondy pod kątem nieprawidłowości i w razie potrzeby wymienić.

- [12.12.1 - Czyszczenie sond robota odczynników zbiorczych](#)
- [12.12.2 - Wymiana sond robota odczynników zbiorczych](#)

### 12.12.1 Czyszczenie sond robota odczynników zbiorczych

Co miesiąc należy czyścić sondy dozujące robota odczynników zbiorczych, uważając, aby nie zginać sond.




Roboty odczynników zbiorczych przemieszczają się wzdłuż zespołów barwienia szkiełek, zapewniając dostęp do czyszczenia. Procedura ta powinna być wykonywana wyłącznie przez operatorów, którzy zostali ostrzeżeni o potencjalnych zagrożeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.

---

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności i nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów.
2. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
3. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie przycisk **Clean bulk fluid robot probes** (wyczyść sondy robota odczynników zbiorczych).



4. Uważnie przeczytać instrukcje w oknie dialogowym **Clean bulk fluid robot probes** (wyczyść sondy robota odczynników zbiorczych), zablokować wszystkie tace na szkiełka i kliknąć **Yes** (tak), aby kontynuować.

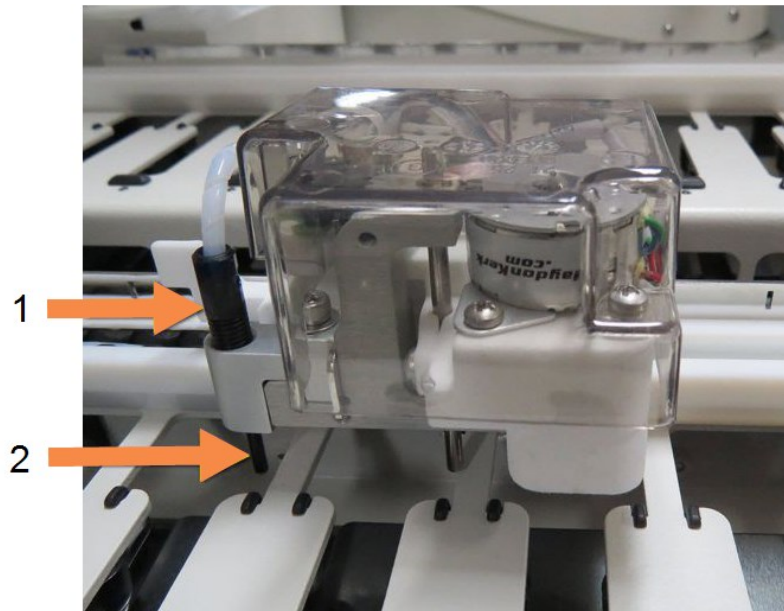

Nr	Nazwa
1	Złącze sondy
2	Sonda

Figure 12-17: Przetrzeć wszystkie trzy sondy robota odczynników zbiorczych roztworem alkoholu o stężeniu 70% (sonda jest wskazana strzałką)

- Gdy wszystkie trzy roboty odczynników zbiorczych przesuną się na przód urządzenia, należy je wyłączyć.
- Delikatnie wyczyścić sondy roztworem alkoholu o stężeniu 70% za pomocą miękkiej ściereczki lub gazika nasączonego alkoholem.  
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zaburzyć prawidłowego ułożenia sond.
- W oknie dialogowym wybrać roboty odczynników zbiorczych, które zostały pomyślnie wyczyszczone, a następnie kliknąć **Done** (gotowe). Jeśli żaden z robotów nie był czyszczony, kliknąć przycisk **None were cleaned** (żaden nie był czyszczony).
- Uruchomić ponownie moduł przetwarzania. Podczas inicjalizacji roboty odczynników zbiorczych wrócą do pozycji wyjściowej z tyłu urządzenia.

## 12.12.2 Wymiana sond robota odczynników zbiorczych

Jeśli preferowana jest wymiana sond robota odczynników zbiorczych przez inżyniera serwisu Leica Biosystems, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Można również wymienić sondy robota odczynników zbiorczych samodzielnie, zgodnie z opisem poniżej.

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności i nie ma załadowanych, zaplanowanych ani trwających przebiegów.
2. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
3. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie przycisk **Replace bulk fluid robot probes** (wymień sondy robota odczynników zbiorczych).
4. Uważnie przeczytać instrukcje w oknie dialogowym **Replace bulk fluid robot probes** (wymień sondy robota odczynników zbiorczych), zablokować wszystkie tace na szkiełka i kliknąć **Yes (tak)**, aby kontynuować.  
Wszystkie trzy roboty odczynników zbiorczych przesuną się do pozycji 10 z przodu urządzenia.
5. Wyłączyć moduł przetwarzania.
6. Odkręcić złącze przewodu sondy, którą należy wymienić i pociągnąć sondę w górę, wyciągając ją z robota odczynników zbiorczych (zob. [Figure 12-17](#)).
7. Włożyć nową sondę do obudowy i dokręcić palcami złącze przewodu sondy.
8. W razie potrzeby powtórzyć czynności dla innych sond.
9. Włączyć moduł przetwarzania. Podczas inicjalizacji roboty odczynników zbiorczych wrócą do pozycji wyjściowej z tyłu urządzenia.
10. Po zakończeniu inicjalizacji pojawi się okno dialogowe. Wybrać sondy robota odczynników zbiorczych, które zostały pomyślnie wymienione, a następnie kliknąć **Done** (gotowe). Jeśli nie wymieniono żadnej strzykawki, kliknąć przycisk **None were replaced** (nie wymieniono żadnej).
11. Aby sprawdzić, czy nowe sondy robota odczynników zbiorczych zostały prawidłowo zamontowane, należy uruchomić przebieg z udziałem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzić, czy uzyskano odpowiednie wybarwienie.

## 12.13 Strzykawki

Oprogramowanie BOND informuje o konieczności wymiany strzykawki (BOND-MAX) lub strzykawek (BOND-III) co sześć miesięcy lub po przetworzeniu 7800 szkiełek, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej (zob. [5.1.2 - Status urządzenia](#)).



Strzykawki, zwłaszcza w górnej części i pod trzpieniem, należy sprawdzać pod kątem wycieków raz w tygodniu podczas inicjalizacji lub podczas procedury czyszczenia układu płynów (zob. [12.5 - Ponowne uruchamianie modułu przetwarzania](#)). Dodatkowo sprawdzić podłączone przewody i złącza. Wymienić w razie jakichkolwiek wycieków.

Jeśli preferowana jest wymiana strzykawek przez inżyniera serwisu Leica Biosystems, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Można również wymienić strzykawki samodzielnie, zgodnie z opisem poniżej.



Zawsze nosić odzież ochronną i rękawice ochronne.


- [12.13.1 - Wymiana BOND-III strzykawek](#)
- [12.13.2 - Wymiana strzykawki 9-portowej BOND-MAX](#)

### 12.13.1 Wymiana BOND-III strzykawek

Wszystkie strzykawki należy wymieniać w tym samym czasie, chyba że wymiana dotyczy pojedynczej uszkodzonej strzykawki, która była niedawno wymieniana.

1. Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie beczynności (nie ma załadowanych ani zaplanowanych przebiegów).
2. W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
3. Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie kliknąć przycisk **Replace syringe** (wymień strzykawkę).
4. Przeczytać instrukcje i kliknąć **Yes** (tak).

Moduł przetwarzania usuwa płyn ze wszystkich strzykawek i umieszcza je w odpowiedniej pozycji umożliwiającej wymianę (może to potrwać do 10 minut). Poczekać na odłączenie modułu

przetwarzania , a następnie wyłączyć moduł. Nie wyłączać kontrolera (lub terminala w przypadku BOND-ADVANCE).



Przed wykonaniem dalszych czynności upewnić się, że moduł przetwarzania jest wyłączony.

5. Odkręcić cztery śruby z gniazdem sześciokątnym mocujące pokrywę modułu strzykawki, używając dołączonego klucza imbusowego 3mm. Zdjąć osłonę.
6. Dla każdej strzykawki oddzielnie poluzować śrubę radełkowaną zacisku strzykawki i obniżyć zacisk.

- Wyjąć śrubę blokującą u dołu trzpienia za pomocą dołączonego klucza imbusowego 2.5 mm.

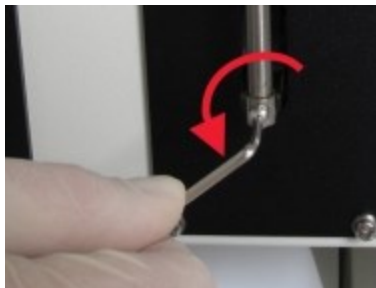


Figure 12-18: Odkręcanie śruby blokującej trzpień za pomocą klucza imbusowego


Niektóre modele mają śrubę radełkowaną zamiast śruby z gniazdem sześciokątnym.

- Odkręcić tuleję strzykawki od zaworu. Wyjąć strzykawkę i zacisk z urządzenia.
- Włożyć nową strzykawkę przez zacisk.
- Umieścić strzykawkę i zacisk na urządzeniu – przykręcić strzykawkę do zaworu.
- Założyć ponownie śrubę blokującą trzpień i dokręcić.
- Podnieść zacisk do górnej części strzykawki i dokręcić śrubę radełkowaną.
- Zamocować osłonę modułu strzykawki i zabezpieczyć za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.
- W oknie dialogowym wybrać strzykawki, które zostały pomyślnie wymienione, a następnie kliknąć **Done** (gotowe). Jeśli nie wymieniono żadnej strzykawki, kliknąć przycisk **None were replaced** (nie wymieniono żadnej).
- Uruchomić ponownie moduł przetwarzania.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków podczas inicjalizacji modułu przetwarzania, zwłaszcza w górnych częściach strzykawk i pod trzpieniami. Wszelkie wycieki należy zgłaszać do działu obsługi klienta.
- Aby sprawdzić, czy nowe strzykawki zostały prawidłowo zamontowane, należy uruchomić przebieg z udziałem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzić, czy uzyskano odpowiednie wybarwienie.

### 12.13.2 Wymiana strzykawki 9-portowej BOND-MAX

- Upewnić się, że moduł przetwarzania jest w stanie bezczynności (nie ma załadowanych ani zaplanowanych przebiegów).
- W przypadku klienta klinicznego należy wybrać kartę modułu przetwarzania, aby wyświetlić ekran **System status** (stan systemu).
- Kliknąć kartę **Maintenance** (konserwacja), a następnie kliknąć przycisk **Replace syringe** (wymień strzykawkę).
- Przeczytać instrukcje i kliknąć **Yes** (tak).

Moduł przetwarzania usuwa płyn ze strzykawki i umieszcza ją w odpowiedniej pozycji umożliwiającej

wymianę. Poczekać na odłączenie modułu przetwarzania , a następnie wyłączyć moduł. Nie wyłączać kontrolera (lub terminala w przypadku BOND-ADVANCE).



Przed wykonaniem dalszych czynności upewnić się, że moduł przetwarzania jest wyłączony.

5. Poluzować śrubę radełkowaną zacisku strzykawki i obniżyć zacisk.
6. Wyjąć śrubę blokującą u dołu trzpienia za pomocą klucza imbusowego.



Figure 12-19: Odkręcanie śruby blokującej trzpień za pomocą klucza imbusowego

Niektóre modele mają śrubę radełkowaną zamiast śruby z gniazdem sześciokątnym.

7. Odkręcić tuleję strzykawki od zaworu. Wyjąć strzykawkę i zacisk z urządzenia.
8. Włożyć nową strzykawkę przez zacisk.
9. Umieścić strzykawkę i zacisk na urządzeniu – przykręcić strzykawkę do zaworu.
10. Założyć ponownie śrubę blokującą trzpień i dokręcić.
11. Podnieść zacisk do górnej części strzykawki i dokręcić śrubę radełkowaną.
12. W oknie dialogowym kliknąć **Yes** (tak), aby potwierdzić, że strzykawkę została pomyślnie wymieniona.
13. Uruchomić ponownie moduł przetwarzania.
14. Sprawdzić, czy nie ma wycieków podczas inicjalizacji modułu przetwarzania, zwłaszcza w górnej części strzykawki i pod trzpieniem. Wszelkie wycieki należy zgłaszać do działu obsługi klienta.
15. Aby sprawdzić, czy nowa strzykawkę została prawidłowo zamontowana, należy uruchomić przebieg z udziałem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzić, czy uzyskano odpowiednie wybarwienie.

## 12.14 Bezpieczniki zasilania

Wszystkie urządzenia BOND-III i BOND-MAX są wyposażone w dwa bezpieczniki sieciowe i dwa bezpieczniki zasilania podgrzewacza; wartości obciążalności różnią się w zależności od zasilania sieciowego. Bezpieczniki umieszczone są na osłonie tylnej (zob. [2.2.13 - Osłona tylna](#)).

BOND-III wykorzystuje następujące bezpieczniki:

Bezpiecznik	Opis	Zasilanie 100–240 V AC
F1	Zasilanie podgrzewacza	3AG T8A 250 V UL
F2	Zasilanie systemu	3AG T8A 250 V UL
F3	Zasilanie sieciowe AC (neutralny)	3AG T15A 250 V UL
F4	Zasilanie sieciowe AC (czynny)	3AG T15A 250 V UL

Moduły przetwarzania BOND-MAX wykorzystują jeden z dwóch różnych zasilaczy. Można je zidentyfikować na podstawie liczby wentylatorów w osłonie tylnej – zasilacze nowego modelu mają dwa wentylatory, natomiast urządzenia ze starszymi zasilaczami mają jeden wentylator. Na osłonie tylnej podano również specyfikacje dotyczące bezpieczników zastępczych.

Moduły przetwarzania BOND-MAX z nowymi zasilaczami (dwa wentylatory w osłonie tylnej):

Bezpiecznik	Opis	Zasilanie 100–240 V AC
F1	Zasilanie sieciowe AC (czynny)	3AG T15A 250 V UL
F2	Zasilanie sieciowe AC (neutralny)	3AG T15A 250 V UL
F3	Zasilanie podgrzewacza 24 V	3AG T8A 250 V UL
F4	Zasilanie 24 V DC	3AG T8A 250 V UL

Moduły przetwarzania BOND-MAX ze starymi zasilaczami (jeden wentylator w osłonie tylnej):

Bezpiecznik	Opis	Zasilanie 100–120 V AC	Zasilanie 200–240 V AC
F1	Zasilanie sieciowe AC (czynny)	3AG T15A 250 V UL	3AG T8A 250 V UL
F2	Zasilanie sieciowe AC (neutralny)	3AG T15A 250 V UL	3AG T8A 250 V UL
F3	Zasilanie podgrzewacza 24 V DC	3AG T8A 250 V UL	3AG T5A 250 V UL
F4	Zasilanie 24 V DC	3AG T8A 250 V UL	3AG T5A 250 V UL



Nie omijać ani nie zwierać bezpieczników.

Przed wymianą bezpieczników wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

Bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na standardowe części. Jeśli bezpieczniki wielokrotnie się przepalają, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Aby wymienić bezpieczniki, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć moduł przetwarzania.
2. Wyłączyć zasilanie sieciowe i wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazda ściennego.
3. Odkręcić osłonę bezpiecznika.
4. Wyciągnąć osłonę bezpiecznika i wymienić bezpiecznik. Upewnić się, że nowy bezpiecznik posiada odpowiednie specyfikacje.
5. Wcisnąć osłonę bezpiecznika i przekręcić w prawo, aby zablokować bezpiecznik w odpowiednim miejscu. Nie dokręcać zbyt mocno.


Strona celowo pozostawiona pusta.



# 13. Czyszczenie i konserwacja (różne urządzenia)

## 13.1 Ręczne skanery kodów kreskowych

### 13.1.1 Skaner kodów kreskowych Symbol

 Instrukcje te dotyczą wyłącznie nowszego skanera kodów kreskowych Symbol. W przypadku korzystania z poprzedniego skanera kodów kreskowych Honeywell należy zapoznać się z informacjami w części [13.1.2 - Skaner kodów kreskowych Honeywell](#).

Skaner ręczny należy czyścić raz w tygodniu:

- Nie dopuszczać do zarysowania okna przez jakiegokolwiek materiały ścierne
- Nie rozpylać wody ani innych płynów czyszczących bezpośrednio na okno
- Nie zdejmować gumowej osłony skanera.

Wyczyścić skaner, wykonując następujące czynności:

1. Najpierw odłączyć skaner od kontrolera lub terminala.
2. Usunąć cząstki brudu wilgotną ściereczką niepozostawiającą włókien.
3. Przetrzeć okno ściereczką niepozostawiającą włókien nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.



Niebezpieczeństwo związane z laserem.

Ręczny skaner kodów kreskowych zawiera urządzenie emitujące promienie laserowe, które mogą spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Nie patrzeć w okno skanera, gdy jest on włączony.

---

### 13.1.1.1 Konfigurowanie skanera kodów kreskowych Symbol

Aby przeprowadzić ponowną inicjalizację skanera kodów kreskowych Symbol (USB), należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować kolejno poniższe kody kreskowe.



Skan 1: Ustawienie wszystkich wartości domyślnych



Skan 2: Aktywacja kodu 128



Skan 3: Opcje skanowania



Skan 4: <DATA><SUFFIX>



Skan 5: Potwierdzenie

Postać 13-1: Sekwencja skanowania kodów kreskowych w celu konfiguracji skanera Symbol

### 13.1.1.2 Ustawianie głośności sygnału dźwiękowego

Aby ustawić głośność sygnału dźwiękowego skanera kodów kreskowych Symbol, należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować poniższy kod kreskowy, który odpowiada żądanej głośności.



Niski poziom głośności



Średni poziom głośności



Wysoki poziom głośności

Postać 13-2: Kody kreskowe do ustawiania głośności sygnału dźwiękowego dla skanera Symbol

## 13.1.2 Skaner kodów kreskowych Honeywell

**i** Instrukcje te dotyczą wyłącznie nowszego skanera kodów kreskowych Honeywell. W przypadku korzystania z poprzedniego skanera kodów kreskowych Symbol należy zapoznać się z informacjami w części [13.1.1 - Skaner kodów kreskowych Symbol](#).

Skaner ręczny należy czyścić raz w tygodniu:

- Nie dopuszczać do zarysowania okna przez jakiegokolwiek materiały ścierne
- Nie rozpylać wody ani innych płynów czyszczących bezpośrednio na okno

Wyczyścić skaner, wykonując następujące czynności:

- Najpierw odłączyć skaner od kontrolera lub terminala.
- Usunąć cząstki brudu zwilżoną wodą ściereczką niepozostawiającą włókien.
- Wyczyścić okno ściereczką niepozostawiającą włókien nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.

Jeśli ręczny skaner kodów kreskowych nie działa prawidłowo, dział serwisu może poprosić o ponowną inicjalizację czytnika. Można również dostosować głośność sygnału dźwiękowego na skanerze.

### 13.1.2.1 Konfigurowanie skanera kodów kreskowych Honeywell


Aby przeprowadzić ponowną inicjalizację skanera kodów kreskowych Honeywell (USB), należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować kody kreskowe w następującej kolejności:



**Skan 1:** Kasowanie niestandardowych ustawień domyślnych



**Skan 2:** Aktywacja ustawień domyślnych

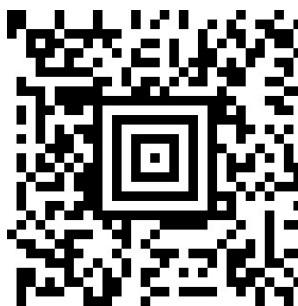

**Skan 3:** Konfiguracja skanera Honeywell

Postać 13-3: Kody kreskowe do konfiguracji skanera

### 13.1.2.2 Ustawianie głośności sygnału dźwiękowego

Aby ustawić głośność sygnału dźwiękowego skanera kodów kreskowych Honeywell, należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować poniższy kod kreskowy, który odpowiada żądanej głośności.




Niski poziom głośności



Średni poziom głośności



Wysoki poziom głośności

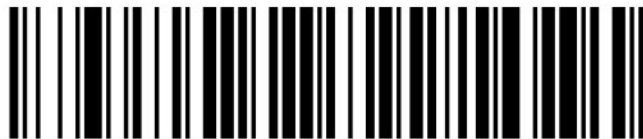

Sygnal dźwiękowy wył.

Postać 13-4: Kody kreskowe do ustawiania głośności sygnału dźwiękowego dla skanera Honeywell

### 13.1.2.3 Konfigurowanie pracy automatycznej

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, działa automatycznie i nie trzeba naciskać przycisku w celu odczytania kodu kreskowego.

Aby włączyć lub wyłączyć pracę automatyczną skanera kodów kreskowych Honeywell, należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować poniższy kod kreskowy, który odpowiada żądanej funkcjonalności.



Praca automatyczna WŁĄCZONA



Praca automatyczna WYŁĄCZONA

Postać 13-5: Kody kreskowe do ustawiania pracy automatycznej skanera Honeywell

### 13.1.3 Ręczny skaner kodów kreskowych Zebra DS2208



- i** Te instrukcje dotyczą tylko późniejszego skanera kodów kreskowych Zebra. Jeśli masz wcześniejszy skaner kodów kreskowych Symbol, zapoznaj się z [13.1.1 - Skaner kodów kreskowych Symbol](#). Jeśli masz skaner kodów kreskowych Honeywell, zapoznaj się z [13.1.2 - Skaner kodów kreskowych Honeywell](#).

Skaner ręczny należy czyścić raz w tygodniu:

- Nie dopuszczać do zarysowania okna przez jakiegokolwiek materiały ściernie
- Nie rozpylać wody ani innych płynów czyszczących bezpośrednio na okno

Wyczyścić skaner, wykonując następujące czynności:

- Najpierw odłączyć skaner od kontrolera lub terminala.
- Usunąć cząstki brudu zwilżoną wodą ściereczką niepozostawiającą włókien.
- Wyczyścić okno ściereczką niepozostawiającą włókien nasączoną roztworem alkoholu o stężeniu 70%.

Jeśli ręczny skaner kodów kreskowych nie działa prawidłowo, dział serwisu może poprosić o ponowną inicjalizację czytnika. Można również dostosować głośność sygnału dźwiękowego na skanerze.

### 13.1.3.1 Konfigurowanie skanera kodów kreskowych Zebra

Aby przeprowadzić ponowną inicjalizację skanera kodów kreskowych Zebra (USB), należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować kolejno poniższe kody kreskowe.

Postać 13-6: Sekwencja skanowania kodów kreskowych do konfiguracji skanera Zebra



**Skan 1:** Ustawienie wszystkich wartości domyślnych



**Skan 2:** Aktywacja kodu 128



**Skan 3:** Opcje skanowania



**Skan 4:** <DATA><SUFFIX>



**Skan 5:** Potwierdzenie



**Skan 6:** Skonfiguruj kodu 128



### 13.1.3.2 Ustawianie głośności sygnału dźwiękowego

Aby ustawić głośność sygnału dźwiękowego skanera kodów kreskowych Zebra, należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować poniższy kod kreskowy, który odpowiada żądanej głośności.

Postać 13-7: Kody kreskowe głośności brzęczyka dla skanera Zebra



Niski poziom głośności



Średni poziom głośności



Wysoki poziom głośności

### 13.1.3.3 Konfigurowanie pracy automatycznej

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, działa automatycznie i nie trzeba naciskać przycisku w celu odczytania kodu kreskowego.

Aby włączyć lub wyłączyć pracę automatyczną skanera kodów kreskowych Zebra, należy wydrukować tę stronę w wysokiej jakości i zeskanować poniższy kod kreskowy, który odpowiada żądanej funkcjonalności.

Postać 13-8: Kody kreskowe do skanera Zebra bez użycia rąk



Praca automatyczna WŁĄCZONA



Praca automatyczna WYŁĄCZONA

## 13.2 Drukarka etykiet do szkiełek

Instrukcje są dostarczane wraz z drukarką etykiet do szkiełek. Informacje dotyczące czyszczenia i umieszczania etykiet i taśm do druku znajdują się w niniejszej instrukcji. Czyścić co miesiąc.

# 14. Korzystanie z odczynników BOND

W tym rozdziale omówiono ogólne zagadnienia naukowe i kliniczne dotyczące barwienia tkanek w systemie BOND.

- [14.1 - Zasady stosowania procedury](#)
- [14.2 - Przygotowanie próbek](#)
- [14.3 - Kontrola jakości](#)
- [14.4 - Interpretacja barwienia](#)
- [14.5 - Ogólne ograniczenia](#)
- [1.1 - Legenda symboli na etykietach](#)
- [14.6 - Bibliografia](#)

## 14.1 Zasady stosowania procedury

Ta część zawiera ogólne informacje na temat IHC i ISH. Znajdują się w niej również opisy systemów detekcji i systemów teranostycznych BOND.

- [14.1.1 - Systemy detekcji BOND](#)
- [14.1.2 - Systemy teranostyczne](#)

### Immunohistochemia (IHC)

Techniki immunohistochemiczne są wykorzystywane do wykrywania określonych antygenów w komórkach lub tkankach od co najmniej 50 lat. Po raz pierwszy zgłoszono wykorzystanie znaczników fluorescencyjnych w 1941 roku <sup>1</sup>. Następnie wprowadzono enzymy, takie jak peroksydaza <sup>2</sup>. Obecnie immunohistochemię wykorzystuje się w celu ułatwienia rozpoznania komórek podczas rutynowego barwienia hematoksyliną i eozyną (H+E). IHC stanowi pomoc w rozpoznawaniu prawidłowych i nieprawidłowych komórek. Metody immunohistochemiczne stały się „standardem opieki” w patologii chirurgicznej, gdy same klasyczne metody leczenia nie przynoszą jednoznacznej diagnozy <sup>3,4</sup>. Jednakże istnieją pewne zastrzeżenia dotyczące odtwarzalności <sup>5</sup> pomimo powszechnego przyjęcia tych metod.

Odczynniki w zautomatyzowanym systemie BOND uwidaczniają antygeny w skrawkach tkanek dzięki technikom immunohistochemicznym. Podsumowując, swoiste przeciwciało pierwszorzędowe wiąże się ze skrawkiem, a następnie odczynniki systemu detekcji BOND wizualizują kompleks.



Diagnostyczny „marker” to odczynnik wykorzystywany do wykrywania określonego antygeny lub miejsca wiązania DNA/RNA w próbce tkanki. Marker jest przeciwciałem pierwszorzędowym w IHC lub sondą w ISH (patrz poniżej).

## Hybrydyzacja in situ (ISH)

Techniki biologii molekularnej w dużym stopniu pogłębiają naszą wiedzę na temat choroby. Hybrydyzacja in situ łączy w sobie zarówno biologię molekularną, jak i histologię, umożliwiając wizualizację DNA lub RNA w kontekście komórkowym. Od momentu pierwszego wprowadzenia kwasu nukleinowego w 1969 roku <sup>6</sup>, udoskonalenia protokołów hybrydyzacji in situ sprawiły, że jest to coraz bardziej cenne narzędzie wykorzystywane w patologii klinicznej i badaniach.

Hybrydyzacja in situ wykorzystuje komplementarność wiązań nukleotydów w DNA lub RNA. Oznakowana sonda kwasu nukleinowego wiąże się ze swoją sekwencją komplementarną w utrwalonej tkance lub próbce komórki. Sonda jest wizualizowana przez zastosowanie przeciwciała przeciwko znacznikowi, a następnie wprowadzenie polimerowych odczynników wykrywających BOND. Zautomatyzowany system i odczynniki BOND to niezawodna i skuteczna alternatywa dla niewygodnej metody ręcznej.

### 14.1.1 Systemy detekcji BOND

Leica Biosystems oferuje szereg systemów detekcji opracowanych specjalnie dla systemu BOND. Najważniejszym spośród nich jest system BOND Polymer Refine Detection™, który zapewnia intensywne barwienie w połączeniu z precyzyjnym obrazem bez stosowania streptawidyny i biotyny.

Poniżej podano dostępne systemy detekcji BOND.

- [14.1.1.1 - BOND Polymer Refine Detection](#)
- [14.1.1.2 - BOND Polymer Refine Red Detection](#)
- [14.1.1.3 - BOND Streptavidin-Biotin Detection \(DAB\)](#)

#### 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

Bazujący na polimerze DAB system BOND, BOND Polymer Refine Detection, zapewnia intensywne barwienie w połączeniu z precyzyjnym obrazem wiązania przeciwciała z docelowym antygenem lub wiązania sondy z kwasem nukleinowym. System nie stosuje streptawidyny i biotyny, w związku z tym zostaje wyeliminowane nieswoiste barwienie wynikające z endogennej aktywności biotyny. Endogenna biotyna występuje w niektórych tkankach znajdujących się m.in. w przewodzie pokarmowym, nerkach, wątrobie i guzach piersi. Polimerowe systemy detekcji BOND charakteryzują się większą czułością niż systemy wykrywania wykorzystujące kompleks streptawidyna-biotyna, co przekłada się na niższe stężenie przeciwciał i krótszy czas cyklu.

Czynności wykonywane w tych systemach detekcji:

1. Inkubacja z wykorzystaniem nadtlenu wodoru.
2. Wprowadzenie określonego przeciwciała pierwszorzędowego (w IHC) lub sondy i łączącego przeciwciała pierwszorzędowego (ISH).
3. Inkubacja z wykorzystaniem łączącego przeciwciała drugorzędowego (po pierwszorzędowym).
4. Inkubacja z wykorzystaniem odczynnika polimerowego zawierającego polimer znakowany peroksydazą chrzanową (HRP) skoniugowany z przeciwciałami trzeciorzędowymi.
5. Wizualizacja kompleksu z DAB.
6. Barwienie kontrastowe hematoksyliną umożliwia wykrywanie jąder komórkowych.

Inkubację, mycie i interpretację wyników przeprowadza się zgodnie z instrukcjami dla systemów detekcji wykorzystujących znakowaną streptawidynę-biotynę BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection.



W przypadku gdy pożądane jest uzyskanie większej intensywności, dostępne są następujące opcje dla wszystkich polimerowych systemów detekcji BOND:

- i. Wydłużyć czas inkubacji dla przeciwciała pierwszorzędowego lub sondy i/lub elementów systemu detekcji.
- ii. Użyć roztworu BOND DAB Enhancer. Uwaga: sam roztwór (wzmacniacz) nie zwiększy intensywności barwienia do takiego samego poziomu barwienia, jaki oferuje system detekcji Intense R.
- iii. Tylko w przypadku IHC: zwiększyć stężenie przeciwciał pierwszorzędowych.

#### 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

Dostępny jest jeden system detekcji wykorzystujący chromogen Red: BOND Polymer Refine Red Detection™. Ma takie same zalety jak polimerowe systemy detekcji wykorzystujące DAB, ale do wizualizacji zamiast DAB wykorzystywany jest chromogen Fast Red. System jest przeznaczony do stosowania na tkankach, takich jak skóra, w przypadku których pigmenty tkankowe mogą być mylone z DAB.

System BOND Polymer Refine Red Detection to bardzo czuły system wykorzystujący Compact Polymer™ skoniugowany z fosfatazą alkaliczną, która zapewnia różowoczerwoną barwę podczas immunobarwienia, a także barwienie kontrastowe hematoksyliną (w tym barwienie na niebiesko).

-  Chromogen Fast Red jest chemicznie niestabilny w normalnych warunkach laboratoryjnych. Należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkownika systemu BOND Polymer Refine Red Detection w celu utrzymania skuteczności chromogenu. Należy zawsze umieszczać tkankę kontrolną na tym samym szkiełku, co tkanka pacjenta, aby umożliwić szybkie wykrycie wszelkich nieprawidłowości w systemie.
-  Zaleca się stosowanie mediów do zaklejania Leica CV Ultra Mounting Media z systemem BOND Polymer Refine Red Detection. Inne media do zaklejania mogą nie zachowywać intensywności barwienia uzyskanej na początku.

Czynności wykonywane w systemie BOND Polymer Refine Red Detection:

1. Wprowadzenie określonego przeciwciała pierwszorzędowego.
2. Inkubacja z użyciem odczynnika drugorzędowego.
3. Inkubacja z wykorzystaniem odczynnika polimerowego zawierającego polimer znakowany fosfatazą alkaliczną (AP) skoniugowany z przeciwciałami trzeciorzędowymi.
4. Wizualizacja kompleksu substrat-chromogen, Fast Red, za pomocą czerwonego osadu.
5. Barwienie kontrastowe hematoksyliną umożliwia wykrywanie jąder komórkowych.

Inkubację, mycie i interpretację wyników przeprowadza się zgodnie z instrukcjami dla systemu detekcji wykorzystującego znakowaną streptawidynę-biotynę BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection.

#### 14.1.1.3 BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

W tej kategorii dostępny jest jeden system detekcji: BOND Intense R Detection.

Ten system detekcji wykorzystujący DAB działa w następujący sposób:

1. Inkubacja z wykorzystaniem nadtlenu wodoru w celu stłumienia aktywności endogennej peroksydazy.
2. Wprowadzenie określonego przeciwciała pierwszorzędowego.
3. Przeciwciała jest lokalizowane przez dostarczony przez użytkownika roztwór zawierający biotynylowane przeciwciała drugorzędowe, który rozpoznaje przeciwciała pierwszorzędowe.

4. Dodanie streptawidyny skoniugowanej z enzymem, która wiąże się z biotyną występującą w przeciwciele drugorzędowym.
5. Wizualizacja kompleksu substrat-chromogen (3,3'-diaminobenzidyna lub DAB), którego produktem enzymatycznym jest brązowy osad.
6. Barwienie kontrastowe hematoksyliną umożliwia wykrywanie jąder komórkowych.

Na każdym etapie system BOND inkubuje skrawki przez dokładnie określony czas, a następnie przepłukuje skrawki w celu usunięcia niezwiązanego materiału. Wyniki są interpretowane przy użyciu mikroskopu optycznego i pomagają w diagnostyce różnicowej procesów patologicznych, które mogą, ale nie muszą być powiązane z określonym antygenem.


### 14.1.2 Systemy teranostyczne

Ze względu na heterogeniczny charakter nowotworu i niestabilność genomyczną występującą w komórkach nowotworowych reakcja pacjenta na szerokie spektrum środków przeciwnowotworowych jest często nieoptymalna. Środki te często wywołują poważne skutki uboczne pogarszające jakość życia pacjenta i mogą również narazić pacjenta na ryzyko poważnych niepożądanych reakcji na lek (ADR).

W przeciwieństwie do tego powstaje wiele nowych terapii przeciwnowotworowych ukierunkowanych na określone biomarkery. Pojawienie się tych celowanych terapii miało znaczący wpływ na badania diagnostyczne oparte na patologii. Ta specjalna klasa badań diagnostycznych określana jest jako „teranostyka”, a testy te pomagają w identyfikacji pacjentów, którzy najprawdopodobniej odniosą korzyści z konkretnych terapii:

Teranostyka = terapia + diagnostyka

Każde urządzenie jest kompletnym systemem służącym do określania obecności docelowego białka lub genu, a tym samym określenia przydatności danej metody leczenia w terapii celowanej. Testy teranostyczne Leica to kompletne, zoptymalizowane systemy z gotowymi do użycia przeciwciałami lub sondami, odczynnikami wykrywającymi, odczynnikami kontrolnymi i w niektórych przypadkach szkiełkami kontrolnymi zapewniającymi pełną kontrolę jakości wyniku diagnostycznego. Urządzenia są oparte na metodologii IHC lub ISH i są zatwierdzone przez odpowiednie regionalne organy regulacyjne do stosowania w identyfikacji pacjentów, dla których dana metoda leczenia może być odpowiednia.

 Do każdego systemu teranostycznego dołączona jest kompletna instrukcja użycia. Należy postępować zgodnie z tą instrukcją w celu skonfigurowania przebiegów teranostycznych. Ze względu na charakter badań teranostycznych niezwykle ważne jest przestrzeganie instrukcji, aby uniknąć nieprawidłowego wyniku testu.

## 14.2 Przygotowanie próbek

W tej części omówiono przygotowanie tkanki do barwienia.

- [14.2.1 - Wymagane materiały](#)
- [14.2.2 - Przygotowanie tkanki](#)
- [14.2.3 - Odparafinowanie i podgrzewanie](#)
- [14.2.4 - Odślonięcie epitopu](#)

### 14.2.1 Wymagane materiały

Do barwienia w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ przy użyciu systemu BOND wymagane są następujące materiały.

### 14.2.1.1 Często stosowane materiały

- Utrwalacz – zalecana formalina buforowana obojętna 10%
- Wosk parafinowy
- Procesor tkankowy i stacja do zatapiania
- Tkanki do dodatniej i ujemnej próby kontrolnej (zob. [14.3 - Kontrola jakości](#))
- Mikrotom
- Szkiełka mikroskopowe z naładowaną powierzchnią (np. Leica BOND Plus)
- Piec suszarniczy
- Alkohol (odczynnikowy\*)
- BOND Dewax Solution
- Woda dejonizowana
- BOND Enzyme Pretreatment Kit
- BOND Slide Labels and Printer Ribbon
- BOND Universal Covertiles
- Roztwór myjący (przygotowany z koncentratu BOND Wash Solution 10X Concentrate)
- Odpowiedni system odczynników BOND
- Medium do zaklejania na bazie żywicy lub na bazie wody
- Szkiełka nakrywkowe



\* Alkohol odczynnikowy zawiera: etanol, w ilości większej lub równej 90% (wag.); izopropanol, nie więcej niż 5% (wag.), metanol, nie więcej niż 5% (wag.).

### 14.2.1.2 Materiały do IHC

Oprócz materiałów wymienionych powyżej, do badań IHC wymagane są również następujące materiały:

- Ujemne odczynniki kontrolne specyficzne dla przeciwciał pierwszorzędowych (zob. [14.3 - Kontrola jakości](#))
- BOND Epitope Retrieval Solution 1
- BOND Epitope Retrieval Solution 2
- Gotowe do użycia przeciwciała pierwszorzędowe BOND lub przeciwciała pierwszorzędowe rozcieńczone w BOND Primary Antibody Diluent w pojemnikach BOND Open Containers, 7 ml lub 30 ml
- Medium do zaklejania na bazie żywicy lub na bazie wody
- Zestaw do miareczkowania, opcjonalny (zob. [14.2.1.4 - Zestaw do miareczkowania](#))

### 14.2.1.3 Materiały do ISH

Oprócz materiałów wymienionych powyżej do badań ISH wymagane są również następujące materiały:

- Sondy ISH
- Przeciwciała antyfluoresceinowe
- Dodatkowo i ujemne sondy kontrolne specyficzne dla ISH (zob. [14.3 - Kontrola jakości](#))

### 14.2.1.4 Zestaw do miareczkowania

Zestaw do miareczkowania BOND składa się z 10 pustych pojemników i 50 wkładów (6 ml). Wykorzystywany jest podczas optymalizacji stężenia przeciwciał pierwszorzędowych w systemie BOND. Można przygotować niewielkie ilości przeciwciał pierwszorzędowych w różnych stężeniach i umieścić je we wkładach. Każdy

pojemnik może pomieścić łącznie 40 ml odczynnika.

Miareczkowanie stężonych przeciwciał można osiągnąć poprzez serię dwukrotnych rozcieńczeń. Poniższa metoda opisuje sposób przygotowania serii rozcieńczeń dla pojedynczego dozowania 150 µl. W każdym wkładzie do pojemnika do miareczkowania pozostanie pewna ilość rozcieńczonego przeciwciała. System BOND zmierzy tę objętość i może ona zostać wykorzystana w dalszych protokołach optymalizacji, jeśli jest to wymagane.

1. Oznaczyć trzy wkłady z odpowiednimi rozcieńczeniami dla każdego przeciwciała.
2. Wykonać rozcieńczenie początkowe w pierwszym wkładzie 1 ml.
3. Dozować 500 µl rozcieńczalnika BOND Primary Antibody Diluent do wkładu 2 i 3.
4. Przenieść 500 µl z wkładu z rozcieńczeniem początkowym do wkładu 2 i delikatnie wymieszać.
5. Przenieść 500 µl z wkładu 2 do wkładu 3 i delikatnie wymieszać.

### 14.2.2 Przygotowanie tkanki

Zalecamy przygotowanie 10-procentowego roztworu formaliny buforowanej obojętnej w ilości odpowiadającej 15–20-krotności objętości tkanki w celu utrwalenia i przygotowania tkanki do barwienia immunohistochemicznego i hybrydyzacji in situ przy użyciu systemu BOND. Utrwalenie można przeprowadzić w temperaturze pokojowej (15–25°C).

W przypadku testu HER2 należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania tkanek American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists <sup>10</sup> lub z lokalnymi wytycznymi i przepisami.

Aby ułatwić cięcie tkanki i zapobiec uszkodzeniu ostrzy mikrotomu, należy odwapnić tkanki kostne przed przystąpieniem do przetwarzania <sup>11,12</sup>.

Amerykańska ustawa o zmianach w zasadach postępowania w laboratoriach klinicznych (US Clinical Laboratory Improvement Act, CLIA) z 1988 r. w części 42 CFR 493.1259(b) określa następujące wymagania: „Laboratorium musi przechowywać barwione szkiełka co najmniej dziesięć lat od daty badania i przechowywać bloki próbek przez co najmniej dwa lata od daty badania”. <sup>13</sup> Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami odnośnie do wymagań obowiązujących w placówce.

Wyciąć skrawki o grubości 3–5 µm i umieścić je na szkiełkach z naładowaną powierzchnią (w przypadku niektórych typów tkanek może być wymagana inna grubość skrawków). W celu wysuszenia tkanki umieścić pozbawione wody szkiełka w piecu suszarniczym w temperaturze 60°C (±5°C) na 10–30 minut lub na noc w temperaturze 37°C. Szkiełka można również podgrzać w modułach przetwarzania BOND-III i BOND-MAX. Przed podgrzaniem szkiełka muszą być pozostawione do wyschnięcia na powietrzu. Więcej szczegółów na temat przygotowania próbek można znaleźć w punktach 13, 14 i 15.


Przymocować etykiety do szkiełek z próbkami i próbkami kontrolnymi zgodnie z opisem w części [4 - Szybkie uruchamianie](#). Procesy odparafinowania, rehydratacji i odsłonięcia epitopu są w pełni zautomatyzowane w systemie BOND.

### 14.2.3 Odparafinowanie i podgrzewanie

W celu przeprowadzenia badania immunohistochemicznego należy najpierw usunąć wosk parafinowy ze skrawków tkanek zatopionych w parafinie i przeprowadzić rehydratację skrawków. Wosk jest usuwany za pomocą BOND Dewax Solution i skrawki są poddawane rehydratacji. System BOND zawiera protokoły odparafinowania, które automatyzują ten proces.

Przed odparafinowaniem system BOND może również podgrzać tkankę, aby lepiej przylegała do szkiełka. Protokoły podgrzewania i odparafinowania systemu BOND automatyzują oba procesy.



 Uwaga: tkankę należy pozostawić do wyschnięcia w celu odparowania wody przed włożeniem do modułu przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX i rozpoczęciem procesu podgrzewania i odparafinowania.

#### 14.2.4 Odsłonięcie epitopu

Utrwalanie tkanek w formalinie powoduje tworzenie wiązań pomiędzy grupami aldehydowymi i aminokwasowymi w tkance, które może spowodować zmienną utratę antygenowości ze względu na efekt maskowania. Formalina tworzy mostki metylenowe, które mogą zmienić ogólny trójwymiarowy kształt epitopu. Niektóre epitopy są wrażliwe na formalinę i wykazują obniżoną immunoreaktywność po utrwaleniu w formalinie, natomiast inne są odporne na jej działanie.

Kwasy nukleinowe są otoczone białkami, dlatego też konieczna jest przepuszczalność tkanki w celu umożliwienia dostępu sondy do sekwencji docelowych.


Odsłonięcie epitopu <sup>7,8</sup> można uzyskać, stosując metodę HIER (odsłonięcie epitopu w podwyższonej temperaturze), wstępną obróbkę enzymatyczną lub połączenie obu metod. HIER jest najczęściej używaną metodą odsłonięcia epitopu w przypadku IHC. Mechanizm HIER nie jest całkowicie zrozumiały.


Hipoteza polega na tym, że ogrzewanie skrawka do wysokiej temperatury w roztworze do odsłaniania epitopu powoduje hydrolizację wiązań utworzonych podczas utrwalania w formalinie. Powoduje to ponowną modyfikację epitopu, dzięki której można go poddać barwieniu immunohistochemicznemu. Ważnymi czynnikami w metodzie HIER są temperatura, czas i pH roztworu do odsłaniania epitopu. Dostępne są dwa różne roztwory do odsłaniania epitopu do użytku w systemie BOND: bufor na bazie cytrynianu i bufor na bazie EDTA.

We wstępnej obróbce enzymatycznej wykorzystywane są enzymy proteolityczne, które niszczą wiązania peptydowe w celu odsłonięcia epitopu/docelowej sekwencji kwasu nukleinowego. Stężenie enzymu i czas inkubacji są proporcjonalne do czasu utrwalania próbki i powinny być odpowiednio zoptymalizowane. Wstępna obróbka enzymatyczna jest odpowiednia tylko dla niektórych epitopów, ale jest często stosowana w protokołach ISH.

### 14.3 Kontrola jakości

Różnice w przetwarzaniu tkanek i procedurach technicznych w laboratorium użytkownika mogą znacząco wpływać na zmienność wyników, dlatego konieczne jest regularne przeprowadzanie kontroli wewnętrznych oprócz procedur opisanych poniżej. Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi i regulacjami. Przydatne mogą być również publikacje „CLIA Compliance Handbook: Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition” <sup>22</sup> oraz wytyczne NCCLS dotyczące IHC <sup>14</sup>.

 Próbkę kontrolną powinny być świeżymi próbkami uzyskanymi w wyniku autopsji/biopsji/zabiegu chirurgicznego, utrwalonymi, przetworzonymi i zatopionymi tak szybko, jak to możliwe i w ten sam sposób, co próbki pacjenta. Taka procedura kontrolna pozwala na monitorowanie wszystkich etapów analizy: od przygotowania tkanki do barwienia.

 Zalecamy umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tych samych szkiełkach, na których umieszczona jest tkanka pacjenta. Więcej informacji znajduje się w części [6.2 - Praca z próbkami kontrolnymi](#).

Zob.

- [14.3.1 - Weryfikacja oznaczenia](#)
- [14.3.2 - Tkanki kontrolne](#)
- [14.3.3 - Ujemne odczynniki kontrolne do IHC](#)

- [14.3.4 - Odczynniki kontrolne do ISH](#)
- [14.3.5 - Zalety kontroli jakości](#)

### 14.3.1 Weryfikacja oznaczenia

Przed pierwszym użyciem przeciwciała, sondy lub systemu barwienia w procedurze diagnostycznej należy zweryfikować swoistość przeciwciała/sondy poprzez testy na szeregu tkanek własnych wykazujących znaną ekspresję dodatnią i ujemną. Dalsze informacje można znaleźć w procedurach opisanych powyżej oraz zaleceniach dotyczących kontroli jakości określonych w programie certyfikacji dla immunohistochemii CAP Certification Program 14 i/lub wytycznych NCCLS dotyczących IHC <sup>14</sup>, a także w lokalnych przepisach i zaleceniach. Powtórzyć te procedury kontroli jakości dla każdej nowej partii przeciwciał lub w przypadku zmiany parametrów testu. Kontrola jakości nie może być wykonywana na pojedynczym, odizolowanym odczynniku, ponieważ dopasowane odczynniki, zgodnie z określonym protokołem testu, muszą zostać przetestowane razem przed użyciem systemu detekcji do celów diagnostycznych. Informacje na temat tkanek odpowiednich do weryfikacji oznaczenia można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania z przeciwciałami pierwszorzędowymi.

Oprócz wyżej wymienionych procedur weryfikacji oznaczenia zaleca się comiesięczne barwienie próbek kontrolnych tkanek dodatnich i porównywanie ich z próbkami kontrolnymi tych samych tkanek barwionych w poprzednim miesiącu. Porównywanie barwionych próbek kontrolnych w odstępach miesięcznych ma na celu monitorowanie stabilności, czułości, swoistości i odtwarzalności testu.

Systemy teranostyczne BOND zawierają wszystkie odpowiednie odczynniki kontrolne i mogą zawierać szkiełka kontrolne systemu niezbędne do przeprowadzania testów. Ważne jest, aby używać dostarczonych próbek kontrolnych dokładnie w taki sposób, jaki określono w instrukcji użycia. Własne próbki kontrolne tkanek (niedostarczone) powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użycia. Procedury własne nie zostały zweryfikowane i nie należy ich stosować – w przeciwnym razie wynik diagnostyki będzie nieprawidłowy.

Wszystkie wymogi kontroli jakości powinny być realizowane zgodnie z przepisami krajowymi lub wymaganiami akredytacyjnymi.

### 14.3.2 Tkanki kontrolne

#### 14.3.2.1 Tkanka do dodatkowej próby kontrolnej

- Wskazuje prawidłowo przygotowane tkanki i odpowiednie techniki barwienia.
- W każdym przebiegu barwienia należy uwzględnić jedną tkankę do dodatkowej próby kontrolnej dla każdego zestawu warunków testu.
- Do zapewnienia optymalnej kontroli jakości i wykrywania niewielkich poziomów degradacji odczynników bardziej odpowiednia jest tkanka o słabej intensywności barwienia niż tkanka o silnym potencjale barwienia <sup>14</sup>.
- Zastosowanie szkiełek z wieloma tkankami wykazującymi silną, średnią i słabą ekspresję antygeny/kwasu nukleinowego zapewnia szeroki zasięg kontroli.
- Jeśli tkanka do dodatkowej próby kontrolnej nie wykaże wyniku dodatniego (barwienia), wyniki testowanych próbek należy uznać za nieprawidłowe.
- Zalecamy, aby zawsze używać systemu BOND z tkanką kontrolną na tym samym szkiełku co próbka tkanki, aby zapewnić optymalną kontrolę jakości.

### 14.3.2.2 Tkanka do ujemnej próby kontrolnej

- Z badać po dodatniej próbie kontrolnej z tkanką dodatnią w celu weryfikacji swoistości znakowania docelowego antygeny przez przeciwciała pierwszorzędowe w IHC lub docelowego kwasu nukleinowego przez sondę w ISH, a także w celu wskazania swoistego barwienia tła (fałszywie dodatniego barwienia).
- Różne rodzaje komórek występujące w większości skrawków tkanek często oferują miejsca kontroli ujemnej, ale użytkownik powinien to zweryfikować.
- Jeśli swoiste barwienie występuje w ujemnej tkance kontrolnej, wyniki próbek pacjenta należy uznać za nieprawidłowe.

### 14.3.3 Ujemne odczynniki kontrolne do IHC

W celu oceny nieswoistego barwienia oraz lepszej interpretacji swoistego barwienia należy użyć ujemnego odczynnika kontrolnego do IHC zamiast przeciwciała pierwszorzędowego na skrawku próbki każdego pacjenta.

- Zalecany idealny odczynnik kontrolny:
  - i. W przypadku przeciwciał monoklonalnych należy użyć przeciwciała o takim samym izotypie, jak ten wytwarzany przez supernatant z hodowli tkankowej, i produkowanego w ten sam sposób, co przeciwciała pierwszorzędowe, ale niereagującego w sposób swoisty z tkankami ludzkimi.  
Rozcieńczyć do tego samego stężenia immunoglobuliny lub białka, jak w przypadku przeciwciała pierwszorzędowego przy użyciu identycznego rozcieńczalnika (BOND Primary Antibody Diluent).  
Jeśli serum płodowe z cieląt jest przechowywane w czystym przeciwciele po przetworzeniu, można również użyć serum płodowego z cieląt o takim samym stężeniu białka, co w przeciwciele pierwszorzędowym rozcieńczonym w tym samym rozcieńczalniku.
  - ii. W przypadku przeciwciał poliklonalnych należy użyć frakcji immunoglobuliny (lub całej surowicy, jeśli jest to właściwe) normalnej lub nieimmunizacyjnej surowicy z tego samego źródła zwierzęcego i o tym samym stężeniu białka, co przeciwciała pierwszorzędowe, przy użyciu identycznego rozcieńczalnika (BOND Primary Antibody Diluent).
- Sam roztwór BOND Primary Antibody Diluent może być stosowany jako mniej pożądana alternatywa dla wcześniej opisanego ujemnego odczynnika kontrolnego.
- Okres inkubacji dla ujemnego odczynnika kontrolnego powinien odpowiadać okresowi inkubacji przeciwciała pierwszorzędowego.
- Należy użyć osobnego szkiełka z ujemnym odczynnikiem kontrolnym dla każdej zastosowanej metody odsłonięcia (również w przypadku braku odsłonięcia) dla danego przeciwciała pierwszorzędowego.
- W przypadku stosowania paneli kilku przeciwciał w skrawkach seryjnych, obszary ujemnego wyniku barwienia dla jednego szkiełka mogą służyć jako próbki kontrolne wykazujące ujemne/nieswoiste wiązanie dla innych przeciwciał.
- Aby odróżnić aktywność endogenną enzymów lub nieswoiste wiązanie enzymów od immunoreaktywności swoistej, należy poddać barwieniu dodatkowe tkanki pacjenta odpowiednio wyłącznie z udziałem kompleksu substrat-chromogen lub enzymu i kompleksu substrat-chromogen.
- System BOND zawiera domyślny ujemny odczynnik kontrolny IHC o nazwie „\*Negative”, który można wybrać jako marker dla dowolnego protokołu IHC. Dozuje BOND Wash (zob. [10.5.2 - Ustawienia przypadków i szkiełek](#)).

## 14.3.4 Odczynniki kontrolne do ISH

### 14.3.4.1 Dodatnie odczynniki kontrolne

Do hybrydyzacji in situ użyć dodatniej sondy kontrolnej.

- Użyć zamiast sondy ze skrawkiem próbki pacjenta, aby uzyskać informacje na temat zachowania kwasów nukleinowych w tkance oraz na temat dostępności kwasów nukleinowych dla sondy.
- Protokół dotyczący dodatniej sondy kontrolnej musi odpowiadać protokołowi dotyczącemu sondy testowej.
- Jeśli sonda do dodatniej próby kontrolnej nie wykazuje wyniku dodatniego (barwienia), wyniki testowanych próbek należy uznać za nieprawidłowe.

### 14.3.4.2 Ujemne odczynniki kontrolne

Do hybrydyzacji in situ użyć ujemnej sondy kontrolnej.

- Protokół dotyczący ujemnej sondy kontrolnej musi odpowiadać protokołowi dotyczącemu sondy testowej.
- Użyć zamiast sondy ze skrawkiem próbki pacjenta w celu oceny nieswoistego barwienia oraz lepszej interpretacji swoistego barwienia.
- Okres inkubacji dla ujemnego odczynnika kontrolnego powinien odpowiadać okresowi inkubacji sondy.
- Należy użyć osobnego szkiełka z ujemnym odczynnikiem kontrolnym dla każdej zastosowanej metody odsłonięcia (również w przypadku braku odsłonięcia) dla danej sondy.
- Aby odróżnić aktywność endogenną enzymów lub nieswoiste wiązanie enzymów od immunoreaktywności swoistej, należy poddać barwieniu dodatkowe tkanki pacjenta odpowiednio wyłącznie z udziałem kompleksu substrat-chromogen lub enzymu i kompleksu substrat-chromogen.

### 14.3.5 Zalety kontroli jakości

Zalety kontroli jakości przedstawiono w tabeli poniżej.

<p><b>Tkanka:</b></p> <p>Utrwalona i przetworzona, tak jak próbka pacjenta</p>	<p><b>Swoiste przeciwciało/sonda</b> z odczynnikami systemu detekcji</p>	<p><b>Dodatni odczynnik kontrolny</b> oraz te same odczynniki systemu detekcji, jak w przypadku swoistego przeciwciała/sondy</p>	<p><b>Ujemny odczynnik kontrolny [ISH] lub nieswoiste przeciwciało lub bufor [IHC]</b> oraz te same odczynniki systemu detekcji, jak w przypadku swoistego przeciwciała/sondy</p>
<p><b>Tkanka do dodatknej próby kontrolnej:</b></p> <p>Tkanka lub komórki zawierające docelową sekwencję antygenu/kwasu nukleinowego, która ma być wykryta (może znajdować się w tkance pacjenta). Idealna próbka kontrolna to tkanka o słabej intensywności barwienia, która jest najbardziej wrażliwa na degradację przeciwciała/kwasu nukleinowego.</p>	<p>Kontrolowanie wszystkich etapów analizy. Weryfikacja odczynnika i procedur używanych do barwienia.</p>		<p>Wykrywanie nieswoistego barwienia tła</p>

<p><b>Tkanka:</b></p> <p>Utrwalona i przetworzona, tak jak próbka pacjenta</p>	<p><b>Swoiste przeciwciało/sonda</b> z odczynnikami systemu detekcji</p>	<p><b>Dodatni odczynnik kontrolny</b> oraz te same odczynniki systemu detekcji, jak w przypadku swoistego przeciwciała/sondy</p>	<p><b>Ujemny odczynnik kontrolny [ISH] lub nieswoiste przeciwciało lub bufor [IHC]</b> oraz te same odczynniki systemu detekcji, jak w przypadku swoistego przeciwciała/sondy</p>
<p><b>Tkanka do ujemnej próby kontrolnej:</b></p> <p>Tkanki lub komórki, które powinny dać wynik ujemny (mogą znajdować się w tkance pacjenta lub tkance dodatniej)</p>	<p>Wykrywanie niezamierzonej reaktywności krzyżowej przeciwciał wobec komórek/składników komórek [IHC]</p> <p>Wykrywanie niezamierzonej hybrydyzacji krzyżowej sondy wobec innych sekwencji kwasu nukleinowego lub komórek/składników komórek [ISH]</p>		<p>Wykrywanie nieswoistego barwienia tła</p>
<p><b>Tkanka pacjenta</b></p>	<p>Wykrywanie swoistego barwienia</p>	<p>Ocena zachowania kwasu nukleinowego/utrwaleni a tkanki i/lub odsłonięcia [ISH]</p>	<p>Wykrywanie nieswoistego barwienia tła</p>

## 14.4 Interpretacja barwienia

Wykwalifikowany patolog, który ma doświadczenie w procedurach immunohistochemicznych i/lub hybrydyzacji in situ, musi ocenić próbki kontrolne i przeprowadzić kwalifikację zabarwionego produktu przed dokonaniem interpretacji wyników.

Swoistość i czułość wykrywania antygenów zależą od wykorzystywanego przeciwciała pierwszorzędowego. Aby zapewnić pożądane barwienie, należy zoptymalizować poszczególne przeciwciała w systemie BOND, określając odpowiedni czas inkubacji i/lub określone stężenie przeciwciała. Niezoptymalizowanie danego przeciwciała może skutkować nieoptymalną detekcją antygeny.

Zob.

- [14.4.1 - Tkanka do dodatniej próby kontrolnej](#)
- [14.4.2 - Tkanka do ujemnej próby kontrolnej](#)
- [14.4.3 - Tkanka pacjenta](#)

### 14.4.1 Tkanka do dodatniej próby kontrolnej

Zbadać tkankę do dodatniej próby kontrolnej na początku, aby upewnić się, że wszystkie odczynniki działają prawidłowo.

W przypadku stosowania systemów opartych na DAB obecność brązowego produktu reakcji z komórkami docelowymi (tetrachlorku 3,3-diaminobenzyny, DAB) oznacza reaktywność (wynik dodatni). W przypadku korzystania z systemów BOND Polymer Red Detection obecność czerwonego produktu reakcji z komórkami docelowymi oznacza reaktywność (wynik dodatni). Jeśli tkanki do dodatniej próby kontrolnej nie wykazują wyniku dodatniego (barwienia), wyniki testowanych próbek należy uznać za nieprawidłowe.

### 14.4.2 Tkanka do ujemnej próby kontrolnej

Przeprowadzić ujemną próbę kontrolną z tkanką ujemną po dodatniej próbie kontrolnej z tkanką dodatnią w celu weryfikacji swoistości znakowania docelowego antygeny/kwasu nukleinowego przez przeciwciała pierwszorzędowe/sondę.

Brak swoistego barwienia w ujemnej tkance kontrolnej potwierdza brak reakcji krzyżowej przeciwciała/sondy z komórkami/składnikami komórek.

Jeśli swoiste barwienie (barwienie fałszywie dodatnie) występuje w ujemnej zewnętrznej tkance kontrolnej, wyniki należy uznać za nieprawidłowe. Barwienie nieswoiste, jeśli występuje, zazwyczaj jest widoczne jako rozproszone. W skrawkach tkanek utrzalonych w zbyt dużej ilości formaliny można również zaobserwować sporadyczne zabarwienie tkanki łącznej. Do interpretacji wyników barwienia należy używać nienaruszonych komórek. Komórki martwicze lub zdegenerowane często barwią się w sposób nieswoisty.

### 14.4.3 Tkanka pacjenta

Zbadać próbki pobrane od pacjenta, które zostały zabarwione przy użyciu przeciwciała pierwszorzędowego/sondy jako ostatnie.

Intensywność barwienia przy wyniku dodatnim powinna być oceniana w kontekście dowolnego barwienia nieswoistego tła ujemnego odczynnika kontrolnego. Podobnie jak w przypadku każdego testu immunohistochemicznego lub hybrydyzacji in situ, ujemny wynik oznacza, że antygen/kwas nukleinowy nie został wykryty, a nie że antygen/kwas nukleinowy nie był obecny w badanych komórkach lub tkankach.

W razie potrzeby należy użyć panelu przeciwciała w celu identyfikacji fałszywie ujemnych reakcji.

## 14.5 Ogólne ograniczenia

- Immunohistochemia i hybrydyzacja in situ to wieloetapowe procesy diagnostyczne wymagające specjalistycznych szkoleń w zakresie doboru odpowiednich odczynników, doboru tkanek, utrwalania i przetwarzania, przygotowania szkiełek oraz interpretacji wyników barwienia.
- Barwienie tkanek zależy od sposobu postępowania z tkanką i jej przetwarzania przed procesem barwienia. Nieprawidłowe utrwalenie, zamrażanie, rozmrażanie, mycie, suszenie, ogrzewanie, wycinanie skrawka lub zanieczyszczenie innymi tkankami lub płynami może skutkować produkcją artefaktów, wychwytywaniem przeciwciał lub fałszywie ujemnymi wynikami. Niespójne wyniki mogą wynikać z różnic w metodach utrwalania i zatapiania lub z wewnętrznych nieprawidłowości w tkance <sup>18</sup>.
- Nadmierne lub niepełne barwienie kontrastowe może negatywnie wpłynąć na interpretację wyników.
- Interpretacja kliniczna wszelkich zabarwień lub ich braku powinna być uzupełniana badaniami morfologicznymi przy użyciu odpowiednich próbek kontrolnych. Przy ocenie, która musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego patologa, należy wziąć pod uwagę historię kliniczną pacjenta i inne testy diagnostyczne.
- Tkanki od osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B i zawierające antygen powierzchniowy tego wirusa (HbsAg) mogą wykazywać niespecyficzne barwienie z udziałem peroksydazy chrzanowej <sup>19</sup>.
- Nieoczekiwane negatywne reakcje w słabo zróżnicowanych nowotworach mogą być spowodowane utratą lub znaczącym zmniejszeniem ekspresji antygeny, lub utratą bądź mutacją w kodowaniu genetycznym dla tego antygeny. Nieoczekiwane barwienie pozytywne w guzach może być spowodowane ekspresją antygeny nietypowego w morfologicznie podobnych komórkach, lub ciągłą obecnością lub pozyskaniem antygeny w nowotworze, który rozwija cechy morfologiczne i immunohistochemiczne związane z inną linią komórkową (rozbieżne zróżnicowanie). Klasyfikacja histopatologiczna guzów nie jest nauką ścisłą, a niektóre raporty dotyczące nieoczekiwanego barwienia mogą być kontrowersyjne.
- Odczynniki mogą wykazywać nieoczekiwane reakcje w uprzednio nieprzetestowanych tkankach. Nie można całkowicie wyeliminować niespodziewanych reakcji nawet w testowanych grupach tkanek ze względu na zmienność biologiczną ekspresji antygeny/kwasu nukleinowego w nowotworach lub innych tkankach patologicznych. W celu zgłoszenia nieoczekiwanej reakcji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub regionalnym biurem Leica Biosystems.

### IHC

- Normalne lub nieimmunizacyjne surowice z tego samego źródła zwierzęcego, co drugorzędowe antysurowice stosowane w procedurach blokowania, mogą powodować fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie wyniki ze względu na autoprzeciwciała lub przeciwciała naturalne.
- Fałszywie dodatnie wyniki w IHC mogą być spowodowane nieimmunologicznym wiązaniem białek lub produktów reakcji z substratem. Mogą one również być spowodowane aktywnością pseudoperoxydazy (erytrocyty), endogennym działaniem peroksydazy (cytochrom C) lub endogenną biotyną (na przykład wątrobę, sutka, mózg, nerki), w zależności od rodzaju immunobarwienia <sup>16</sup>.
- Fałszywie ujemne wyniki w IHC mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym rzeczywistym spadkiem poziomu, utratą lub zmianą strukturalną antygeny podczas „dedyferencjacji” komórek nowotworowych lub zmianami artefaktycznymi podczas utrwalania lub przetwarzania. Podobnie jak w przypadku każdego testu immunohistochemicznego, wynik ujemny oznacza, że antygen nie został wykryty, a nie że antygen był nieobecny w badanych tkankach.



**ISH**

- Wyniki fałszywie dodatnie w ISH mogą być spowodowane reaktywnością krzyżową sondy wobec innych sekwencji kwasów nukleinowych, a także niespecyficznym wiązaniem sondy lub odczynników wykrywających do tkanek lub składników tkanek <sup>18</sup>. W testach należy uwzględnić ujemne próbki kontrolne tkanek i odczynników, aby ułatwić identyfikację fałszywie dodatniego barwienia.
- DNA i RNA są podatne na degradację spowodowaną aktywnością nukleazy <sup>8,19</sup>. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić test dodatniej sondy kontrolnej z tkanką pacjenta równolegle z konkretną sondą i tkanką pacjenta, aby wykryć degradację kwasu nukleinowego. Wybór utrwalacza wpływa na konserwację kwasów nukleinowych; w tym przypadku zaleca się utrwalanie tkanek w formalinie buforowanej obojętnej 10% <sup>19</sup>. Podobnie jak w przypadku każdego testu hybrydyzacji in situ, ujemny wynik oznacza, że kwas nukleinowy nie został wykryty, a nie że kwas nukleinowy nie był obecny w tkankach.

## 14.6 Bibliografia

1. Coons AH et al. Immunological properties of an antibody containing a fluorescent group. *Proc Soc Exp Biol Med* 1941; 47:200-202.
2. Nakane PK i Pierce GB Jr. Enzyme labeled antibodies: Preparations and applications for the localizations of antigens. *J Histochem Cytochem* 1967; 14:929-931.
3. Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H i Brigati J. Special report: Quality control in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1989; 92:836.
4. Nadji M i Morales AR. Immunoperoxidase techniques: a practical approach to tumor diagnosis. ASCP Press, Chicago. 1986.
5. True LD ed. Atlas of Diagnostic Immunohistopathology. Lippincott, Filadelfia. 1990.
6. Gall JG, Pardue ML. Formation of RNA-DNA hybrid molecules in cytological preparation. *Proceedings of the National Academy of the Sciences of the United States of America*. 1969;63:378-383.
7. Shi S-R, Gu J i Taylor CR. Antigen Retrieval Techniques: Immunohistochemistry and Molecular Morphology. Eaton Publishing, Natick. 2000.
8. Miller RT, Swanson PE i Wick MR. Fixation and epitope retrieval in diagnostic immunohistochemistry: a concise review with practical considerations. *Appl Immunohistochem Mol Morphol*. Wrzesień 2000;8(3):228-35.
9. Bancroft JD i Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, Nowy Jork. 1996.
10. Wolff et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. *Arch Pathol Lab Med* 2007; 131:18-43.
11. Kiernan JA. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. Nowy Jork: Pergamon Press. 1981.
12. Sheehan DC. i Hrapchak BB. Theory and Practice of Histotechnology. St. Louis: C.V. Mosby Co. 1980.
13. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163. 28 lutego 1992.
14. O'Leary TJ, Edmonds P, Floyd AD, Mesa-Tejada R, Robinowitz M, Takes PA, Taylor CR. Quality assurance for immunocytochemistry; Proposed guideline. MM4-P. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Wayne, PA. 1997;1-46.
15. Battifora H. Diagnostic uses of antibodies to keratins: a review and immunohistochemical comparison of seven monoclonal and three polyclonal antibodies. *Progress in Surg Path* 6:1-15. eds. Fenoglio-Preiser C, Wolff CM, Rilke F. Field & Wood, Inc., Filadelfia.
16. College of American Pathologists (CAP) Certification Program for Immunohistochemistry. Northfield IL. <http://www.cap.org>
17. Wilkinson DG. The theory and practice of in situ hybridisation. W: Wilkinson DG. (ed.) *In Situ Hybridization A practical approach*. 2nd Edition. Nowy Jork: Oxford University Press, 1998, str.18-20.
18. Nadji M i Morales AR. Immunoperoxidase, part I: the techniques and pitfalls. *Lab Med* 1983; 14:767.
19. Omata M, Liew CT, Ashcavai M i Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: a possible source of error in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1980;73:626.
20. Wilkinson DG. *In situ hybridization: A practical approach*. 2nd Edition. Oxford University Press, Oksford. 1998.
21. Weiss LM, Chen Y. Effects of different fixatives on detection of nucleic acids from paraffin-embedded tissues by in situ hybridization using oligonucleotide probes. *The Journal of Histochemistry and Cytochemistry*. 1991;39(9):1237-1242.

22. Pontius CA, Murphy KA, Novis DA i Hansen AJ. CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory. 2nd Edition. Raporty Washington G-2, Nowy Jork. 2003.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 15. Zarządzanie systemem (kontroler BOND )

## 15.1 BOND System Manager


### 15.1.1 Informacje ogólne


BOND System Manager to narzędzie, które umożliwia łatwe przeglądanie aktualnego statusu podstawowych usług oprogramowania używanych przez system BOND. Umożliwia zatrzymywanie i uruchamianie poszczególnych usług, takich jak Print Spooler lub zatrzymywanie i uruchamianie wszystkich usług.




Nie należy zatrzymywać żadnych usług, ponieważ system BOND nie będzie już wówczas działał prawidłowo.

Jednakże dział obsługi klienta może poprosić o zatrzymanie, a następnie ponowne uruchomienie jednej lub kilku usług w ramach procesu rozwiązywania problemów systemowych.

Aby otworzyć narzędzie BOND System Manager, należy zlokalizować ikonę BOND System Manager  w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie kliknąć ikonę.

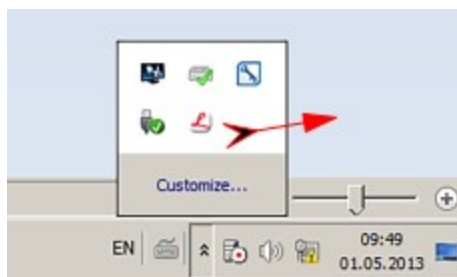


 Ikona może być ukryta; jeśli tak jest, należy kliknąć małą strzałkę w górę, aby ją wyświetlić.


W przypadku pojawienia się błędu systemu BOND, wyświetlony zostanie komunikat z powiadomieniem. Aby ukryć komunikat, należy na niego kliknąć.



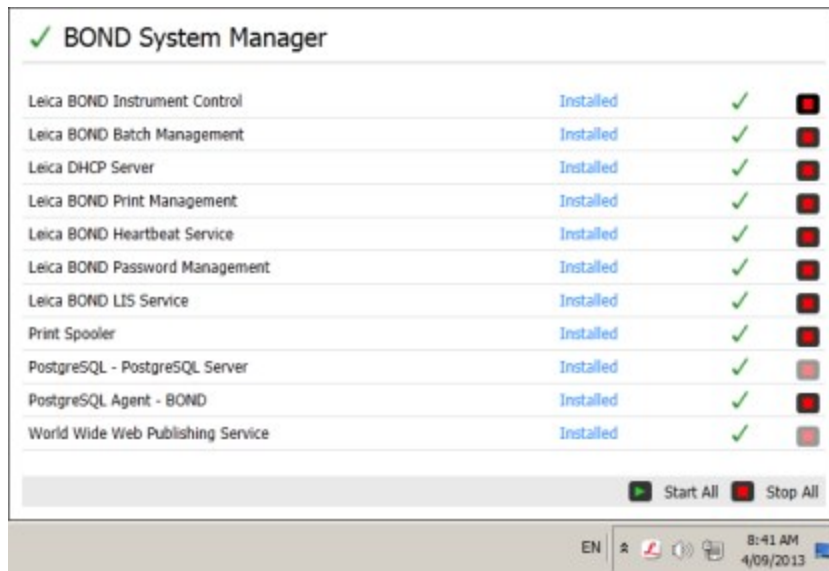

Aby ukryć okno BOND System Manager, ponownie kliknąć ikonę w obszarze powiadomień systemu Windows.

## 15.1.2 Okno BOND System Manager





Postać 15-1: Okno BOND System Manager

 W przypadku błędu systemu BOND ikona BOND System Manager  wskazuje typ błędu:

-  zatrzymanie jednej lub więcej usług (  pojawia się również w lewym górnym rogu ekranu BOND System Manager)
-  nie można połączyć się z systemem BOND (  pojawia się również w lewym górnym rogu ekranu BOND System Manager)


W przypadku instalacji BOND-ADVANCE oznacza to najprawdopodobniej, że:

- Kontroler został wyłączony lub
  - Sieć terminala została odłączona; lub
  - Wyłącznik sieciowy terminala został wyłączony.
-  BOND System Manager jest niedostępny (  pojawia się również w lewym górnym rogu ekranu BOND System Manager)

### 15.1.3 Zatrzymywanie usług

Aby zatrzymać daną usługę, kliknąć czerwony przycisk zatrzymywania z prawej strony nazwy usługi. Można również zatrzymać wszystkie usługi, klikając przycisk **Stop All** (zatrzymaj wszystkie) poniżej listy usług.

Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie chęci zatrzymania usług. Kliknąć **Yes** (tak), aby kontynuować lub **No** (nie), aby anulować.

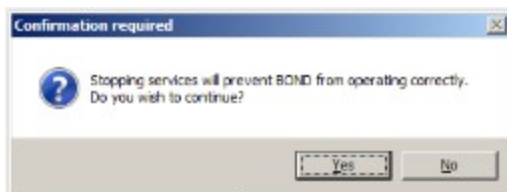

Postać 15-2: Okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie


- ❗ Niektóre usługi nie mogą zostać zatrzymane (PostgreSQL – PostgreSQL Server i World Wide Web Publishing Service), ponieważ BOND System Manager potrzebuje ich do prawidłowego działania. Przyciski zatrzymywania przy tych usługach są nieaktywne.

### 15.1.4 Uruchamianie usług

- ❗ W większości przypadków, gdy usługa zostanie zatrzymana, oprogramowanie BOND automatycznie uruchomi tę usługę ponownie w ciągu kilku minut.

Jeśli system BOND nie działa zgodnie z oczekiwaniami i okaże się, że nastąpiło zatrzymanie jednej lub kilku usług, można użyć narzędzia BOND System Manager, aby uruchomić zatrzymane usługi.



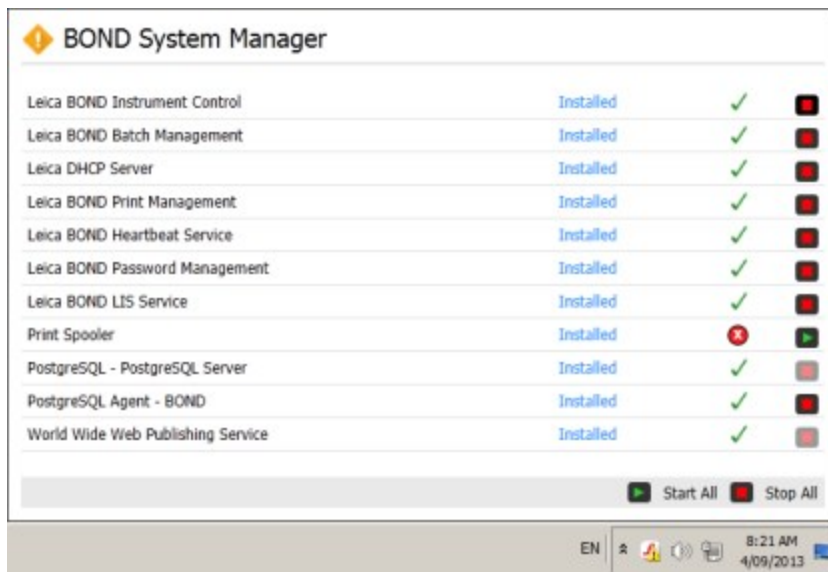


Aby uruchomić daną usługę, kliknąć zielony przycisk uruchamiania z prawej strony nazwy usługi. Można również uruchomić wszystkie usługi, klikając przycisk **Start All** (uruchom wszystkie) poniżej listy usług.



Postać 15-3: BOND System Manager z trójkątem ostrzegawczym (zatrzymanie usługi Print Spooler)

## 15.2 Redundancja dysku twardego


Wszystkie kontrolery i terminale BOND zapewniają redundancję dysku twardego w celu ochrony systemu BOND w przypadku awarii dysku twardego. Ten system zabezpieczeń stale monitoruje dyski twarde systemu, a ikona w obszarze powiadomień systemu Windows pokazuje ich aktualny status.

Ikona	Znaczenie
	<b>Normalna</b> – dyski twarde działają prawidłowo.
	<b>Ostrzeżenie</b> – wystąpił problem z dyskami twardymi systemu. Skontaktować się z działem obsługi klienta.
	<b>Błąd</b> – wystąpiła awaria dysku twardego. Skontaktować się z działem obsługi klienta.
	<p><b>Zajęty</b> – taka ikona może pojawić się w przypadku trwającej weryfikacji dysków twardych, na przykład po nieoczekiwanym wyłączeniu. Kontroler lub terminal mogą działać powoli podczas weryfikacji; zazwyczaj trwa to od 2 do 3 godzin. W tym czasie system BOND może być nieużyteczny.</p> <p>Po weryfikacji ikona powinna powrócić do stanu normalnego i normalne działanie dysków twardych zostanie wznowione. Jeśli jednak ikona wskazuje status ostrzeżenia lub błędu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.</p>
	<b>Usługa nie jest uruchomiona</b> – usługa oprogramowania służąca do monitorowania zabezpieczenia dysku twardego nie jest uruchomiona. Ikona ta pokazuje ten status na początku po uruchomieniu kontrolera lub terminala. Jeśli ikona nie wskaże stanu normalnego po upływie kilku minut, skontaktować się z działem obsługi klienta.



# 16. Działanie BOND-ADVANCE


## 16.1 Ponowne uruchamianie systemu BOND-ADVANCE

 Procedurę tę należy wykonać tylko wtedy, gdy:


- Leica Biosystems dział obsługi klienta zalecił takie działanie lub
- trwają przygotowania do planowanej przerwy w dostawie prądu.

Aby ponownie uruchomić cały system BOND, należy wykonać następujące czynności:


1. Upewnić się, że wszystkie urządzenia są w stanie bezczynności (tj. nie są zablokowane żadne tace na szkiełka).
2. Wyłączyć zasilanie **wszystkich** modułów przetwarzania.
3. Wyłączyć zasilanie **wszystkich** terminali (kliknąć **Start** > **Shut down** (zamknij)).
4. Wyłączyć dodatkowy kontroler (jeśli jest dostępny), naciskając krótko przycisk zasilania (zob. przykład poniżej).
5. Wyłączyć główny kontroler, naciskając krótko przycisk zasilania (zob. [Postać 16-1](#)).

 Przycisk zasilania może znajdować się za zdejmowaną osłoną przednią kontrolera, która może być zablokowana. W takim przypadku należy najpierw uzyskać klucz od upoważnionej osoby.

Podczas zamykania należy obserwować pulpit, ponieważ może być konieczne ponowne naciśnięcie przycisku zasilania, jeśli proces zamykania zatrzyma się na ekranie logowania do systemu Windows. Jeśli tak się stanie, odczekać co najmniej 90 sekund, a następnie krótko nacisnąć ponownie przycisk zasilania.

 Po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania kontroler zacznie proces zamykania. **Nie należy** przytrzymywać przycisku przez dłużej niż 2 sekundy, ponieważ może to spowodować „twardy” reset i natychmiastowe wyłączenie kontrolera. Wyłączenie kontrolera może potrwać do 45 sekund (kontrolka zasilania wyłącza się).

6. Odczekać 2 minuty, a następnie włączyć główny kontroler.  
Jeśli pojawi się okno „Shutdown event tracker” (śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu), zamknąć je, naciskając **Cancel** (anuluj) lub przycisk **<Esc>**.
7. Odczekać 30 sekund, a następnie włączyć dodatkowy kontroler (jeśli jest dostępny).
8. Po całkowitym ponownym uruchomieniu kontrolerów należy włączyć wszystkie terminale.
9. Włączyć wszystkie moduły przetwarzania.
10. Zalogować się do każdego terminala.

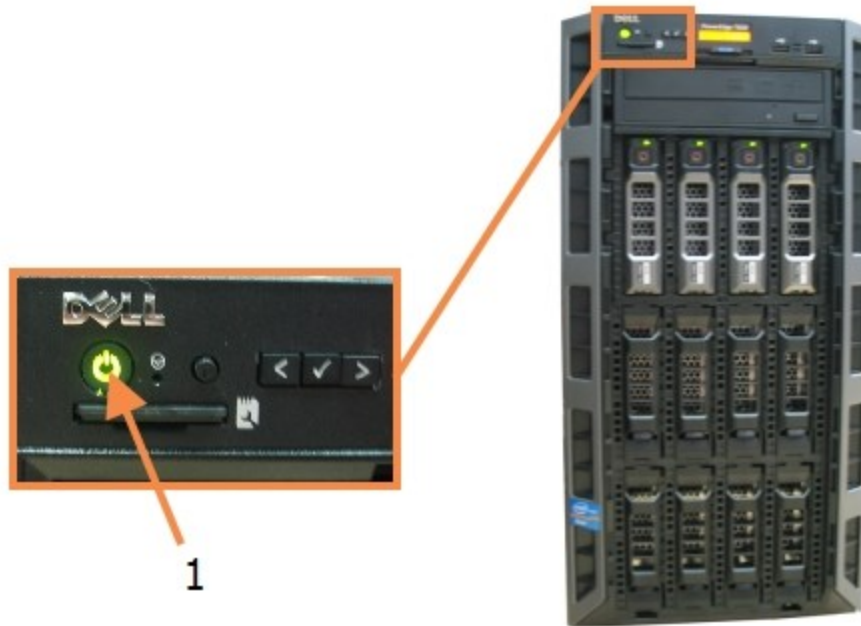

Postać 16-1: Położenie przycisku zasilania na panelu przednim kontrolera (przy zdjętej osłonie)

Nr	Nazwa
1	Przycisk zasilania

## 16.2 Przełączanie na kontroler dodatkowy

**i** Instrukcje te dotyczą wyłącznie systemów BOND-ADVANCE wyposażonych w kontroler dodatkowy (zapasowy). Procedurę tę należy wykonać tylko wtedy, gdy:

- Leica Biosystems dział obsługi klienta zalecił takie działanie lub
- główny kontroler nie działa.

Dodatkowy kontroler będzie działał w trybie autonomicznym, a system nie będzie już posiadał możliwości wykonywania kopii zapasowej. Jednakże po zakończeniu tej procedury system BOND będzie kontynuować przetwarzanie w normalnym trybie.

**i** Podczas procesu przełączania dane z ostatnich 5 minut przetwarzania mogą zostać utracone. Wszystkie komunikaty LIS wysłane podczas procesu przełączania mogą również zostać utracone. Dlatego też po pomyślnym zakończeniu przełączania należy sprawdzić, czy nie brakuje szkiełek. Jeśli brakuje, należy ponownie przesłać dane szkiełek za pomocą systemu LIS lub ręcznie utworzyć brakujące szkiełka w BOND.

1. Zamknąć wszystkie instancje klientów klinicznych i administracyjnych na wszystkich terminalach BOND-ADVANCE.
2. Odłączyć kabel sieciowy terminala od portu oznaczonego **T1 lub T2** na głównym kontrolerze, a następnie ponownie podłączyć kabel do tego samego portu na kontrolerze dodatkowym.  
Zob. [Figure 16-2](#).

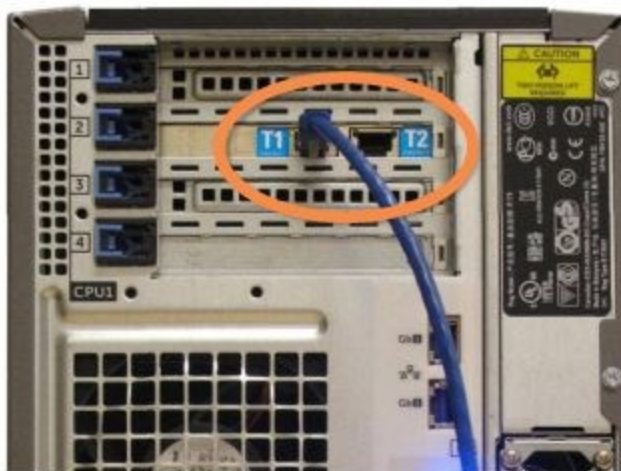


Figure 16-2: Porty terminala na kontrolerze

3. Odłączyć kabel sieciowy urządzenia od portu oznaczonego **I1 lub I2** na głównym kontrolerze, a następnie ponownie podłączyć kabel do tego samego portu na kontrolerze dodatkowym.  
Zob. [Figure 16-3](#).



Figure 16-3: Porty urządzenia na kontrolerze

4. Odłączyć kabel sieciowy mostka (bridge) od portu **B1** lub **B2** na głównym kontrolerze.  
Zob. [Figure 16-4](#).

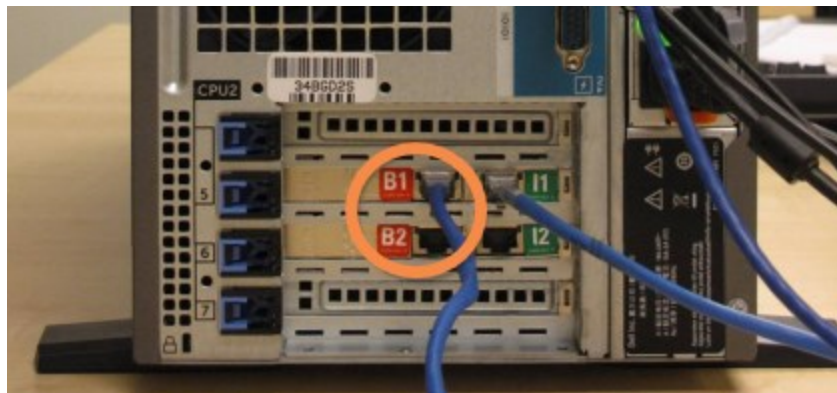


Figure 16-4: Porty mostka na kontrolerze


System BOND-ADVANCE wykrywa podłączenie kabli sieciowych do dodatkowego kontrolera i wyświetla okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie na wszystkich terminalach. Zob. [Figure 16-5](#).



Figure 16-5: Okno dialogowe — podłączono kontroler dodatkowy (zapasowy)

 Przełączenia nie można cofnąć bez pomocy przedstawiciela Leica Biosystems na miejscu.

5. Aby potwierdzić chęć kontynuowania pracy po przełączeniu:
  - i. Wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło w podanych polach.
  - ii. Kliknąć **OK**, aby potwierdzić.

 Jeśli wcześniej inny użytkownik zdecyduje się kontynuować pracę po przełączeniu, powyższe okno dialogowe zniknie.


- Po potwierdzeniu przełączenia należy wyłączyć główny kontroler.
- Poczekać, aż system poinformuje, że przełączenie na tryb autonomiczny powiodło się (zob. [Figure 16-6](#)), a następnie ponownie uruchomić klienta klinicznego i zalogować się do systemu w zwykły sposób.



Figure 16-6: Okno dialogowe – przełączanie na tryb autonomiczny powiodło się

- Natychmiast otworzyć klienta administracyjnego i wykonać ręczną kopię zapasową bazy danych. Zob. [10.5.1 - Ustawienia laboratorium](#).

Po zakończeniu przełączania na kontroler dodatkowy status wszystkich szkiełek i urządzeń powinien zostać automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlał ostatni stan systemu. Jeśli jednak jakiegokolwiek przebiegi zakończyły się w czasie, gdy urządzenia były odłączone od kontrolera, status przebiegów będzie nadal wyświetlany jako **In Progress** (w toku). W takim przypadku należy odblokować odpowiednią tacę na szkiełka, aby zaktualizować status zespołu barwienia szkiełek.

-  Skontaktować się z działem obsługi klienta, aby zlecić serwis odłączonego kontrolera. Konieczna jest naprawa lub wymiana odłączonego kontrolera przez serwisanta Leica Biosystems.

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 17. Wymiana drukarki etykiet do szkiełek

## 17.1 Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie jedno stanowiskowym

Aby wymienić drukarkę Cognitive na nową drukarkę Cognitive, należy wykonać poniższe czynności.

1. Ustawić wyłącznik zasilania z boku starej drukarki w pozycji wyłączenia.
2. Odłączyć kabel USB i kabel zasilający od tylnej części starej drukarki.
3. Podłączyć kabel USB i kabel zasilający do nowej drukarki.
4. Ustawić wyłącznik zasilania z boku nowej drukarki w pozycji włączenia.  
Na ekranie kontrolera BOND wyświetli się komunikat w obszarze powiadomień (po prawej stronie na dole) na pulpicie, na którym znaleziono drukarkę.
5. Przejść do: **Przycisk Start systemu Windows > Devices and Printers** (urządzenia i drukarki) i znaleźć nowo dodaną drukarkę.
6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tę drukarkę i wybrać **Properties** (właściwości), a następnie skopiować nazwę drukarki.
7. Otworzyć klienta administracyjnego, ekran **Hardware configuration** (konfiguracja urządzenia), karta **Slide labelers** (drukarki etykiet do szkiełek) w sposób opisany w części [10.6.3 - Slide Labelers \(drukarki etykiet do szkiełek\)](#). Wybrać starą drukarkę, która została wymieniona.
8. Wkleić (nadpisując istniejącą nazwę) do pola **Printer name** (nazwa drukarki) w celu uzyskania nazwy, na przykład „Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)“.
9. Kliknąć **Save** (zapisz).
10. Wydrukować etykietę testową, aby potwierdzić działanie drukarki.

## 17.2 Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie BOND-ADVANCE


Przed podłączeniem nowej drukarki do systemu BOND-ADVANCE należy ustawić statyczny adres IP nowej drukarki na tę samą wartość co w przypadku poprzedniej drukarki.

Adresy IP drukarek rozpoczynają się od 192.168.5.101. Tylko ostatnia cyfra jest inna dla każdej drukarki. Na przykład adres IP drukarki 2 to 192.168.5.102.

Poniżej podano instrukcje wyjaśniające, jak znaleźć statyczny adres IP poprzedniej drukarki i jak ustawić tę wartość w nowej drukarce.

### Panel przedni drukarki Cognitive


[Postać 17-1](#) przedstawia klawiaturę i wyświetlacz LCD drukarki Cognitive Cxi.

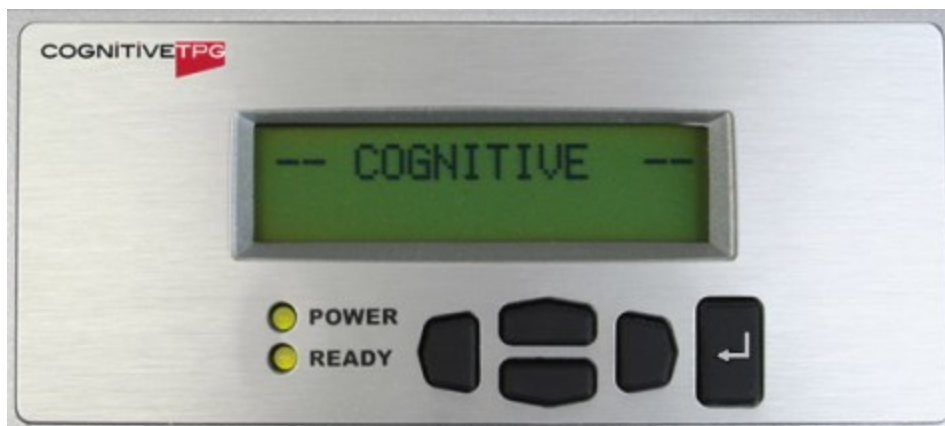







Postać 17-1: Wyświetlacz LCD i klawiatura drukarki Cognitive






### Odczytywanie adresu IP poprzedniej drukarki

Aby odczytać adres IP, który ma być ustawiony na nowej drukarce, należy wykonać poniższe czynności:

 Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć wyświetlacza na starej drukarce, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w części [- Znajdowanie adresu IP drukarki](#), aby znaleźć adres IP na kontrolerze.

1. Nacisnąć .  
Wyświetlony zostanie ekran **Main Menu: (menu główne) Language Menu** (menu językowe).
2. Nacisnąć , aby wyświetlić opcję **Printer Setup** (konfiguracja drukarki).
3. Nacisnąć , aby wyświetlić **Printer Setup (konfiguracja drukarki) Comm. Menu** (menu kom.).
2. Nacisnąć , aby wyświetlić **Comm. Menu: (menu kom.) Timeout** (przekroczenie czasu).
4. Nacisnąć dwukrotnie , aby wyświetlić **Ethernet**.
5. Nacisnąć .  
Na ekranie wyświetli się **Ethernet - DHCP**














6. Nacisnąć .  
Na ekranie wyświetli się **DHCP Off** (DHCP wył.). (Jeśli wyświetla się **DHCP On** (DHCP wł.), nacisnąć , aby zmienić wartość.)
7. Nacisnąć .  
Na ekranie pojawi się komunikat: **Value has been set** (wartość została ustawiona).
8. Nacisnąć , aby wyświetlić **Set Static IP** (ustaw statyczny IP).
9. Nacisnąć , aby wyświetlić bieżące ustawienie.
10. Zanotować statyczny adres IP.
11. Wyłączyć drukarkę i odłączyć ją od zasilania i sieci.

### Ustawianie adresu IP drukarki

Aby ustawić prawidłowy statyczny adres IP nowej drukarki, należy wykonać poniższe czynności.




Nie podłączać nowej drukarki do sieci BOND do czasu wykonania poniższej procedury.

1. Podłączyć nową drukarkę do zasilania i ustawić wyłącznik zasilania z boku drukarki w pozycji włączenia.
2. Nacisnąć .  
Wyświetlony zostanie ekran **Main Menu: (menu główne) Language Menu** (menu językowe).
3. Nacisnąć , aby wyświetlić opcję **Printer Setup** (konfiguracja drukarki).
4. Nacisnąć , aby wyświetlić **Printer Setup (konfiguracja drukarki) Comm. Menu** (menu kom.).
5. Nacisnąć , aby wyświetlić **Comm. Menu: (menu kom.) Timeout** (przekroczenie czasu).
6. Nacisnąć dwukrotnie , aby wyświetlić **Ethernet**.
7. Nacisnąć .  
Na ekranie wyświetli się **Ethernet - DHCP**
8. Nacisnąć .  
Na ekranie wyświetli się **DHCP Off** (DHCP wył.). (Jeśli wyświetla się **DHCP On** (DHCP wł.), nacisnąć , aby zmienić wartość.)
9. Nacisnąć .  
Na ekranie pojawi się komunikat: **Value has been set** (wartość została ustawiona).
10. Nacisnąć , aby wyświetlić **Set Static IP** (ustaw statyczny IP).
11. Nacisnąć , aby wyświetlić bieżące ustawienie.
12. Wprowadzić zanotowany adres IP poprzedniej drukarki. Za pomocą przycisków w lewo i w prawo przesuwaj kursor i zmieniaj wartość, używając przycisków w górę i w dół.

13. Nacisnąć .

Na ekranie pojawi się komunikat: **Value has been set** (wartość została ustawiona).

14. Nacisnąć  kilka razy, aby wrócić do głównego ekranu -- **COGNITIVE--**.

15. Ustawić wyłącznik zasilania z boku drukarki w pozycji OFF (wył.). Następnie przełączyć go z powrotem do pozycji ON (wł.).

16. Podłączyć kabel Ethernet do nowej drukarki, aby podłączyć ją do sieci BOND.




Figure 17-2: Złącze Ethernet

17. Otworzyć klienta administracyjnego i wydrukować etykietę testową.

### Znajdowanie adresu IP drukarki

Jeśli nie jest możliwe odczytanie adresu IP na poprzedniej drukarce, wykonać poniższe czynności, aby określić adres IP dla nowej drukarki.

1. Zalogować się do kontrolera BOND-ADVANCE jako BONDDashboard.
2. Nacisnąć przycisk z logo Windows  + **M**, aby zminimalizować ekran pulpitu.
3. Na pasku zadań systemu Windows kliknąć przycisk **Start** i wybrać **Devices and Printers** (urządzenia i drukarki).
4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę drukarki Cognitive i wybrać **Printer Properties** (właściwości drukarki) w menu podręcznym, jak pokazano na [Figure 17-3](#).

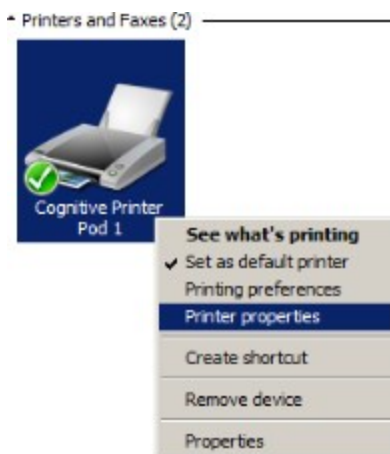


Figure 17-3: Wybieranie właściwości drukarki

System wyświetli okno dialogowe **Properties** (właściwości).

## 17.3 Wymiana drukarki Zebra Printer na drukarkę Cognitive Cxi w systemie jednostanowiskowym

Aby wymienić drukarkę Zebra TLP 3842 lub GX430t na drukarkę Cognitive Cxi, należy wykonać poniższe czynności.



Jeśli drukarka Zebra została podłączona przez kabel „równoległy”, można ją odłączyć od kontrolera BOND. Aby podłączyć drukarkę Cognitive do kontrolera BOND, potrzebny jest kabel USB.

1. Ustawić wyłącznik zasilania z tyłu drukarki Zebra w pozycji wyłączenia.
2. Odłączyć kabel równoległy lub kabel USB i kabel zasilający od tylnej części drukarki.
3. Odłączyć zasilacz drukarki Zebra od zasilania sieciowego.
4. Podłączyć zasilacz drukarki Cognitive do zasilania sieciowego.
5. Podłączyć kabel USB i kabel zasilający do drukarki Cognitive.
6. Ustawić wyłącznik zasilania z boku drukarki w pozycji włączenia.  
Na ekranie kontrolera BOND wyświetli się komunikat w obszarze powiadomień (po prawej stronie na dole) na pulpicie, na którym znaleziono drukarkę.
7. Na pasku zadań systemu Windows kliknąć przycisk **Start** i wybrać **Devices and Printers** (urządzenia i drukarki).
8. Sprawdzić, czy drukarka jest wyświetlana jako „Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT”.
9. Zalogować się do klienta administracyjnego BOND.
10. Przejść do ekranu Hardware (urządzenie), karta Slide labelers (drukarki etykiet do szkiełek).
11. Kliknąć **Add printer** (dodaj drukarkę) (dolny lewy róg ekranu).
12. W panelu po prawej stronie ekranu wprowadzić:
  - **Display name** (nazwa wyświetlana): wpisać nazwę drukarki: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
  - **Printer name** (nazwa drukarki): wpisać ponownie tę samą nazwę
  - **Host name** (nazwa hosta): pozostawić to pole puste.
  - **Printer type** (typ drukarki): wybrać model drukarki: Cognitive Cxi
13. Kliknąć **Save** (zapisz).
14. Kliknąć prawym przyciskiem myszy drukarkę Zebra na liście.
15. Wybrać **Delete** (usuń) z opcji w menu podręcznym.
16. System wyświetli komunikat: „Are you sure you want to delete the printer? (czy na pewno chcesz usunąć drukarkę?)”
17. Kliknąć **Yes** (tak).

Strona celowo pozostawiona pusta.

# 18. Specyfikacje

- [18.1 - System](#)
- [18.2 - Dane fizyczne](#)
- [18.3 - Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i UPS](#)
- [18.4 - Dane środowiskowe](#)
- [18.5 - Dane dotyczące pracy](#)
- [18.6 - Szkiełka mikroskopowe](#)
- [18.7 - Transport i przechowywanie](#)

## 18.1 System

Wymagania dotyczące połączenia sieciowego	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
Kable sieciowe	Kable ekranowane CAT5e lub CAT6 ze złączami RJ-45
Wymagania dotyczące przełącznika Ethernet: Konfiguracja jedno stanowiskowa BOND-ADVANCE	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T 8-portowy przełącznik Ethernet (obsługuje do 5 modułów przetwarzania) 8- lub 16-portowe przełączniki Ethernet (mogą zostać połączone ze sobą w celu obsługi do 30 modułów przetwarzania)
Specyfikacje urządzenia	KKontrolery i terminale BOND muszą być dostarczone przez Leica Biosystems.

## 18.2 Dane fizyczne

	<b>BOND-III</b>	<b>BOND-MAX</b>
Wymiary	Szer. – 790 mm Wys. – 1378 mm Gł. – 806 mm	Szer. – 760 mm Wys. – 703 mm Gł. – 775 mm
Masa (na sucho)	238 kg	120 kg
Wymagania dotyczące odstępów	600 mm nad urządzeniem 0 mm z lewej strony 150 mm z prawej strony 0 mm z tyłu urządzenia, jednakże należy zapewnić możliwość odłączenia przewodu zasilającego bez przemieszczania modułu przetwarzania.	
Maksymalna odległość do zewnętrznego zbiorczego pojemnika na odpady (tylko BOND-MAX)	~	1 metr

## 18.3 Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i UPS

	<b>BOND-III</b>	<b>BOND-MAX</b>
Napięcie robocze (dla urządzeń wyposażonych w zasilacze starszego typu, z jednym wentylatorem w osłonie tylnej)	103.4 V do 127.2 V (dla napięcia znamionowego 110 V do 120 V) lub 206.8 V do 254 V (dla napięcia znamionowego 220 V do 240 V)	
Napięcie robocze (dla urządzeń wyposażonych w zasilacze nowszego typu, z dwoma wentylatorami w osłonie tylnej)	90 V do 264 V (dla napięcia znamionowego 100 V do 240 V)	
Częstotliwość sieci przesyłowej	50/60 Hz	50/60 Hz
Pobór mocy	1200 VA	1000 VA

## 18.4 Dane środowiskowe




	<b>BOND-III</b>	<b>BOND-MAX</b>
Maksymalna temperatura robocza	35°C	35°C
Minimalna temperatura robocza	5°C	5°C
Temperatura konieczna do spełnienia wymagań dotyczących barwienia	18–26°C	18–26°C
Wilgotność robocza (niekondensująca)	30 do 80% RH	30 do 80% RH
Maksymalna wysokość robocza	0 do 1600 m nad poziomem morza	0 do 1600 m nad poziomem morza
Wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego (przy 1 m)	< 85 DbA – maksymalnie < 65 dBA – normalna praca	< 85 DbA – maksymalnie < 65 dBA – normalna praca
Maksymalna moc wyjściowa ogrzewania	1200 VA	1000 VA

## 18.5 Dane dotyczące pracy

	<b>BOND-III</b>	<b>BOND-MAX</b>
Wydajność przetwarzania szkiełek	30 jednocześnie. Gotowe tace (10 szkiełek) można wymieniać ciągle.	
Pojemność pojemnika na odczynniki	7 ml i 30 ml	7 ml i 30 ml
Objętość martwa pojemnika na odczynniki	555 $\mu$ l (7 ml) i 1618 $\mu$ l (30 ml)	
Objętość rezerwowa pojemnika na odczynniki	280 $\mu$ l (7 ml) i 280 $\mu$ l (30 ml)	
Pojemność pojemnika do miareczkowania	6 ml	6 ml
Objętość martwa pojemnika do miareczkowania	300 $\mu$ l	300 $\mu$ l
Objętość rezerwowa pojemnika do miareczkowania	280 $\mu$ l	280 $\mu$ l
Liczba pojemników na odczynniki	36	36
Pojemność zbiorczego pojemnika na odczynniki	2 l lub 5 l	1 l lub 2 l
Pojemność pojemnika na odpady niebezpieczne	5 l	2 l
Pojemność pojemnika na odpady standardowe	2 x 5 l	~
Pojemność zewnętrznego zbiorczego pojemnika na odpady	~	9 l
Zgodność chemiczna	Wszystkie odczynniki BOND Roztwór alkoholu o stężeniu 70% (do czyszczenia)	
Wskaźnik temperatury	Wartości domyślne (mogą zostać zmienione przez serwisantów): Ciepło: 35°C, Gorąco: 80°C	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie dla przyłączy gazu i cieczy	1.0 bar	2.5 bar

## 18.6 Szkiełka mikroskopowe

Wymiary	Szerokość: 24.64–26.0 mm Długość: 74.9–76.0 mm Grubość: 0.8–1.3 mm
Miejsce na etykietę	Szerokość: 24.64–26.0 mm Długość: 16.9–21.0 mm
Materiał	Szkło, ISO 8037/1
Obszar użyteczny	Zob. następujące schematy. Objętość dozowania odnosi się do ustawień, które można wybrać podczas konfiguracji szkiełek przy użyciu oprogramowania BOND (zob. <a href="#">6.3 - Praca z przypadkami</a> ).

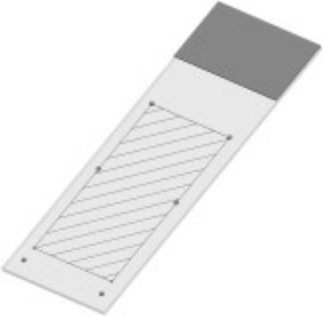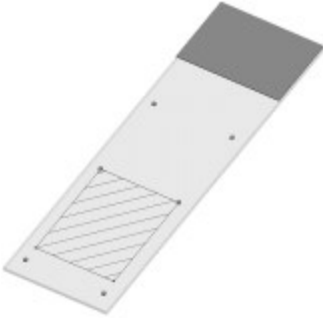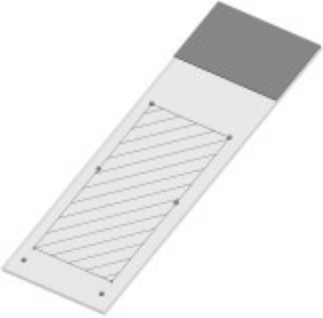	100 $\mu$ l	150 $\mu$ l
BOND-III		
BOND-MAX		

Postać 18-1: Obszary użyteczne szkiełek dla modułów przetwarzania BOND



---

## 18.7 Transport i przechowywanie

Temperatura podczas przechowywania	-20 do +55°C
Wilgotność podczas przechowywania (niekondensująca)	< 80% RH
Metody wysyłki	Możliwość transportu drogą lądową, powietrzną i morską.

Uwaga: powyższe informacje dotyczą wyłącznie zapakowanych urządzeń.

Informacje dotyczące niezapakowanych urządzeń – zob. [18.4 - Dane środowiskowe](#).

Strona celowo pozostawiona pusta.

# Indeks

<b>A</b>	
administrator, rola użytkownika	
opis .....	61
ustawianie .....	206
aktualizacja bazy danych .....	221
aktualizacja oprogramowania .....	70
aktualizowanie bazy danych .....	221
alarmy .....	67
architektura systemu BOND .....	56
automatyczna identyfikacja szkiełek .....	101
<b>B</b>	
barwienie	
interpretacja .....	321
barwienie podwójne .....	146
baza danych .....	70
kopia zapasowa .....	226
bezpieczniki .....	296
bezpieczniki zasilania .....	296
błędy podgrzewacza .....	90
blok myjący .....	39
BOND-ADVANCE, opis .....	58
BOND Aspirating Probe Cleaning System .....	280
BOND Polymer Refine Detection System .....	310
BOND System Manager .....	327
<b>C</b>	
czas wyświetlania przetworzonego przypadku .....	122
czas wyświetlania, przypadek .....	122
czerwony, podświetlenie na ekranie rejestru odczynników .....	182
czyszczenie .....	258
czyszczenie układu płynów, procedura konserwacji .....	279
czynnik ID .....	25
czyszczenie & konserwacja .....	286
<b>D</b>	
dashboard .....	65
dodawanie	
odczynniki .....	174
panel .....	131
przypadek .....	120
szkiełko .....	128
dozowanie sond .....	148
drukarka	
drukarka etykiet do szkiełek .....	48
drukarka etykiet do szkiełek .....	48
czyszczenie i konserwacja .....	293
drukarka, etykiety do szkiełek .....	48
drukowanie etykiet szkiełek .....	134
drukowanie raportów .....	67
duplikowanie kroków dozowania odczynników (w protokole) .....	158
dziennik audytu .....	223
dziennik serwisowy .....	70
dziennik, serwisowy .....	70
<b>E</b>	
ekran konserwacji .....	112
ekran rejestru, odczynniki .....	177

ekrany statusu .....	85	historia szkiełek .....	191
LIS .....	247	definiowanie przedziału czasu .....	193
pojemniki zbiorcze .....	95	ekran .....	191
protokół .....	111		
status odczynników .....	92	<b>I</b>	
status szkiełek .....	98	ID etykiety .....	136
status urządzenia .....	89	ID przypadku	
system .....	86	LIS, duplikat .....	211
eksport danych szkiełka .....	201	vs, numer przypadku .....	120
eksportowanie raportów .....	67	ID szkiełka .....	136
etykieta		identyfikacja szkiełek	
drukowanie .....	134	automatyczna .....	101
i LIS [etykieta		ręczna identyfikacja w urządzeniu .....	102
LIS] 254		ręcznie .....	130
informacje ogólne .....	134	IHC, zasada .....	309
konfiguracja .....	212	informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	iii
szybkie uruchamianie .....	77	informacje prawne .....	xi
typy informacji .....	218	instalacja jedno stanowiskowa .....	56
etykiety szkiełek, zob. etykieta .....	134	instalacja wielo stanowiskowa .....	56, 58
		ISH, zasada .....	310
<b>G</b>			
grupa		<b>K</b>	
opis .....	57-58	karty, moduł przetwarzania, na ekranie	
zarządzanie .....	231	stanu systemu .....	87
grupa robocza .....	58	klient administracyjny .....	205
		kończenie przebiegu .....	83
<b>H</b>		konfiguracja laboratorium .....	224
harmonogram		konfiguracja urządzenia .....	228
czyszczenie & konserwacja .....	259	konfigurowanie	
harmonogram czyszczenia .....	259	odczynniki .....	79
harmonogram konserwacji .....	259	szkiełka .....	74
hasło, BOND .....	208	konfigurowanie systemu BOND .....	205
		konserwacja .....	258

konserwacja zapobiegawcza .....	258	stany .....	88
konserwacja, zapobiegawcza .....	258	transport & przechowywanie .....	347
kontrola jakości .....	315		
zalety .....	319	<b>N</b>	
kontrole		nazwa użytkownika .....	208
odczynniki do ISH .....	318	nazwy publiczne markerów .....	248
praca z .....	117	niezgodne szkiełka .....	101
tkanka .....	316	<b>O</b>	
ujemny odczynnik kontrolny do IHC .....	317	o systemie BOND, okno dialogowe .....	69
kontroler BOND .....	56	objętość dozowania .....	131
kontroler, zob. kontroler BOND .....	56	objętość martwa .....	38
kopia zapasowa bazy danych .....	226	OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) .....	101
kroki dozowania odczynników (w protokole)		odczynnik .....	167
duplikacja .....	158	dodawanie/edytowanie .....	174
<b>Ł</b>		ekran konfiguracji .....	172
ładowanie szkiełek .....	77	ekran paneli .....	189
<b>L</b>		ekran rejestru .....	177
licencja, LIS-ip .....	211	identyfikacja .....	170
lista lekarzy .....	125	identyfikacja ręczna .....	186
LLS (czujnik poziomu cieczy) .....	180	ładowanie .....	79
<b>M</b>		określanie objętości .....	180
metody barwienia .....	146	ponowne napełnienie otwartego pojemnika .....	183
moduł przetwarzania		pusty pakiet .....	183
czyszczenie & konserwacja .....	258	raport dot. rejestru .....	187
inicjalizacja .....	24	raport dot. użycia .....	188
karty .....	87	rejestrowanie .....	184
konfiguracja .....	228	rozwiązywanie problemów .....	94
opis .....	18	usuwanie .....	176
ponowne uruchomienie .....	278	zarządzanie .....	167
specyfikacje .....	343	zastępowanie .....	171
		odpady niebezpieczne .....	175

odparafinowanie .....	135, 314	przypadek & dane szkiełka .....	252
odsłanianie .....	315	przypadki .....	247
odsłonięcie epitopu .....	135	szkiełka .....	248
opcja przypadku dziennego .....	124	szkiełka priorytetowe .....	249
operator, rola użytkownika		terminologia .....	246
opis .....	61	właściwości LIS .....	249
ustawianie .....	206	panel	
opóźnione uruchomienie .....	110	dodawanie .....	131
oprogramowanie		edytowanie .....	190
aktualizacje .....	70	ekran .....	189
informacje ogólne .....	55	tworzenie .....	189
uruchamianie .....	59	pasek funkcji .....	61
wyłączanie .....	59	PDF, raporty .....	67
osłona przednia .....	28	pierwsze kroki .....	11
osłona tylna, opis .....	44	placówka, konfiguracja .....	224
osłony		płyta górna, wymiana .....	275
czyszczenie .....	285	podgrzewacze .....	27
ostrzeżenia .....	67	podgrzewanie .....	314
oświadczenie dotyczące przeznaczenia .....	i	podsumowanie przetwarzania szkiełek .....	200
otwarte pojemniki .....	52	pojemnik na odpady	
ponowne napełnienie .....	183	czyszczenie & konserwacja .....	269
		opis .....	53
		status .....	95
		pojemniki do miareczkowania .....	52
		pojemniki zbiorcze .....	31
		czyszczenie & konserwacja .....	263
		status .....	95
		wyłączanie .....	230
		pokrywa .....	24
		czyszczenie .....	285
		poła danych szkiełek LIS .....	211
		poła danych, szkiełko LIS .....	211

**P**

Pomoc .....	68	przypadek & domyślne ustawienia szkiełek .....	225
dostęp .....	10	przypadek, którego termin ważności	
ponowne napełnienie otwartego pojemnika .....	183	upłynął .....	121
powiadomienia .....	67	przypadki	
poziom dostępu, zob. rola użytkownika .....	61, 206	dodawanie .....	120
protokół .....	145	duplikacja .....	121
barwienie .....	164	edytowanie .....	123
barwienie wstępne .....	166	identyfikacja .....	120
edytowanie .....	156, 221	kopiowanie .....	123
edytowanie procedury barwienia		LIS .....	247
podwójnego .....	149	przywracanie .....	121
ekran konfiguracji .....	145	termin ważności .....	121-122
ekran statusu .....	111	tworzenie ręczne .....	138
importowanie .....	161	ustawienia domyślne .....	225
informacje ogólne o uruchamianiu .....	12	usuwanie .....	123
kończenie przebiegu .....	83	wprowadzanie szczegółów, szybkie	
lista .....	150, 209	uruchamianie .....	74
lista wstępnie zdefiniowanych		przywracanie bazy danych .....	226
protokołów .....	164	przywróć	
nowy .....	155	przypadek BOND .....	121
przygotowanie .....	166	przypadek LIS .....	211
raporty .....	163	pusty, oznaczanie pakietu odczynnika jako .....	183
segment dla odczynników, opis .....	156		
uruchamianie .....	82	<b>R</b>	
wyświetlanie .....	152	raport dot. konserwacji .....	113
przebieg pracy		raporty .....	67
opcja przypadku dziennego .....	124	eksport szkiełek .....	201
ręczne tworzenie slajdów i przypadków .....	138	konfiguracja szkiełek .....	137
przełożony, rola użytkownika		krótka historia szkiełek .....	203
opis .....	61	podsumowanie przetwarzania szkiełek .....	200
ustawianie .....	206	protokół .....	163
przygotowanie tkanki .....	314	przypadek .....	197
		system .....	69

szegóły przebiegu .....	196	segment, odczynnik, w protokole, opis .....	156
użycie odczynnika .....	188	sekwencyjne barwienie podwójne .....	146
zdarzenia podczas przebiegu .....	195	skaner ID, ręczny	
ręczna identyfikacja szkiełek .....	130	rejestrwanie odczynników .....	185
ręczne tworzenie slajdów i przypadków .....	138	skaner kodów kreskowych, ręczny	
ręczny skaner kodów kreskowych		opis .....	47
opis .....	47	skaner kodów kreskowych, zob. ręczny	
rejestrwanie systemu detekcji .....	184	skaner kodów kreskowych .....	184
Ręczny skaner kodów kreskowych Zebra		skaner, ręczny	
DS2208 .....	305	opis .....	47
Red, system detekcji .....	311	rejestrwanie systemu detekcji .....	184
rejestrwanie odczynników i systemów		sonda aspiracyjna	
detekcji .....	184	czyszczenie .....	280
robot		opis .....	38
czyszczenie robota głównego &		wymiana .....	281
konserwacja .....	286	sondy odczynników zbiorczych	
główny robot i czytnik ID .....	25	czyszczenie .....	290
odczynnik zbiorczy .....	40	sondy robota odczynników zbiorczych	
szyna prowadząca robota odczynników		wymiana .....	292
zbiorczych .....	40	specyfikacje	
roboty odczynników zbiorczych, opis .....	40	moduł przetwarzania .....	343
role użytkownika .....	61	system BOND .....	343
ustawianie .....	206	szklane szkiełka .....	346
role, użytkownik .....	61	stacja mieszania .....	39
ustawianie .....	206	starsze raporty .....	68
równoczesne barwienie podwójne .....	146	status odczynników .....	92
		status urządzenia .....	89
		strzykawka .....	42
		czyszczenie & konserwacja .....	293
		system	
		architektura .....	56
		ekran statusu .....	86

## S



opis .....	16	ładowanie .....	77
raport .....	69	miejsce dozowania odczynnika .....	131
specyfikacje .....	343	niezgodne .....	101
system BOND .....	16	odparafinowanie szkiełek .....	135
system detekcji streptawidyny-biotyny BOND .....	311	raport dot. konfiguracji .....	137
system oświetlenia pojemnika zbiorczego ...	34	status po zakończeniu obrazowania .....	98
systemy detekcji		tworzenie ręczne .....	138
BOND Polymer Refine .....	310	ustawienia domyślne .....	225
BOND Polymer Refine Red .....	311	usuwanie .....	130
BOND, informacje ogólne .....	310	wprowadzanie szczegółów, szybkie uruchamianie .....	75
opis .....	52	zgodność .....	143
raport dot. rejestru .....	187	szklane szkiełka	
rejestrwanie .....	184	specyfikacje .....	346
streptawidyna-biotyna BOND .....	311	szybkie uruchamianie .....	71
szablon, etykieta .....	212		
szkiełka nakrywkowe Covertile .....	49	<b>T</b>	
czyszczenie & konserwacja .....	271	tabele, sortowanie .....	64
szkiełka priorytetowe, LIS .....	249	tace na odczynniki	
szkiełka, typy i wymiary .....	48	opis .....	51
szkiełko		tace na szkiełka .....	50
automatyczna identyfikacja .....	101	tace ociekowe .....	287
dodawanie .....	128	pojemnik zbiorczy .....	287
edytowanie .....	130	taca urządzenia .....	289
eksport danych .....	201	temperatura, wskaźnik .....	91
identyfikacja, ręczna .....	130	teranostyka, opis ogólny .....	312
identyfikacja, ręczna w urządzeniu .....	102	terminale .....	56
konfiguracja .....	126	test zanurzeniowy .....	180
ekran 116		transport .....	347
konfiguracja, informacje ogólne .....	115	tryb barwienia .....	128
konfiguracja, szybkie uruchamianie .....	74	typ dozowania .....	163
kopiowanie .....	130		

<b>U</b>	
układ, etykieta .....	212
UPI .....	170
uruchamianie protokołu, krótki przegląd .....	12
uruchamianie przebiegu .....	109
opóźnione uruchomienie .....	110
uruchamianie systemu	
kontrola .....	71
ustawienie minimalnego poziomu zapasów .....	182
usuwanie	
grupa .....	232
odczynnik .....	176
przypadek .....	123
szkiełko .....	130
użytkownicy, tworzenie & edycja .....	206
<b>W</b>	
weryfikacja oznaczenia .....	316
wyłączanie oprogramowania .....	59
wyłączanie pojemników zbiorczych .....	230
wyłącznik zasilania .....	43
wymagane materiały .....	312
<b>Z</b>	
zagrożenia dotyczące obsługi .....	viii
zagrożenia mechaniczne .....	vi
zagrożenia związane z instalacją i transportem .....	viii
zagrożenie	
chemiczne .....	vi
elektryczne .....	vii
instalacja i transport .....	viii
mechaniczne .....	vi
obsługa .....	viii
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym .....	vii
zastępowanie odczynników .....	171
zatrzymywanie przebiegu .....	109
zduplikowane ID przypadku	
przypadki BOND .....	121
przypadki LIS .....	211
zespół barwienia szkiełek .....	26
czyszczenie & konserwacja .....	272
odblokowanie ręczne .....	276
podgrzewacze .....	27, 90
stany .....	87
wskaźnik temperatury .....	91
zestaw do miareczkowania .....	313
zgodność	
odczynniki zbiorcze z odczynnikami pomocniczymi .....	175
szkiełka .....	143
znaki towarowe .....	i