

# HistoCore PEGASUS Plus

Kudosten käsittelylaite



Käyttöohjeet  
Suomi

**Tilausnumero: 14 0488 80104 – Revisio I**

Säilytä tämä käyttöohje aina laitteen kanssa.  
Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

**CE**



Näiden käyttöohjeiden tiedot, numerot, huomautukset ja arvotukset edustavat tämän hetkistä tieteellistä tietoa ja uusimpia teknologisia edistysaskeleita ja perustuvat alalla tehtyihin perusteellisiin tutkimuksiin.

Emme ole vastuussa nykyisten käyttöohjeiden säännöllisestä tai jatkuvasta päivittämisestä uusimpien teknisten edistysaskeleiden perusteella tai käyttöohjeiden lisäkopioiden, -päivitysten tai muiden vastaavien tarjoamisesta asiakkaillemme.

Siinä määrin, missä paikalliset lakijärjestelmät kussakin yksittäistapauksessa sallivat, emme ole vastuussa näiden käyttöohjeiden sisältämistä virheellisistä lausumista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti emme ole vastuussa minkäänlaisista taloudellisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät näiden käyttöohjeiden lausumien tai muiden tietojen noudattamiseen.

Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina.

Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty.

Leica pidättää oikeuden muuttaa teknisiä erittelyjä sekä valmistusprosesseja ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten tuotteittemme jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia.

Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuksilla. Kaikki tämän dokumentaation tekijänoikeudet kuuluvat Leica Biosystems Nussloch GmbH:lle.

Tekstin ja kuvien (tai niiden osien) jäljentäminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, verkkokameralla tai muilla menetelmillä – kaikki elektroniset järjestelmät ja tiedotusvälineet mukaan luettuna – edellyttää Biosystems Nussloch GmbH:n etukäteistä nimenomaista kirjallista lupaa.

Laitteen sarjanumero ja valmistusvuosi löytyvät laitteen takana olevasta tyyppikilvestä.



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Germany

Puh.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faksi: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Verkkosivusto: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

Kokoonpanoon on valtuutettu Leica Microsystems Ltd. Shanghai

# Sisällysluettelo

---

<b>1.</b>	<b>Tärkeitä tietoja</b> .....	<b>8</b>
1.1	Nimeämiskäytännöt.....	8
1.2	Symbolit ja niiden merkitykset.....	8
1.3	Laitetyyppi.....	12
1.4	Käyttötarkoitus.....	12
1.5	Henkilöstön pätevyys.....	12
1.6	Käyttäjätietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä koskeva tiedote.....	12
<b>2.</b>	<b>Turvallisuus</b> .....	<b>13</b>
2.1	Turvallisuuteen liittyvät huomautukset.....	13
2.2	Varoitukset.....	14
2.2.1	Itse laitteessa olevat merkinnät.....	14
2.2.2	Kuljetus ja asennus.....	14
2.2.3	Laitteen käyttö.....	16
2.2.4	Reagenssien käsittely.....	23
2.3	Instrumentin turvallisuusominaisuudet.....	23
<b>3.</b>	<b>Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt</b> .....	<b>24</b>
3.1	Yleiskatsaus.....	24
3.1.1	Instrumentin osat.....	24
3.1.2	Takapaneeli.....	25
3.2	Instrumentin pääasialliset ominaisuudet.....	25
3.3	Tekniset tiedot.....	26
<b>4.</b>	<b>Instrumentin alkuasetukset</b> .....	<b>30</b>
4.1	Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset.....	30
4.2	Vakiotoimitus - pakkausluettelo.....	30
4.3	Pakkauksesta purkaminen ja asennus.....	32
4.3.1	Avaamisohjeet.....	32
4.3.2	Näytön asennus.....	35
4.3.3	Aktiivihiihisiuodatin.....	35
4.3.4	Ulkoinen poistojärjestelmä.....	36
4.4	Perustason instrumentti/-laitteisto.....	37
4.4.1	Tislausastiat.....	37
4.4.2	Kasettitelineet.....	40
4.4.3	Parafiinialtaat.....	42
4.4.4	Reagenssikaappi.....	43
4.4.5	Tippa-astia.....	45
4.4.6	Näyttö.....	46
4.4.7	HistoCore I-Scan.....	47
4.4.8	USB-portit.....	48
4.4.9	Hälytysliitännät.....	49
4.5	Katkeamattoman virransyötön (UPS) yhdistäminen.....	50
4.6	Käynnistäminen ja sammuttaminen.....	51
4.6.1	Käynnistäminen.....	51
4.6.2	Sammuttaminen.....	52
4.6.3	Hätäsammutus.....	52
4.6.4	Uudelleenkäynnistys pitkän sammutettuna säilyttämisen jälkeen.....	52
4.7	Instrumentin siirtäminen.....	53

<b>5.</b>	<b>Protokollan ajaminen</b>	<b>54</b>
5.1	Ohjelmiston käyttö	54
5.1.1	Perustason käyttö	54
5.1.2	Navigointi	55
5.1.3	Käyttöoikeustasot	57
5.1.4	Ohje	59
5.2	Pika-aloitus	59
5.3	Puhdistusprotokollat	66
5.4	Tila-näyttö	70
5.4.1	Tila-alue	71
5.4.2	Protokollapaneelit	75
5.5	Protokollan ajamisen vaihtoehdot	78
5.5.1	Protokollien aikataulutus	78
5.5.2	Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla	80
5.5.3	Vaiheen keston muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla	81
5.6	Protokollien keskeyttäminen	83
5.6.1	Keskeytyneen ajon jälkeinen palautuminen	85
5.7	Tislausastian aikataulutus	85
5.7.1	Viivästetyt päättymisajat ja alkutäytöt	86
5.7.2	Reagenssien ristiriidat, joita ei voida välttää	86
5.7.3	Reagensseja ei saatavilla	86
<b>6.</b>	<b>Protokollan alkuasetukset</b>	<b>88</b>
6.1	Protokollan yleiskatsaus	88
6.1.1	Protokollatyypit	88
6.1.2	Reagenssien valintatapa	89
6.1.3	Ennakkoon määritetyt protokollat	90
6.1.4	Protokollan validointi	91
6.1.5	Siirtymäasetus	91
6.1.6	Protokollatiedostot	94
6.2	Protokollien luominen, muokkaaminen ja tarkastelu	94
6.2.1	Protokollan valinta -näyttö	94
6.2.2	Protokollien muokkaaminen	94
6.2.3	Uusien protokollien luominen	97
6.2.4	Protokollien tarkastelu	100
<b>7.</b>	<b>Reagenssin määrittäminen</b>	<b>101</b>
7.1	Yleiskatsaus	101
7.1.1	Reagenssiryhmät, -tyypit ja -asemat	101
7.1.2	Pitoisuuksien hallinta	103
7.1.3	Raja-arvot	104
7.1.4	Suosittelut reagenssit	107
7.1.5	Reagenssit, joita ei suositella	109
7.1.6	Reagenssien yhteensopivuus	109
7.2	Reagenssityyppien hallinta	110
7.2.1	Ennalta määritetyt reagenssit	110
7.2.2	Aktiivisten reagenssityyppien muokkaaminen	110
7.2.3	Reagenssien lisääminen, piilottaminen ja poistaminen	113
7.3	Reagenssiasemien hallinta	115
7.3.1	Reagenssiasemat-näyttö	116
7.3.2	Reagenssiaseman ominaisuuksien hallinta	117

# Sisällysluettelo

---

7.4	Reagenssien vaihtaminen.....	120
7.4.1	Etätäyttö/-tyhjennys-näyttö.....	120
7.4.2	Etätäyttö/-tyhjennysliitännät.....	121
7.4.3	Reagenssin vaihtaminen – etätäyttö ja -tyhjennys.....	122
7.4.4	Reagenssin vaihtaminen – manuaalisesti.....	125
7.4.5	Parafiinin vaihtaminen.....	126
7.4.6	Tislausastioiden täyttäminen ja tyhjentäminen.....	128
<b>8.</b>	<b>Lisäasetukset ja -toiminnot.....</b>	<b>129</b>
8.1	Reagenssit-valikko.....	129
8.1.1	Manuaaliset toiminnot.....	129
8.2	Hallinnointivalikko.....	130
8.2.1	Käyttäjien hallinta.....	131
8.2.2	Raportit.....	132
8.2.3	Tapahtumalokit.....	136
8.3	Asetusvalikko.....	137
8.3.1	Huolto.....	137
8.3.2	Käsittelyasetukset.....	139
8.3.3	Laiteasetukset.....	141
8.3.4	Seurantavaihtoehdot.....	144
<b>9.</b>	<b>Puhdistus ja kunnossapito.....</b>	<b>146</b>
9.1	Puhdistus- ja huoltotyökalut.....	146
9.1.1	Parafiinikaavin.....	146
9.1.2	Tasoanturiharja.....	146
9.1.3	Parafiinialtaan ilmanvaihtotulppa.....	147
9.2	Huoltonäyttö.....	147
9.3	Puhdistus- ja huoltoaikataulu.....	148
9.3.1	Joka päivä.....	150
9.3.2	Joka viikko.....	155
9.3.3	60–90 päivän välein.....	157
<b>10.</b>	<b>Viitteet.....</b>	<b>159</b>
10.1	Reagenssin raja-arvo-ohjeet.....	159
10.2	Protokollat.....	160
10.2.1	Näytetyyppi ja protokollan kesto.....	160
10.2.2	Ennalta määritettyjen protokollien luettelo.....	160
10.2.3	Ksyleeniprotokollat.....	161
10.2.4	Ksyleenittömät protokollat.....	163
10.2.5	Puhdistusprotokolla.....	164
10.3	Aseman määritykset.....	164
10.4	Protokollavaiheiden lämpötilat.....	167
10.5	Reagenssien yhteensopivuustaulukot.....	167
<b>11.</b>	<b>Vianetsintä.....</b>	<b>170</b>
11.1	Alustavat kysymykset.....	170
11.2	Vuokaaviot.....	170
11.2.1	Alikäsittely kudos – laiteasetukset.....	171
11.2.2	Ylikäsittely kudos – laiteasetukset.....	172
11.2.3	Ali- tai ylikäsittely kudos – reagenssit.....	173
11.2.4	Heikko käsittely – väärä protokolla.....	174
11.2.5	Heikko käsittely – oikea protokolla.....	175
11.2.6	Leikkausartefakti.....	176

11.2.7	Värjäysartefakti .....	177
11.2.8	Lohkoartefakti .....	178
11.2.9	Uudelleen käsittelysuositukset .....	179
11.3	Sähkökatkos.....	182
11.4	Pääohjelmiston kaatuminen tai pysähtyminen .....	182
<b>12.</b>	<b>Tilastiedot .....</b>	<b>183</b>
<b>A1.</b>	<b>Dekontaminaation vahvistus.....</b>	<b>184</b>
<b>A2.</b>	<b>Takuu ja tekninen huolto.....</b>	<b>185</b>

## 1. Tärkeitä tietoja

### 1.1 Nimeämiskäytännöt



#### Huomaa

- Laitteen koko nimi on HistoCore PEGASUS Plus -kudostenkäsittelylaite. Laitetta kutsutaan HistoCore PEGASUS Plus -laitteeksi, jotta käyttöohjeet ovat helpommin luettavissa.

### 1.2 Symbolit ja niiden merkitykset

**Symboli:**



**Symbolin nimi:**

Vaara

**Kuvaus:**

Ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka huomiotta jätettynä aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

**Symboli:**



**Symbolin nimi:**

Varoitus

**Kuvaus:**

Jos tätä vaaraa ei vältetä, seurauksena voi olla kuolema tai vakavia vammoja.

**Symboli:**



**Symbolin nimi:**

Huomio

**Kuvaus:**

Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

**Symboli:**



**Symbolin nimi:**

Huomaa

**Kuvaus:**

Osoittaa tiedot, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät aiheuta riskejä.

**Symboli:**

→ [Kuva 7-1](#)

**Symbolin nimi:**

Kohdenumero

**Kuvaus:**

Kuvissa käytettävät osien numerot. Punaiset numerot viittaavat kuvissa olevien osien numeroihin.

**Symboli:**

[Esihenkilö](#)

**Symbolin nimi:**

Ohjelmistonimitykset

**Kuvaus:**

Ohjelmistonimitykset, jotka on näytettävä syöttönäytöllä, näkyvät lihavoituna ja harmaana tekstinä.

**Symboli:**

[Tallenna](#)

**Symbolin nimi:**

Toimintonäppäin

**Kuvaus:**

Instrumentissa painettavat toimintonäppäimet näytetään lihavoituna, harmaana ja alleviivattuna tekstinä.

**Symboli:**

[Virtakytkin](#)

**Symbolin nimi:**

Instrumentin näppäimet ja kytkimet

**Kuvaus:**

Instrumentin näppäimet ja kytkimet, joita käyttäjän on tarkoitus painaa erilaisissa tilanteissa, näytetään lihavoidulla, harmaalla ja alleviivattuna tekstinä.

**Symboli:**



**Symbolin nimi:**

Valmistaja











**Kuvaus:**









Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan.



<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Valmistuspäivä Ilmaisee lääkintälaitteen valmistuspäivämäärän.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Tuotenumero Ilmaisee valmistajan luettelonumeron, joka yksilöi lääkinnällisen laitteen.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Sarjanumero Ilmaisee valmistajan sarjanumeron, joka yksilöi lääkinnällisen laitteen.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Katso käyttöohjeet Osoittaa, että käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeisiin.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Huomaa Osoittaa, että käyttäjän tulee tutustua käyttöohjeissa esitettyihin tärkeisiin tietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimiin, joita ei ole mahdollista esittää varsinaisessa lääkinnällisessä laitteessa.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka on tarkoitettu käyttöön in vitro -diagnostiikassa.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	CE-vaatimustenmukaisuus CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että lääkinnällinen tuote täyttää soveltuvien EY-direktiivien ja -asetusten vaatimukset.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	Alkuperämaa Alkuperämaa-kenttä osoittaa maan, jossa tuotteen viimeinen olennainen valmistusvaihe on toteutettu.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	UKCA UKCA (UK Conformity Assessed) -merkintä on uusi Yhdistyneen kuningaskunnan merkintä, jota käytetään Isossa-Britanniassa (Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa) markkinoille tuoduissa tuotteissa. Se kattaa useimmat tuotteet, joissa vaadittiin aiemmin CE-merkinnän käyttöä.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	UKRP Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkilö toimii muun kuin Yhdistyneen kuningaskunnan valmistajan puolesta suorittaakseen valmistajan velvollisuuksiin liittyvät määrätyt tehtävät.
<b>Symboli:</b> 	<b>Symbolin nimi:</b> <b>Kuvaus:</b>	WEEE-symboli WEEE-symboli osoittaa tarpeen erilliselle sähkö- ja elektroniikkajätteen keräykselle, ja sen symbolissa on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti (§ 7 ElektroG).

Leica Microsystems (UK) Limited  
Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes,  
England, United Kingdom, MK14 6FG

<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Kiinan RoHS
	<b>Kuvaus:</b>	Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva numero osoittaa tuotteen ympäristöystävällisen käyttöajan vuosina. Symbolia käytetään, jos Kiinassa rajoitettua ainetta käytetään sallittua rajaa suurempina määrinä.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Vaihtovirta
		
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Suojajohdinliitin
		
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	<b>ON</b> (virta päällä)
	<b>Kuvaus:</b>	Virta on päällä
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	<b>OFF</b> (virta pois päältä)
	<b>Kuvaus:</b>	Virta on pois päältä
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Varoitus, kuuma pinta
	<b>Kuvaus:</b>	Instrumentin pinnat, jotka kuumenevat käytön aikana, on merkitty tällä symbolilla. Vältä pintojen suoraa koskemista, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Biologinen vaara
	<b>Kuvaus:</b>	
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Syttyvä
	<b>Kuvaus:</b>	Syttyvät reagenssit, liuottimet ja puhdistusaineet on merkitty tällä symbolilla.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Särkyvää, käsittele varoen
	<b>Kuvaus:</b>	Pakkauksen sisältö on herkästi särkyvää, ja sitä on käsiteltävä varovasti.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Säilytä kuivassa
	<b>Kuvaus:</b>	Pakkausta on säilytettävä kuivassa ympäristössä.

<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Pinoamisrajoitus
	<b>Kuvaus:</b>	Älä pinoa.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Tämä puoli ylös
	<b>Kuvaus:</b>	Ilmoittaa pakkauksen pystysuoran asennon.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Kuljetuksen lämpötilarajoitukset
	<b>Kuvaus:</b>	Ilmoittaa pakkauksen kuljetuksen aikana sallitun lämpötila-alueen.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Varastoinnin lämpötilarajoitukset
	<b>Kuvaus:</b>	Ilmoittaa pakkauksen säilytyksen aikana sallitun lämpötila-alueen.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Kuljetuksen ja varastoinnin kosteusrajoitukset
	<b>Kuvaus:</b>	Osoittaa kosteusrajoitukset pakkauksen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Shockdot-iskuosoitin
	<b>Kuvaus:</b>	Shockwatch-järjestelmässä ilmaisain värjäytyy punaiseksi, kun iskut tai tärähdykset ovat olleet määrättyä voimakkuutta suurempia. Määrätyn lisääntymisen (g-arvo) ylittyessä ilmaisinputken väri muuttuu.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	Kallistuksen osoitin
	<b>Kuvaus:</b>	Tip-n-Tell-osoitin seuraa, onko pakkaus kuljetettu ja säilytetty pystyasennossa vaatimusten mukaisesti. Kallistuksen ollessa vähintään 60° sininen kvartsihiekkavaalu nuolen muotoiseen ilmaisnikkunaan ja jää sinne pysyvästi. Pakkauksen väärä käsittely on havaittavissa välittömästi ja voidaan todistaa pysyvästi.
<b>Symboli:</b>	<b>Symbolin nimi:</b>	CSA-symboli
	<b>Kuvaus:</b>	Tämä tuote täyttää CAN/CSA-C22.2 No. 61010 -vaatimukset.

**Symboli:****Symbolin nimi:**

Kierrätysymboli

**Kuvaus:**

Ilmoittaa, että tuote voidaan kierrättää, kun tarvittavat valmiudet ovat olemassa.

### 1.3 Laitetyyppi

Kaikki näissä käyttöohjeissa annetut tiedot koskevat vain kansisivulla mainittua instrumenttityyppiä. Instrumentin sarjanumero löytyy instrumentin takaosaan kiinnitetystä nimikyltistä.

### 1.4 Käyttötarkoitus

HistoCore PEGASUS Plus on automaattinen kudosten käsittelylaite, joka on suunniteltu erityisesti histologiin lääketieteellisiin diagnooseihin käytettävien ihmiskudosnäytteiden kiinnittämiseen, kuivattamiseen tai väliaineilla tai parafiinilla kyllästämiseen esim. patologin antamaa syöpädiagnoosia varten.

HistoCore PEGASUS Plus on suunniteltu diagnostiseen in vitro -käyttöön.

**Varoitus**

- Instrumentin käyttö muilla tavoilla katsotaan käyttötarkoituksen ulkopuoliseksi käytöksi. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, henkilövamman tai instrumentin, lisävarusteiden tai näytteiden vaurioitumisen. Oikeanlainen ja tarkoituksenmukainen käyttö sisältää kaikkien tarkastus- ja huolto-ohjeiden sekä kaikkien käyttöohjeiden sisältämien ohjeiden noudattamisen.

### 1.5 Henkilöstön pätevyys

- Vain koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää HistoCore PEGASUS Plus -laitetta. Instrumentti on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön.
- Laitteen käyttöön valtuutetun henkilöstön on luettava tämä käyttöohje huolellisesti ja tunnettava laitteen kaikki tekniset ominaisuudet ennen laitteen käyttöä.

### 1.6 Käyttäjätietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä koskeva tiedote

Leica Biosystems kunnioittaa käyttäjätietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä. Käyttäjätietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä koskeva tiedotteemme alla ilmoittaa, että instrumentti kerää ja käyttää käyttäjätietoja.

- Kuvat kaseteilla täytetyistä telineistä: Kuvat telineistä, mukaan lukien kaikki tiedot käsitellyistä telineiden kaseteista, kerätään kasettien ajotietojen seuraamista varten ja säilytetään 90 päivän ajan.
- Käyttäjänimien ja -tunnusten käyttö: Valtuuttamiseen ja lupien myöntämiseen käytetyt käyttäjän tilitiedot, kuten käyttäjänimi, salasana ja nimikyltin tiedot, kerätään ja säilytetään, kunnes järjestelmänvalvoja poistaa ne. Tilietietojen varastoimisessa käytetty tietokanta on salattu.

## 2. Turvallisuus

### 2.1 Turvallisuuteen liittyvät huomautukset

Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka liittyvät instrumentin käyttöturvallisuuteen ja huoltoon.

Käyttöohjeet ovat tärkeä osa tuotetta, ja ne on luettava huolellisesti ennen instrumentin käynnistämistä ja käyttöä ja säilytettävä aina instrumentin lähellä.

Tämä instrumentti on rakennettu ja testattu mittaukseen, hallintaan ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Laitteen alkuperäisen tilan säilyttämiseksi ja laitteen turvallisen käytön takaamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia käyttöohjeen sisältämiä huomautuksia ja varoituksia.

Tässä luvussa mainittuja turvallisuutta ja vaaroja koskevia huomautuksia on noudatettava aina.

Lue nämä huomautukset, vaikka Leica Biosystems:n tuotteiden toiminta ja käyttö olisi sinulle ennestään tuttua.

Käyttöohjeen tietoja on täydennettävä käyttömaassa voimassa olevien onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja ympäristön turvallisuutta koskevien vaatimusten edellyttämällä tavalla.



#### Varoitus

- Instrumentin ja lisätarvikkeiden sisältämiä suojalaitteita ei saa poistaa tai muokata. Vain Leica Biosystems:n valtuuttama ammattitaitoinen huoltohenkilöstö saa korjata instrumentin ja huoltaa sen sisäisiä osia.
- Jos instrumentti on palautettava Leica Biosystems:ille korjausta varten, se on puhdistettava ja dekontaminoitava soveltuvalla tavalla (→ s. 184 – A1. Dekontaminaation vahvistus).



#### Huomaa

Tämänhetkiset tiedot soveltuvista standardeista löytyvät verkkosivustoltamme löytyvistä CE-vaatimustenmu-  
kaisuusvakuutuksesta ja UKCA-sertifikaateista:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Sähkömagneettinen yhteensopivuus, tuotettu häiriö ja häiriönsieto soveltuvat, kuten myös IEC/EN 61326-2-6-  
-vaatimusten noudattaminen. IEC/EN 61010-1-, IEC/EN 61010-2-101-, IEC/EN 61010-2-010- ja ISO 14971-  
-vaatimuksia noudatetaan turvallisuustietojen osalta.

Tämä laite on suunniteltu ja testattu 11-luokan A mukaisesti. Se voi aiheuttaa kotitalousympäristössä  
radiohäiriöitä, missä tapauksessa häiriöiden vähentämiseksi on toteutettava toimenpiteitä.

Sähkömagneettinen ympäristö tulee arvioida ennen instrumentin käyttöä.

Älä käytä tätä laitetta voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn lähteiden lähellä (esim. suojaamattomat, tarkoitukselliset radiotaajuuslähteet), koska nämä voivat aiheuttaa häiriötä normaalille käytölle.

## 2.2 Varoitukset

Valmistajan tähän instrumenttiin asentamat turvallisuuslaitteet toimivat vain onnettomuuksien estämisen perustana. Instrumentin turvallinen käyttö on ennen kaikkea omistajan ja laitetta käyttävän, huoltavan ja korjaavan nimetyn henkilöstön vastuulla.

Noudata ehdottomasti seuraavassa mainittuja ohjeita ja varoituksia laitteen häiriöttömän käytön varmistamiseksi.

### 2.2.1 Itse laitteessa olevat merkinnät



#### Varoitus

Laitteessa olevien vastaavien merkintöjen ja varoituskolmioiden ohjeiden noudattamatta jättäminen.

#### **Vakavia henkilövammoja ja/tai instrumentin, lisätarvikkeiden tai näytteiden vaurioitumisen.**

- Kiinnitä huomiota laitteessa oleviin merkintöihin ja noudata tarkasti käyttöohjeessa mainittuja käyttöä koskevia ohjeita, kun käytät merkittyä osaa tai vaihdat sen.

### 2.2.2 Kuljetus ja asennus



#### Varoitus

Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana.

#### **Näytteiden vauriot**

- Pakkauksessa on kaksi osoitinta, ShockDot-iskeytymisen osoitin ja kallistuksen osoitin, jotka osoittavat virheellisen kuljetuksen. Kun instrumentti toimitetaan, tarkista ensin nämä ilmaisimet. Jos yksi osoittimista on lauennut, pakkausta ei ole käsitelty määrättyllä tavalla. Merkitse se tässä tapauksessa kuljetusasiakirjoihin ja tarkista, onko laitteessa vaurioita.



#### Varoitus

Lisätarvikkeet voivat pudota käyttäjien päälle, kun pakkausta avataan.

#### **Henkilövamma**

- Noudata avaamisohjeita huolellisesti, jotta instrumentin vauriot voidaan välttää.
- Instrumentin pakkauksen avaamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kun instrumentti on poistettu pakkauksesta, se on kuljettava vain pystyasennossa.

**Varoitus**

Instrumentti kallistuu, kun se liikkuu ensimmäisen asennuskerran aikana.

**Henkilövamma**

- Instrumentin kannattelemiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, kun instrumentti siirretään pois lavalta rampin avulla.

**Varoitus**

Instrumenttia nostetaan ilman työkaluja ja laitteita.

**Instrumentti voi kaatua tai pudota käyttäjien päälle, kun sitä nostetaan, mikä aiheuttaa henkilövammoja.**

- Käytä aina riittävän kuorman kestävää nostolaitetta, kuten kärryä tai trukkia, kun siirrät instrumenttia ylempään kerrokseen.

**Varoitus**

Instrumenttia ei saa siirtää, jos siinä on reagensseja tai parafiinia ja/tai sen virtajohto on kytketty verkkovirtaan.

**Henkilövamma.**

- Aina ennen minkäänlaisia kuljetuksia, joiden aikana instrumentti saattaisi heilua, kallistua tai sitä nostetaan, instrumentti on puhdistettava, mukaan lukien letkut, parafiinialtaat ja reagenssipullot. Virtajohto on irrotettava verkkovirrasta.

**Varoitus**

Lisätarvikkeet/osat/laitteet voivat irrota tai vaurioitua kuljetuksen aikana.

**Näytteiden vauriot**

- Parafiinilämmittimen suojat on suljettava kuljetuksen ajaksi.
- Tislausastian kannet on lukittava kuljetuksen ajaksi.

**Varoitus**

Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana

**Näytteiden vauriot**

- Tarkista instrumentti ja lisätarvikkeet silmämääräisesti instrumentin kuljetuksen tai siirtämisen aikana mahdollisesti aiheutuneiden vaurioiden varalta ennen kuin käynnistät instrumentin.

**Varoitus**

Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana

**Näytteiden vauriot**

- Suorita testiajo ja varmista instrumentin ja käytetyn protokollan soveltuvuus instrumentin kuljetuksen tai siirtämisen jälkeen ennen potilaiden kudospäätteiden käsittelyä. Käytä joko ennakkoon määriteltyä protokollaa tai yhdistä toiminto omien protokolliesi validointiin.
- Käsittele potilaiden kudospäätteitä diagnostisiin tarkoituksiin vasta sen jälkeen, kun yllä mainitut tarkastukset on suoritettu onnistuneesti. Jos jokin aiemmista vaiheista epäonnistui, älä käytä instrumenttia. Ota yhteyttä paikalliseen Leica Biosystemsien huoltoedustajaan.

**Varoitus**

Riittämätön poistojärjestelmä tai ei poistojärjestelmää / poistojärjestelmä liitetty virheellisellä tavalla

**Henkilövamma vuotaneen höyryn tai liiallisten kaasujen vuoksi**

- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihiihisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.
- Suosittelemme ulkoisen poistojärjestelmän käyttöä.
- Vaikka instrumentti olisikin yhdistetty ulkoiseen poistojärjestelmään, toimitettua aktiivihiihisuodatinta on silti käytettävä.

**Varoitus**

Instrumentti on kytketty samaan virtapiiriin muiden instrumenttien kanssa.

**Instrumentti saattaa toimia epävakaalla jännitteellä/virralla, mikä vaurioittaa näytteitä.**

- Älä käytä jatkojohtoja.
- Kytke instrumentti vain maadoitettuun virtaliitäntään. Varmista, että pakollista katkaisijaa käytetään.

**Varoitus**

Tippa-astiaa ei ole asennettu tai se on asennettu virheellisesti, jolloin nestettä vuotaa lattialle.

**Henkilövamma.****Ympäristön kontaminaatio.**

- Älä käytä instrumenttia ilman tippa-astiaa.
- Käytä henkilönsuojaimia, kun käytät instrumenttia.

### 2.2.3 Laitteen käyttö

**Varoitus**

Liitin ei vastaa letkua / liittimen korrosio, reagenssipullon ylivuoto (ulkoinen reagenssimäärä ei vastaa reagenssipulloa jne.), pullo putoaa reagenssin täyttämisen tai vaihtamisen aikana, letku irtoaa tyhjentämisen aikana.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.****Biologinen vaara jätereagenssin takia.****Ympäristön kontaminaatio.**

- Käytä aina kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun käsittelet reagensseja. Kudosten käsittelyyn käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.
- Käytä aina instrumentin mukana tullutta letkua.
- Älä koskaan täytä reagenssiasemaa, jossa on jo sisältöä.

**Varoitus****Käsittelyssä oleville näytetyypeille sopimattomat siirtoasetukset voivat aiheuttaa näytteen vaurioitumisen!**

Varmista oikeat siirtoasetukset:

- Katso kantautumisasetukset luvusta 6.1.5 "Siirtymäasetus".
- Laboratorion on validoitava ennalta määritellyt ja mukautetut protokollat (mukaan lukien siirtymisarvo) standarditoimintaohjeidensa mukaisesti.



**Varoitus**

Reagenssipulloa ei ole täytetty riittävästi (tislauksastia ei ole tyhjä).

**Näytteiden vauriot**

- Tarkista aina ennen protokollan ajamista, että tislauksastia on tyhjä.

**Varoitus**

Avaa/sulje parafiinialtaan kannet, täytä sulanut parafiini, liitin ei vastaa letkua / liittimen korroosia, letku irtoaa tyhjennyksen aikana, jäteparafiinisäiliö ei ole valmis / ei ole vakaa, kun tyhjennys aloitetaan käyttöösiytymän kautta, vedä tyhjennysletku ulos.

**Kädet/sormet saavat palovammoja.**

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Kontaminoituneen parafiinin aiheuttama biologinen vaara.**

**Ympäristön kontaminaatio.**

- Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun täytät/tyhjenät sulanutta parafiinia. Käytetty parafiini voi olla kontaminoitunutta.
- Käytä aina instrumentin mukana tullutta letkua.
- Varmista, että käytetty parafiinin tyhjennysletku on oikean kokoinen, jotta parafiinia ei pääse vuotamaan.
- Putkesta poistuva parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, että parafiini tyhjenetään sopivaan säiliöön, ja pysy tyhjennyksen aikana turvallisen välimatkan päässä.
- Älä poista etätäyttö-/tyhjennysletkua ennen kuin ohjelmisto ilmaisee, että prosessi on suoritettu loppuun ja letku on tyhjenetty paineilmalla. Reagenssivirtauksen päättyminen ei ole merkki siitä, että toimenpide on suoritettu loppuun.

**Varoitus**

Käyttäjän määrittämiä protokollia ei ole validoitu.

**Näytteiden vauriot**

- Ennakkoon määritetyt protokollat ja mukautetut protokollat on validoitava käyttäjän toimesta ennen protokollan ajamista, eli potilaan kudosten käsittelyä diagnostiikkaa varten, paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.

**Varoitus**

RMS (reagenssinhallintajärjestelmä) on asetettu arvoon N/A tai virheelliseen arvoon.

**Reagenssin kulutustilaa ei voida valvoa, mikä voi vaikuttaa kudosten käsittelyn laatuun ja vaurioittaa näytteitä.**

- Älä aseta RMS-järjestelmää arvoon N/A. Käytä RMS-järjestelmää reagenssin kulutustilan seuraamiseen.
- RMS-asetukset on validoitava käyttäjän toimesta ennen protokollan ajamista, eli potilaan kudosten käsittelyä diagnostiikkaa varten, paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.



### Varoitus

Jos tislusastia avataan, kun instrumentti on käsitteilyn keskellä / keskeyttämisen jälkeen / protokollan päättymisen jälkeen, käyttäjä joutuu kosketuksiin tislusastian kannen/telineen kuuman pinnan / vaarallisten aineiden/höyryn kanssa.

Jos tislusastia avataan, protokolla ei voi jatkua.

#### Henkilövamma / näytteen vaurioituminen / vaarantuneet näytteet

- Kuuma pinta. Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia käytön aikana.
- Älä avaa tislusastian kantta tai poista reagenssipulloja / parafiinilämmittimen suojusta / parafiinialtaita, kun protokolla on käynnissä, ellei järjestelmän viesti pyydä sinua tekemään niin. Jos haluat poistaa näytteitä tislusastiasta tai lisätä näytteitä tislusastiaan, kun protokolla on käynnissä, paina keskeytyspainiketta.
- Ole varovainen, jos avaat tislusastian tai parafiinialtaan instrumentin toiminnan keskeyttämisen jälkeen. Lue kaikki varoitusviestit (esim. tislusastia on liian kuuma eikä siihen voi koskea turvallisesti) ja noudata soveltuvia varotoimenpiteitä ennen jatkamista.
- Sulanut parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Ole varovainen, kun käsittelet parafiinia ja poistat telineitä.



### Varoitus

Tislusastian avoimiin kansiin osuu jokin.

#### Henkilövamma. Sormet tai kädet voivat murskautua.

- Älä osu tislusastian avoimiin kansiin.



### Varoitus

Käsittely alkaa ennen kuin parafiini on sulanut kokonaan.

#### Näytteiden vauriot

- Varmista, että parafiinialtaiden parafiini on sulanut kokonaan ennen kuin painat käynnistyspainiketta.



### Varoitus

Näytteet eivät ole reagenssien/parafiinin peitossa.

#### Näytteet kuivuivat ja vaurioituivat.

- Tarkista reagenssipullojen reagenssitaso ulkopuolelta ennen protokollan ajamista. Varmista, että reagenssitasot ovat Min- ja Max-merkintöjen välillä. Tarkista myös parafiinitasot.
- Älä lisää näytteitä tasoanturin yläpuolelle.
- Älä lisää näytteitä suosituksia enempää.
- Varmista, että kasetit on asetettu oikein telineisiin ja telineet on asetettu oikein tislusastioihin.
- Aseman valintaprotokollia ei suositella yön yli toteutettavissa käsittelyissä. Jos reagenssi ei ole jostain syystä saatavilla, protokollaa ei voida suorittaa loppuun.

**Varoitus**

Virheelliset pitoisuusasetukset

**Näytteiden vauriot tai kudosten käsittelyn laadun heikkeneminen**

- Älä muuta käytetyn reagenssin pitoisuutta, jos et pysty vahvistamaan todellista pitoisuutta.

**Varoitus**

Virheellisesti asetettu reagenssin lämpötilaraja-arvo ylittää kiehumispisteen.

**Henkilövamma / näytteen vaurio / ympäristön kontaminaatio käsittelyn aikana aiheutuvien liiallisten höyryjen takia.**

- Ole äärimmäisen varovainen, jos vaihdat reagenssin lämpötilaraja-arvoa. Korkeammat raja-arvot voivat aiheuttaa reagenssien kiehumista. Kiehuvat reagenssit vapauttavat suuria höyrymääriä, jotka voivat ylikuormittaa sisäistä aktiivihillisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää (jos asennettu). Kiehuvat reagenssit aiheuttavat todennäköisesti myös liiallista painetta instrumentin sisällä sekä reagenssien kontaminaatiota ja reagenssien ylivuotoja. Reagenssien kiehumispisteet ovat matalampia, kun tislusastiaa käytetään tyhjiössä tai paine-/tyhjiökierrossa.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihillisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää. Vaikka instrumentti olisikin yhdistetty ulkoiseen poistojärjestelmään, toimitettua aktiivihillisuodatinta on silti käytettävä.

**Varoitus**

Reagenssien virheelliset määritelmät

**Näytteiden vauriot, jotka johtuvat käyttöjärjestelmän määritelmien ja pullojen merkintöjen välisistä eroista.**

- Päivitä aseman tiedot aina oikeiksi.
- Tarkista asemien määritelmä aina ennen protokollien aloittamista ja aloittamisen yhteydessä.
- Älä koskaan päivitä tietoja, jos reagenssia ei ole vaihdettu.

**Varoitus**

Instrumentin antamat tiedot on jätetty huomiotta.

Reagenssin/aseman parametrit on päivitetty, mutta reagenssia ei ole vaihdettu.

Älä päivitä reagenssin tilaa GUI:ssa tyhjästä täydeksi pullon täyttämisen jälkeen.

Älä aseta tilaa täydeksi ennen pullon täyttämistä, jos et täytä pulloa tai täytät pullon vain osittain.

**Näytteiden vauriot, jotka johtuvat likaisista tai vanhentuneista reagensseista tai riittämättömistä reagensseista.****Diagnoosin viivästyminen.**

- Vaihda reagenssit aina, kun sinua pyydetään tekemään niin.
- Päivitä aseman tiedot aina oikeiksi.
- Älä koskaan päivitä tietoja, jos reagenssia ei ole vaihdettu.



### Varoitus

Reagenssin täyttäminen epävakaasta säiliöstä.

**Henkilövamma – Täyttö-/tyhjennystoiminnoissa on voimakas tyhjennys, joka voi aiheuttaa epävakaan säiliön kaatumisen ja vuotamisen. Käyttäjä voi liukastua lattialle valuneen reagenssin takia.**

#### Ympäristön kontaminaatio.

- Varmista aina, että täytössä ja tyhjennyksessä käytetään suurta, vakaata säiliötä. Säiliön on oltava myös riittävän suuri, jotta kaikki valutettu neste mahtuu siihen. Jos käytät pientä säiliötä, sitä ja letkua on tuettava täytön tai tyhjennyksen aikana.
- Varmista, että käytetty parafiinin tyhjennysletku on oikean kokoinen, jotta parafinia ei pääse vuotamaan.
- Käytä aina kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun käsittelet reagensseja. Kudosten käsittelyyn käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.



### Varoitus

Instrumentti on käynnissä, vaikka reagenssipulloja puuttuu tai reagenssipullojen korkit ovat löysällä tai ne puuttuvat kokonaan.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

#### Ympäristön kontaminaatio.

- Älä koskaan käytä instrumenttia, jos siinä ei ole kaikkia tarvittavia reagenssipulloja tai pullojen korkit ovat löysällä tai puuttuvat kokonaan.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.



### Varoitus

Instrumentti on käynnissä, vaikka kondensaattipullo puuttuu tai kondensaattipullon korkki on löysällä tai se puuttuu kokonaan.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Myrkyllisten/vaarallisten höyryjen vuotamisen aiheuttama biologinen vaara.**

- Älä koskaan käytä instrumenttia ilman kondensaattipulloa tai jos kondensaattipullon korkki on löysällä tai se puuttuu kokonaan.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.



### Varoitus

Parafiinialtaan avoimiin kansiin osuu jokin.

#### Henkilövamma

- Ole varovainen, jotta avoimiin parafiinialtaan kansiin ei osu mitään. Ne voivat murskata sormet tai kädet.



### Varoitus

Parafiinialtaan kansi avataan, kun tislusastiassa on parafinia tai parafinia siirretään.

#### Henkilövamma

- Älä koskaan avaa parafiinialtaan kantta, kun tislusastiassa on parafinia tai parafinia siirretään. Kuumaa parafinia voi roiskua altaasta.

**Varoitus**

Tukos, joka aiheutuu tislauksastiasta poistuneista kaseteista/kudoksista tai reagenssien tai parafiinin epäpuhtauksista

**Näytteiden vauriot**

- Käytä käsittelyn aikana telineitä. Älä aseta näytteitä suoraan tislauksastiaan.
- Tarkista ennen protokollan ajamista, että tislauksastian pohjalle on asennettu siivilä.
- Varmista, ettei tislauksastiaan pääse putoamaan mitään, kun tislauksastian siivilä poistetaan. Putkissa olevat vierasesineet voivat estää venttiilien oikean toiminnan.

**Varoitus**

Paikallinen hälytys / etähälytys ei ole yhdistetty.

**Näytteiden vauriot**

- Paikallinen tai etähälytysjärjestelmä on liitettävä instrumenttiin.

**Varoitus**

Tislauksastiaan jää kudoksia, kun puhdistusprotokolla ajetaan.

**Näytteiden vauriot**

- Poista kaikki kudokset tislauksastiasta ennen puhdistusprotokollan ajamista, sillä kuivausvaihe vaurioittaa kudoksia.

**Varoitus**

Puhdistusprotokollaa käytetään näytteiden uudelleen käsittelyyn.

**Näytteiden vauriot**

- Älä käytä puhdistusprotokollia uudelleen käsittelyyn, sillä kuivausvaihe vaurioittaa kudoksia.

**Varoitus**

Virheellisten/riittämättömien puhdistustyökalujen/reagenssien käyttö

**Näytteiden vauriot**

- Älä käytä kontaminoituneita vedenpoistoaineita uudelleen puhdistusetanolina. Kontaminoituneet vedenpoistoaineet sisältävät formaliinia (tai muita kiinnitysaineita) ja kuivausvaihe aiheuttaa suolojen kiteytymistä tislauksastian sisäpinnoille.
- Käytä puhdistusprotokollaa aina, kun tislauksastiassa on ollut parafiinia.

**Varoitus**

Käsitlemättömiä näytteitä (joissa on formaliinijäänteitä) asetetaan tislauksastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista.

**Heikentyneet näytteet – Formaliinijäänteet, jotka siirtyvät parafiinialtaaseen puhdistusajon alussa, voivat vahingoittaa näytteitä myöhemmissä ajoissa.**

- Älä lataa käsitlemättömiä kudoksenäytteitä tislauksastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista.
- Jos lataat käsitlemättömiä näytteitä vahingossa tislauksastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista, poista näytteet ja yritä ladata käsittelyprotokolla ennen puhdistusprotokollan lataamista. Puhdistusajoa edeltävä tyhjennys ohitetaan.



### Varoitus

Puhdistusprotokollan ajaminen muiden materiaalien kuin telien puhdistamista varten.

**Heikentyneet näytteet – Puhdistusreagenssit heikkenevät nopeammin. Jos syklin puhtausraja-arvoa ei madalleta, epäpuhtaat puhdistusreagenssit johtavat heikompiin puhdistustuloksiin.**

- Älä puhdistu muita materiaaleja puhdistusprotokollan avulla.



### Varoitus

Kiinteiden näytteiden lisääminen käynnissä olevaan protokollaan.

**Heikentyneet näytteet.**

- Ole varovainen, kun lisäät kiinteitä näytteitä käynnissä olevaan protokollaan. Ylimääräinen kiinnitysaine kontaminoi sen hetkessä vaiheessa käytetyn reagenssin, mutta reagenssinhallintajärjestelmä ei seuraa tätä kontaminaatiota.



### Varoitus

Lisänäytteiden lisääminen käsittelyn aikana.

**Heikentyneet näytteet.**

- Mitä pidemmälle protokolla on edennyt ennen kuin lisäät näytteitä, sitä heikompi kyseisten näytteiden käsittelylaatu on. Näytteitä tulee lisätä vain kiinnitysainevaiheissa tai ensimmäisen vedenpoistoainevaiheen aikana.



### Varoitus

Verkkovirtajohdon irrottaminen tai järjestelmän sammuttaminen, kun protokolla on käynnissä.

**Virran katkeamisen aiheuttamat näytteiden vauriot**

- Älä irrota verkkovirtajohtoa, kun instrumentti on käynnissä, ellei kyseessä ole hätätilanne eikä etupaneelin virtapainiketta tai verkkovirtakytkintä voida jostain syystä käyttää.
- Älä sammuta järjestelmää, kun protokolla on käynnissä.



### Varoitus

Sopimattomien varusteiden käyttö huollon aikana.

**Henkilövahinko – Käyttäjän loukkaantuminen kuuman pinnan, terävän reunan, jäännösten tms. vuoksi.**

- Käytä huollon aikana henkilönsuojaimia.



### Huomio

- Erityistilanteissa (esim. vahingossa tapahtuvien reagenssivuotojen tapauksessa) hengityssuojaimen käyttö voi olla tarpeen. Tämä riippuu tilanteeseen liittyvän ympäristön lämpötilasta, huoneen koosta, lisäkuormasta, ilmanvaihtotehosta jne. Epäselvissä tapauksissa laboratorion omistajan/operaattorin on toteutettava paikallinen mittaus, jonka avulla voidaan todistaa, että sovellettavat työpaikan enimmäispitoisuudet eivät ylitä. Työpaikan enimmäispitoisuusmittauksissa, jotka on suoritettu ilmanvaihtonopeudella 8,75 kertaa tunnissa ja 40 °C:n lämpötilassa, kun huoneen koko on 24 m<sup>3</sup> ja reagenssin lämpötila on 45 °C, rajaarvot ylitetään hetkellisesti siinä vaiheessa, jossa näytteet ladataan formaliiniin. Matalammassa laboratorioympäristön lämpötiloissa ja/tai suuremmissa huonetilavuuksissa tai paremmilla ilmanvaihtonopeuksilla työpaikan pitoisuudet ovat pienempiä. Tarkat pitoisuusarvot voidaan mitata vain paikallisesti. Kaikissa käyttötiloissa noudatettiin raja-arvoja.

### 2.2.4 Reagenssien käsittely



#### Varoitus

Muiden kuin suositeltujen reagenssien käyttö

**Henkilövamma – Jotkin myrkylliset/syttyvät reagenssit voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.**

**Viivästynyt diagnoosi – Instrumentin osat voivat vaurioitua syövyttävien reagenssien takia.**

- Käytä laitteessa vain alla mainittuja reagensseja.
- Älä käytä pikriinihappoa sisältäviä kiinnitysaineita, sillä pikriinihappo on kuivana räjähdysherkkää.
- Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja sisältäviä reagensseja, kuten elohopeasuoloja, pikriinihappoa, typpihappoa tai suolahappoa.
- Älä käytä asetonia tai muita ketoneja. Ne vahingoittavat instrumentin venttiilejä.



#### Huomaa

- Materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla kemikaalien toimittajilta. Jos käytät Leica-tuotemerkittyjä reagensseja, niiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkossa osoitteessa <http://www.LeicaBiosystems.com>.

### 2.3 Instrumentin turvallisuusominaisuudet

Kudosten käsittelylaitteessa on monia turvallisuustoimintoja ja kehittyneitä ohjelmiston hallintamekanismeja. Nämä varmistavat, että näytteet pysyvät hyvässä kunnossa kyllästämisen prosessin aikana tapahtuvan sähkökatkoksen tai muun toimintahäiriön tapauksessa ja että kyllästäminen suoritetaan loppuun onnistuneesti.

#### Ylipainesuojaus

- Kun ilmapainepumpun virta kytketään pois, venttiilit siirtyvät oletusarvoisesti turvalliseen tilaan (tislauksastia tyhjennetään, painetta ei tuoteta).
- Jos pumppua ei pysäytetä paineistamisen aikana oikealla hetkellä, virtalähde keskeytetään ulkoisen virtapiirin avulla.

#### Ylijännitesuojaus

- Lämmityksen jännitteen havaitsemismekanismi suojaa vaihtojännitteen ylikuormitusolosuhteilta.
- Erilliset lämmityksen virtasulakkeet suojaavat tasajännitteen ylikuormitusolosuhteilta.

#### Ylikuumenemissuojaus

Lämmönrajoittimet ja ohjelmiston ylikuumenemisvirheen käsittelymekanismi suojaavat instrumenttia epätavallisen kuumilta lämpötiloilta.

#### Liikatyhjiösuojauus


Tyhjiöjärjestelmä ei pysty luomaan vaarallisia tyhjiöolosuhteita.

## 3 Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

### 3. Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

#### 3.1 Yleiskatsaus

##### 3.1.1 Instrumentin osat

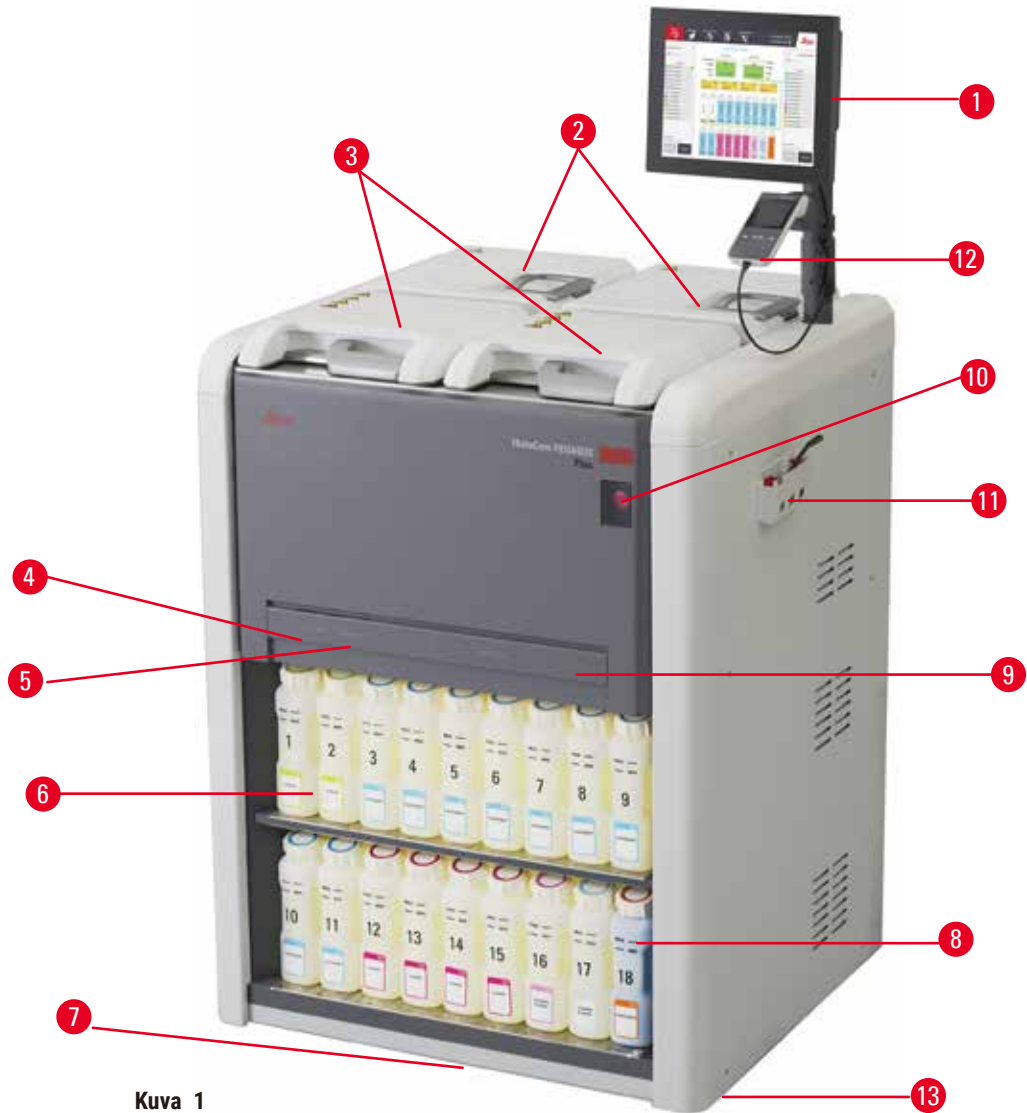


Kuva 1

- |  |   |
|--|---|
| 1. Näyttö  | 7. Tipa-astia                               |
| 2. Neljä parafiiniallasta  | 8. Kondensaattipullo                        |
| 3. Kaksi tislauksastiaa  | 9. Aktiivihiilisuodatin (suojausten takana) |
| 4. Etätäyttö/-tyhjennysportti (reagenssi)<br>(suojausten takana) | 10. Päävirtakytkin                          |
| 5. Etätyhjennysportti (parafini) (suojausten takana)             | 11. Työkalulaatikko                         |
| 6. Reagenssipullot   | 12. HistoCore I-Scan                        |
|  | 13. Pyörät (eivät näy tässä kuvassa)        |



### 3.1.2 Takapaneeli

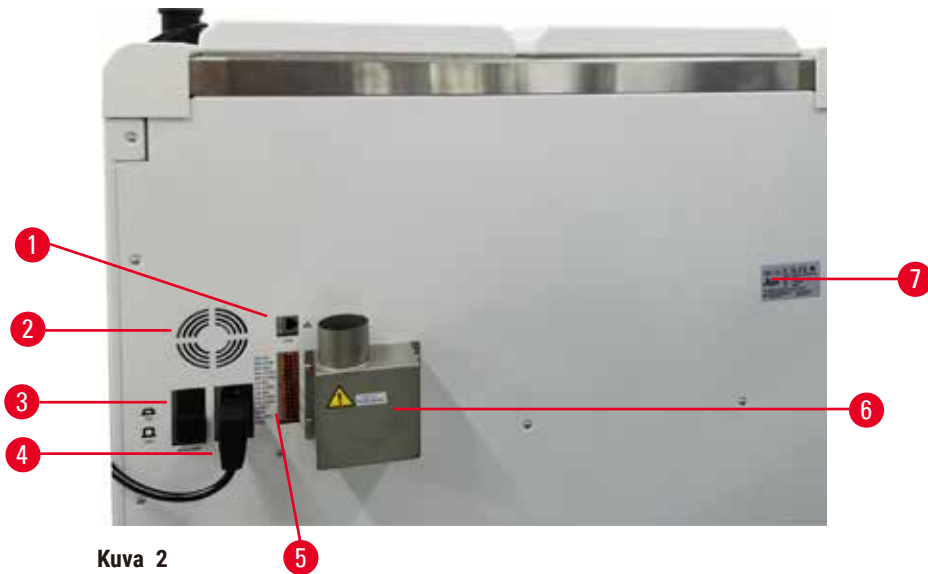

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Ethernet-portti  | 5. Hälytys- ja UPS-liitännät   |
| 2. Tuuletin         | 6. Pakokaasun käyttöliittymä (yhdistä ulkoiseen poistojärjestelmään) |
| 3. Katkaisija       | 7. Nimikyltti  |
| 4. Päävirtaliitäntä |  |

### 3.2 Instrumentin pääasialliset ominaisuudet

HistoCore PEGASUS Plus (jäljempänä PEGASUS Plus) on kahden tislusastian kudosten käsittelylaite, joka käsittelee kudoksia nopeasti ja korkealaatuisesti histologialaboratorioiden tarpeita varten. Se mahdollistaa huomattavan aikataulujen joustavuuden, sillä reagenssilavuus riittää kahden tislusastian itsenäiseen ajoon. Älykäs ohjelmisto antaa sinun määrittää instrumentin laboratoriosi työnkulkuihin sopivaksi, mutta varmistaa silti tarkastukset ja rajoitukset, jotka auttavat välttämään kudoksia vahingoittavia virheitä.

Track and Trace -toiminnot seuraavat kaikkia kasettejasi:

Seuraa ja tallenna olennaisia tietoja sisäänrakennetuilla seurantatoiminnoilla. Integroitu iScan-teknologia seuraa telineen tunnuksia, käyttäjätunnuksia ja reagenssien tietoja. Optinen skanneri tarkastaa kasettien tunnuksat, määrät ja värit, jotta voit seurata jokaista kudosten käsittelyn työnkulun näytettä erikseen.

Tallennettujen tietojen helppo käyttö mahdollistaa kudosten käsittelyraporttien hallinnan ja vähentää tarvetta manuaaliselle dokumentaatiolle luotettavuutta heikentämättä.

Tarkka reagenssinhallintajärjestelmä varmistaa vähäisen reagenssien kulutuksen ja vähentää reagenssien vaihtamisen tarvetta.

Myös sisäänrakennettu tiheysmittari auttaa välttämään laboratoriovirheiden riskiä reagenssien vaihdon aikana. Se seuraa muutoksia ja ilmoittaa käyttäjille, jos pitoisuus on virheellinen kudoksen eheyden suojaamisen kannalta.

Asetuksistasi riippuen PEGASUS Plus voi käyttää näitä tietoja valitakseen parhaan mahdollisen reagenssin protokollan jokaisessa vaiheessa. Se ilmoittaa, kun reagenssi on vaihdettava, jotta laatu pysyisi hyvänä, ja varmistaa samalla, että reagenssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Selkeä ja intuitiivinen kosketusnäyttöinen käyttöliittymä tekee ajojen lataamisesta ja seurannasta helppoa. Protokollan määrittäminen, reagenssien asetukset ja muut järjestelmäasetukset ovat yhtä yksinkertaisia.

HistoCore I-Scan voi seurata kaikkia tarvitsemiasi tietoja ja tallentaa ne (kasettien tunnukset, värit, viivakoodit, koot ja määrät) ainutlaatuisen kuvapohjaisen seurantateknologian avulla. Voit seurata kaikkia näytteitä ja kudosten käsittelyä, mutta vähentää manuaalista dokumentaatiota, mikä parantaa diagnostista luotettavuutta.

Ennakkoon määritetyt, validoidut protokollat lisäävät joustavuutta eri kudostyyppien käsittelyyn, mutta varmistavat tasaisen käsittelylaadun.

HistoCore PEGASUS Plus -käsittelylaite tukee ksyleenitöntä käsittelyä isopropanolilla (IPA), Leica Sub-X:llä tai Clearenella.

Ksyleenittömässä tilassa parafiinin käyttöikä voidaan pidentää parafiinin puhdistusominaisuuden avulla.

Taustavalon avulla reagenssien tasojen tarkistaminen on helppoa. Kun reagenssi on vanhentunut, kyseinen reagenssipullo vilkkuu visuaalisena muistutuksena. Taustavalon sammuu, kun reagenssipulloa ei ole liitetty oikein.

Magneettinen sekoitinteknologia on suunniteltu optimoimaan parafiinin kyllästämisteho, mikä vähentää käsittelyaikaa ja parantaa reagenssien vaihtoastetta kudoksen soluissa.

Vuodonestolla varustetut reagenssipullot, jotka on suunniteltu välttämään vuotoja reagenssien siirtämisen aikana.

Vähennä parafiinin sulatusaika 3,5 tuntiin HistoCore PEGASUS Plus Parablocks -tuotteen avulla: se sovitaa parafiinisäiliön parafiinin täyttöturvallisuuden täydellisesti ilman ylitäyttöä ja eliminoi pellettivuodot. Leica-pellettien sulatusaika on noin 4,5 tuntia.

Lämmitetty tislauksastian kansi haihduttaa siihen jääneet reagenssijäämät nopeasti, mikä parantaa höyryjen hallintaa.

Reagenssien ja parafiinin täyttö ja tyhjentäminen voidaan tehdä etätäyttö-/tyhjennystoiminnon avulla, mikä välttää altistusta reagensseille ja kuumalle parafiinille.

### 3.3 Tekniset tiedot

#### Sähkötiedot

Nimellisyöttöjännite	100–120 V AC/220–240 V AC
Nimelliset syöttötaajuudet	50/60Hz
Virrankulutus	enint. 100–120 V AC 15 A, enint. 220–240 V AC 10 A
Verkkosulakkeet	16 A, 250 V AC

**Mitat ja paino**

Laitteen koko yhteensä käyttötilassa (leveys x syvyys x korkeus, mm)	804 x 715 x 1533
Pakkauksen koko yhteensä (leveys x syvyys x korkeus, mm)	1040 x 1045 x 1480
Tyhjäpaino (ilman lisätarvikkeita, kg)	235 kg
Paino yhteensä (lisätarvikkeilla, kg)	315 kg
Laitteen paino pakkaus mukaan lukien (kg)	300 kg

**Ympäristövaatimukset**

Käyttökorkeus (metriä merenpinnan yläpuolella) (väh./enint.)	Korkeintaan 2 250 m merenpinnan yläpuolella
Lämpötila (käyttö) (väh./enint.)	+10 – +35 °C
Suhteellinen kosteus (käyttö) (väh./enint.)	Kosteus 20–80 %, tiivistymätön
Lämpötila (kuljetus) (väh./enint.)	-29 °C – +50 °C
Lämpötila (varastointi) (väh./enint.)	+5 °C – +50 °C
Suhteellinen kosteus (kuljetus)	Kosteus 10–85 %
Suhteellinen kosteus (varastointi)	Kosteus 10–85 %, tiivistymätön
Vähimmäisetäisyys seinistä (mm)	80 mm
BTU (J/s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100–120 V: enintään 6 141,86 BTU/h (1 800 J/s)</li> <li>• 220–240 V: enintään 8 189,14 BTU/h (2 400 J/s)</li> </ul>

**Päästöt ja rajaehdot**

Ylijänniteluokka, IEC 61010-1	Ylijänniteasennusluokka II
Likaantumisaste, IEC 61010-1	Likaantumisaste 2
Suojauskeinot, IEC 61010-1	Luokka I
Suojausaste, IEC 60529	IP20
A-painotettu melutaso mitattuna 1 m etäisyydeltä	< 70 dB (A)
EMC-luokka	Luokka A

**Kudosten käsittelylaite**

Paikallinen/etähälytysrele	30 V DC, enint. 1A
Reagenssisäiliöiden määrä	17 reagenssipulloa, 1 kondensaattipullo
Pullon enimmäistilavuus	Enint. 3,88 l

**Parafiinisäiliöt**

Parafiinialtaiden määrä	4
Tilavuus	3,9 l per parafiiniallas
Sulatusaika	7 tuntia, kun ympäristön lämpötila on 23–25 °C (aseta parafiinin tyyppiksi "Recommended")
Lämpötila-asetusten alue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parafiinin sulamispisteen asetus: 50–65 °C</li> <li>• Valmiustilan lämpötila-asetus: Parafiinin sulatuspiste +2 °C, enint. 71 °C</li> </ul>

**Tislausastia**

Tilavuus	2 x 200 kasettia
Lämpötila (parafiini)	Parafiinin lämpötila voidaan valita alueelta 58–85 °C.
Lämpötila (käsittelyreagenssit)	Ympäristön lämpötila tai 35–65 °C
Lämpötila (puhdistusreagenssit)	35–85 °C
Tyhjiön täyttäminen	–60 kPa
Tyhjennyspaine	45 kPa

**Muut tiedot**

CE	Hyväksytty
CSA	Hyväksytty
Reagenssinhallintajärjestelmä (RMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käsittelyprotokolla: Kasetit/syklit/päivät/pitoisuus</li> <li>• Puhdistusprotokolla: Sykliä/päivää</li> </ul>
Tippa-astia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 3,88 l</li> </ul>
Käyttöoikeustasot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaattori</li> <li>• Esihenkilö</li> <li>• Järjestelmänvalvoja</li> <li>• Huolto</li> <li>• Valmistaja</li> </ul>
Salasanatila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaattori</li> <li>• Esihenkilö</li> <li>• Järjestelmänvalvoja</li> <li>• Huolto</li> <li>• Valmistaja</li> </ul>
Salasanan tyyppi	Salasanassa on oltava vähintään 6 merkkiä, joista vähintään yksi on kirjain ja yksi numero.
Laitteistot ja ohjelmistot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-kosketusvärinäyttö</li> <li>• Käyttäjäystävällinen, älykäs ohjelmisto</li> <li>• Kolme USB 2.0 -porttia, DC 5 V</li> <li>• Hälytysjärjestelmä kahdella hälytysliitännällä (paikallisia ja etähälytyksiä varten)</li> <li>• Älykäs virheidenhallinta näytteiden suojaamista varten.</li> </ul>

**Muut tiedot**

## Kapasiteetit

- 20 vapaasti mukautettavaa protokollaa.  
4 ennakkoon määritettyä protokollaa. Ennakkoon määritetyt ksyleeniprotokollat sisältävät korkeintaan 10 reagenssikäsittelyvaihetta ja 3 parafiinikäsittelyvaihetta. Ennakkoon määritetyt ksyleenittömät protokollat sisältävät korkeintaan 8 reagenssikäsittelyvaihetta ja 3 parafiinikäsittelyvaihetta.
  - Aika per protokollan vaihe: 0–5 999 minuuttia.
  - Viiveaika: enint. 1 000 tuntia.
- Samanaikaisesti voidaan käsitellä korkeintaan 400 kasettia.
- 1 ennakkoon määritelty tislusastian puhdistusprotokolla.

## 4. Instrumentin alkuasetukset

### 4.1 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

- On käyttäjän vastuulla varmistaa, että sähkömagneettinen ympäristö on jatkuvasti instrumentin oikeanlaiselle toiminnalle sopiva.
- Asennuspaikan on oltava suojattu sähköstaattisilta purkauksilta.
- Instrumentissa käytetyt kemikaalit ovat helposti syttyviä ja terveydelle vaarallisia. Siksi asennuspaikan on oltava ilmanvaihdoltaan hyvä eikä se saa sisältää avotulta. Instrumentin asennushuone ei saa olla ihmisten jatkuvaan käyttöön tarkoitettu tila. Muussa tapauksessa huoneessa on oltava poistojärjestelmä.
- Älä käytä instrumenttia huoneissa, joissa on räjähdysvaara.
- Vältä tärinää, suoraa auringonvaloa ja suuria lämpötilamuutoksia.
- Instrumentin asennusalueen tulisi olla noin 900 mm x 800 mm.
- Asennuspinnan kuormakapasiteetin ja jäykkyyden on oltava riittävä instrumentin painoon nähden.
- Instrumentti on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Jotta instrumentin oikea toiminta voidaan varmistaa, se on asennettava vähintään 80 mm:n päähän seinistä ja huonekaluista.
- Laite on sijoitettava paikkaan, jossa sen erottaminen virtalähteestä on helppoa. Virtajohtojen on oltava paikassa, johon on helppo päästä käsiksi.
- Jatkojohtoja ei saa käyttää.
- Instrumentti on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä vain paikalliseen virtalähteeseen sopivia, pakkauksen mukana tulleita virtajohtoja.

### 4.2 Vakiotoimitus - pakkausluettelo

Määrä	Osan kuvaus	Tilausno
1	HistoCore PEGASUS Plus -perusinstrumentti	14 0488 58008
1	HistoCore I-Scan -sarjat	14 0488 60946
1	Telineen koukku	14 0488 58177
4	Kasettiteline	14 0488 58160
4	Siniset kiinnikesarjat datamatriisilla	14 0488 58176
4	Mustat kiinnikesarjat datamatriisilla	14 0488 58173
10	Tulostetut viivakooditarrat	14 0488 60133
1	Reagenssipullokokoonpano	14 0488 57899
2	Pullon korkki	14 0488 57901
2	Parafinialtaan ilmanvaihtotulppa	14 0488 58088

Määrä	Osan kuvaus	Tilausno
1	Poistojärjestelmän käyttöliittymä	14 0493 53387
1	Aktiivihilisuodatin	14 0488 58136
1	Reagenssien etätäyttö-/tyhjennysletku	14 0488 60134
1	Parafiinin etätyhjennysletku	14 0488 60135
1	Parafiinikaavin	14 0393 53643
1	Molykote 111 -rasva, 100 g	14 0336 35460
20	O-rengas	14 0493 51361
2	Pullojen tarramerkitäsarjat	14 048860131
1	Pullon tarranumerosarja	14 0488 60148
1	Lisätarviketaskun määrittäminen	14 0488 60153
1	Ristiliitin 21,85 x 5 mm	14 6000 05407
1	Tippa-astia	14 0488 59324
1	Tasoanturiharja	14 0488 58099
2	Puskuri	14 0488 59321
4	M4x8, EN ISO 7380	14 3000 00065
2	M6x35 ISO4762, täysin kierteitetty	14 3000 00537
1	Suora ruuvitaltta	14 0488 60138
1	Kuusiokoloavain, koko 2,5	14 0488 60139
1	Kuusiokoloavain, koko 3,0	14 0488 60140
1	Kuusiokoloavain, koko 4,0	14 0488 60141
1	Kuusiokoloavain, koko 5,0	14 0488 60137
2	Kiintoavain, 17 mm	14 0488 60142
1	Käyttöohjeet (tulostettu englanniksi, muut kielet saatavilla tiedonsiirrossa 14 0488 80200)	14 0488 80001

Jos pakkauksen mukana tullut paikallinen virtajohto on viallinen tai se on kadonnut, ota yhteyttä paikalliseen Leica-edustajaan.



#### Huomaa

- Vertaa kaikkia toimitettuja osia pakkausluetteloon ja tekemäsi tilaukseen varmistaaksesi, että kaikki osat on toimitettu. Ota viipymättä yhteyttä Leica Biosystems myyntitoimistoon, jos havaitset jotakin poikkeavaa.

### 4.3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus

#### 4.3.1 Avaamisohjeet



##### Varoitus

Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana

##### Näytteiden vauriot

- Pakkauksessa on kaksi ilmaisinta, ShockDot-iskuosoitin (→ Kuva 3-1) ja kallistuksen osoitin (→ Kuva 3-2), jotka osoittavat, onko pakkaus kuljetettu oikein. Kun instrumentti toimitetaan, tarkista ensin nämä ilmaisimet. Jos yksi osoittimista on lauennut, pakkausta ei ole käsitelty määrätyllä tavalla. Merkitse se tässä tapauksessa kuljetusasiakirjoihin ja tarkista, onko laitteessa vaurioita.



##### Varoitus

Lisätarvikkeet voivat pudota käyttäjien päälle, kun pakkausta avataan.

##### Henkilövamma

- Noudata avaamisohjeita huolellisesti, jotta instrumentin vauriot voidaan välttää.
- Instrumentin pakkauksen avaamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kun instrumentti on poistettu pakkauksesta, se on kuljettava vain pystyasennossa.




Kuva 3

Varmista riittävä pinta-ala instrumentin pakkauksen avaamista varten. Etäisyyden pakkauksen ja seinien välillä on oltava vähintään 1 m molemmilla sivuilla ja takana. Edessä etäisyyden on oltava vähintään 3 m, sillä instrumentti siirretään lavalta eteenpäin. Huoneen korkeuden on oltava vähintään 3,2 m, sillä pakkaus on poistettava vetämällä sitä ylös.

1. Tuo instrumentin pakkaus (→ Kuva 3-3) mahdollisimman lähelle lopullista asennuspaikkaa. Poista hihnat (→ Kuva 3-4).



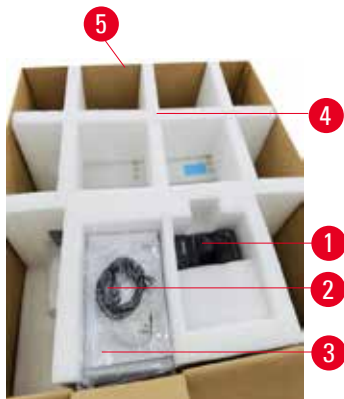

Kuva 4

2. Avaa pakkaus ja poista näyttö (→ Kuva 4-1), virtajohto (→ Kuva 4-2) ja käyttöohjeet (→ Kuva 4-3) kuljetusankkurista (→ Kuva 4-4).
3. Ota vaahdosta valmistettu kuljetusankkuri ulos.
4. Poista pakkauksen ulkopuoli (→ Kuva 4-5) lavasta vetämällä sitä ylös.



Kuva 5

5. Pieni pakkauslaatikko (→ Kuva 5-1) sisältää lisävarvikkeet, joita ei ole vielä asennettu instrumenttiin. Aseta pieni pakkauslaatikko varovaisesti sivuun.
6. Poista muovinen pölysuoja instrumentin päältä varovaisesti.



Kuva 6

7. Poista ruuvit (→ Kuva 6-1), jotka kiinnittävät instrumentin lavaan. Poista ensin neljä kulmissa sijaitsevaa ruuvia. Se tulee tehdä niin, että kaksi henkilöä löystävät vastakkaisten kulmien ruuveja vuorotellen kiintoavaimilla. Irrota sitten etu- ja takaosan ruuvit.
8. Vedä instrumentin alta ulos kaksi levyä (→ Kuva 6-2) ramppia varten.
9. Kiinnitä nämä levyt oikealle ja vasemmalle lavan uraan niin, että ne ovat samassa linjassa instrumenttia tukevan puisen levyn kanssa.
10. Vapauta sitten kahden etupyörän jarrukytkimet, jotta instrumenttia voidaan siirtää.

**Varoitus**

Instrumentti kallistuu, kun se liikkuu ensimmäisen asennuskerran aikana.

**Henkilövamma**

- Instrumentin kannattelemiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, kun instrumentti siirretään pois lavalta rampin avulla.




Kuva 7

11. Tue instrumenttia yläkulmista molemmin käsin, kun sitä siirretään alas lavalta.
12. Kun instrumentti on siirretty alas lavalta, se voidaan siirtää sen lopulliseen asennuspaikkaan.
13. Kun instrumentti on asennuspaikassaan, pyörien jarrut on otettava jälleen käyttöön. Pyörät voidaan lukita painamalla vivut takaisin alas.

**Huomaa**

- Kuljetuslaatikko ja sen sisältämät kiinnityselementit tulee säilyttää siltä varalta, että laite joudutaan palauttamaan. Jos instrumentti on palautettava, noudata yllä olevia ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

## 4.3.2 Näytön asennus

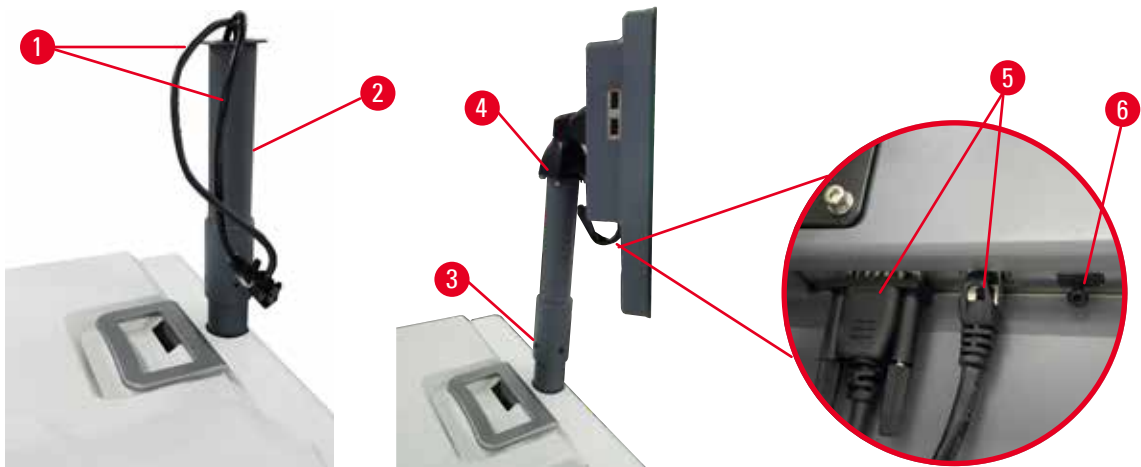

Kuva 8

1. Ohjaa kaksi kaapelia (→ Kuva 8-1) näytön tukikiinnikkeen (→ Kuva 8-2) läpi.
2. Kiinnitä näytön tukikiinnike kiinnittämällä sen alareunan neljä ruuvia (→ Kuva 8-3).
3. Asenna näyttö kiinnittämällä siihen näytön tukikiinnikkeen yläreunassa olevat neljä ruuvia (→ Kuva 8-4).
4. Kytke kaksi kaapelia (→ Kuva 8-5). Kaapelit eivät sovellu hotplug-toimintoon.
5. Poista muovitulppa (→ Kuva 8-6) USB-portista ja kytke siihen skannerin johto.

## 4.3.3 Aktiivihiilisuodatin

**Varoitus**

Riittämätön poistojärjestelmä tai ei poistojärjestelmää / poistojärjestelmä liitetty virheellisellä tavalla  
**Henkilövamma vuotaneen höyryn tai liiallisten kaasujen vuoksi**

- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihiilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.
- Suosittelemme ulkoisen poistojärjestelmän käyttöä.
- Vaikka instrumentti olisikin yhdistetty ulkoiseen poistojärjestelmään, toimitettua aktiivihiilisuodatinta on silti käytettävä.

Aktiivihiilisuodatin absorboi reagenssihöyryjä ja estää niitä pääsemästä laboratorion ilmaan. Aktiivihiilisuodatin on vaihdettava säännöllisesti, jotta sen tehokas toiminta voidaan varmistaa. Esihenkilöt voivat määrittää vaihtotiheyden napauttamalla kohtaa **Carbon filter threshold (Aktiivihiilisuodattimen raja-arvo)** näytössä **Settings (Asetukset) > Instrument settings (Instrumentin asetukset)**.

Aktiivihiilisuodatin voidaan asettaa paikalleen / vaihtaa avaamalla etätäyttö-/tyhjennysuojus (→ Kuva 9-1). Työnnä aktiivihiilisuodatin (→ Kuva 9-2) sitten niin pitkälle kuin mahdollista. Aktiivihiilisuodattimen asetuspäivä voidaan merkitä etuosan merkintöihin.

## 4 Instrumentin alkuasetukset



Kuva 9

### 4.3.4 Ulkoinen poistojärjestelmä



#### Varoitus

Riittämätön poistojärjestelmä tai ei poistojärjestelmää / poistojärjestelmä liitetty virheellisellä tavalla

#### Henkilövamma vuotaneen höyryn tai liiallisten kaasujen vuoksi

- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihiilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.
- Suosittelemme ulkoisen poistojärjestelmän käyttöä.
- Vaikka instrumentti olisikin yhdistetty ulkoiseen poistojärjestelmään, toimitettua aktiivihiilisuodatinta on silti käytettävä.

Instrumentti on suunniteltu yhdistettäväksi ulkoiseen poistojärjestelmään. Valinnainen toimitus sisältää poistoletkun tätä tarkoitusta varten. Suosittelemme ulkoisen poistojärjestelmän käyttöä.



Kuva 10

Liitä poistoletkun toinen pää poistolaipan ylös osoittavaan letkupäähän (→ Kuva 10-1) ja työnnä sitä mahdollisimman pitkälle alas. Liitä poistoletkun toinen pää ulkoiseen poistoasemaan.

## 4.4 Perustason instrumentti/-laitteisto

### 4.4.1 Tislausastiat



Kuva 11

Tislausastioita on kaksi, ja niihin molempiin mahtuu 200 kasettia kahdessa kasettitelineessä. Molemmat tislausastiat toimivat toisistaan erillisinä: niiden lämpötila-, paine- ja sekoittimen käyttöasetukset voivat olla erilaisia. Järjestelmä aikatauluttaa resursseja niin, että molemmat tislausastiat toimivat tehokkaasti. Aikataulutus mahdollistaa sen, että samanaikaisesti ajettavat protokollat eivät käytä samaa reagenssipulloa samaan aikaan.

Kahden tislausastian kannet lämmitetään protokollien ajamisen aikana, mikä vähentää vaarallisten höyryjen hengittämisen riskiä, kun tislausastioiden kannet avataan, kun protokolla keskeytetään, lopetetaan tai suoritetaan loppuun.

#### Tislausastioiden kansien avaaminen ja sulkeminen


Käytä tislausastioiden kansien lukitsemiseen/avaamiseen instrumentin edessä olevia kahvoja.

Avaa tislausastia kääntämällä kahvaa myötäpäivään (→ Kuva 11-1) ja avaa tislausastian kansi nostamalla sen etuosaa (→ Kuva 11-2). Älä yritä kangeta kahvaa. Tislausastia voidaan lukita työntämällä kahva takaisin paikalleen käyttäen jonkin verran voimaa.

Huomioi tislausastian avaamisen yhteydessä aina sen sisältö, lämpötila ja paine. Joissain tapauksissa tislausastian paine ja lämpötila on asetettava manuaalisesti ennen kuin se voidaan avata turvallisesti.

Saatat nähdä varoituksen, jos tislausastian lämpötila on suurempi kuin tislausastian tyhjä käyttölämpötila (näkyvä näytöllä kohdassa **Settings (Asetukset) > Processing settings (Käsittelyasetukset)**) tai turvallinen käyttölämpötila, joka liittyy tislausastiassa olevaan reagenssiin (määritetään näytöllä **Reagents (Reagenssit) > Reagent types (Reagenssityypit) > Temperature thresholds (Lämpötilaraja-arvot)**).

Kiireellisissä tapauksissa, jos tislausastian kansi on lukittu magneettisen toimintahäiriön takia eikä sitä voida nostaa, nosta ylös musta suojuus (→ Kuva 12-1) tislausastian kahvan vieressä, aseta aukkoon suora ruuvitaltta ja pidä se siinä asennossa. Tämä vapauttaa sähköisen lukon. Tislausastian kansi voidaan nyt avata. Poista sitten suora ruuvitaltta ja aseta musta suojuus takaisin paikalleen.

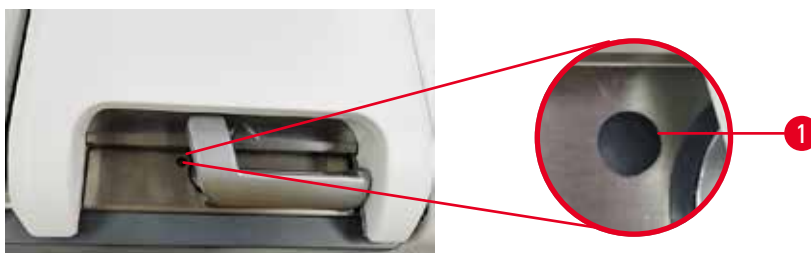

Kuva 12



### Varoitus

Jos tislusastia avataan, kun instrumentti on käsittelyn keskellä / keskeyttämisen jälkeen / protokollan päättymisen jälkeen, käyttäjä joutuu kosketuksiin tislusastian kannen/telineen kuuman pinnan / vaarallisten aineiden/höyryn kanssa.

Jos tislusastia avataan, protokolla ei voi jatkua.

#### Henkilövamma / näytteen vaurioituminen / vaarantuneet näytteet

- Kuuma pinta. Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia käytön aikana.
- Älä avaa tislusastian kantta tai poista reagenssipulloja / parafiinilämmittimen suojusta / parafiinialtaita, kun protokolla on käynnissä, ellei järjestelmän viesti pyydä sinua tekemään niin. Jos haluat poistaa näytteitä tislusastiasta tai lisätä näytteitä tislusastiaan, kun protokolla on käynnissä, paina keskeytyspainiketta.
- Ole varovainen, jos avaat tislusastian tai parafiinialtaan instrumentin toiminnan keskeyttämisen jälkeen. Lue kaikki varoitusviestit (esim. tislusastia on liian kuuma eikä siihen voi koskea turvallisesti) ja noudata soveltuvia varotoimenpiteitä ennen jatkamista.
- Sulanut parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Ole varovainen, kun käsittelet parafiinia ja poistat telineitä.



### Varoitus

Tislusastian avoimiin kansiin osuu jokin.

#### Henkilövamma. Sormet tai kädet voivat murskautua.

- Älä osu tislusastian avoimiin kansiin.

### Tislusastian ilmanpoisto

Varmista ennen tislusastian kannen avaamista, ettei tislusastiassa ole painetta tai tyhjiötä. Tislusastioiden ilma poistetaan automaattisesti protokollan alussa ja lopussa sekä protokollan tauon aikana. Sinun on mahdollisesti poistettava tislusastian ilma manuaalisesti, jos automaattinen poisto epäonnistuu tai jos haluat avata paineistetun tai tyhjiökäytössä olevan tislusastian muina aikoina.

Näytössä **Reagents (Reagenssit) > Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** on manuaalisen tislusastian ilmanpoiston vaihtoehto. Valitse avattava tislusastia ja napauta **Vent (Ilmanpoisto)**-painiketta kyseisen tislusastian kohdalla. Paineen tasaantuminen voi kestää jopa 90 sekuntia.


**Huomaa**

- Jos jätät kuuman tislusastian suljetuksi pitkäksi aikaa, tislusastian ilma jäähtyy ja aiheuttaa tyhjiöreaktion. Tislusastian ilma on siinä tapauksessa poistettava, jotta tislusastian kansi voidaan avata.

**Täyttötasot**

Kuva 13

Tislusastiat voidaan täyttää kahteen kasettelineeseen riittävillä reagensseilla. Reagenssipullojen (→ Kuva 13-1) ja parafiinialtaiden (→ Kuva 13-2) merkinnät auttavat sinua päättämään, onko reagenssien lisääminen tarpeen, jotta tislusastiat voidaan täyttää vaaditulle tasolle. Varmista, että reagenssi- ja parafiinitasot ovat aina selkeästi yli vähimmäistason (**MIN**), mutta alle enimmäistason (**MAX**). Vähimmäistason matalammat reagenssitasot aiheuttavat joko protokollien epäonnistumisen tai aiheuttavat heikentyneiden reagenssijaksojen käyttöä.

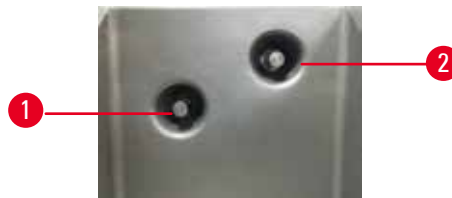**Nestetasoanturit**

Kuva 14

Molemmissa tislusastioissa on kaksi nestetasoanturia, jotka valvovat nestetasoja. Alempi anturi (→ Kuva 14-1) seuraa kahden telineen tasoa. Ylempi anturi (→ Kuva 14-2) laukeaa, jos tislusastiasa on enimmäistilavuutta enemmän nestettä. Se toimii turvallisuustoimintona.

Joskus antureiden toimintaan saattavat vaikuttaa kondensaation tai kertyneen materiaalin kertymät. Varmista, että anturit pidetään aina puhtaana osana säännöllistä tislusastian puhdistusta (→ s. 150 – 9.3.1 Joka päivä).

## 4 Instrumentin alkuasetukset

### Magneettinen sekoitin




Kuva 15

Molemmissa tislusastioissa on magneettinen sekoitin (→ Kuva 15-1), joka sekoittaa reagenssia tai parafinia ja varmistaa tasaisen lämpötilan ja hyvän kudoksen läpäisevyyden. Sekoitin toimii magneettisesti kytketyn ulkoisen moottorin avulla. Sekoitin voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erikseen jokaisessa protokollan vaiheessa ja se voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten (→ s. 150 – 9.3.1 Joka päivä).

### Tislusastian siivilä

Molemmissa tislusastioissa on pohjalla siivilä. Asenna siivilä asettamalla se paikalleen ja kääntämällä sitä myötäpäivään. Tarkista ja puhdista se säännöllisesti (→ s. 150 – 9.3.1 Joka päivä).

#### 4.4.2 Kasettitelineet

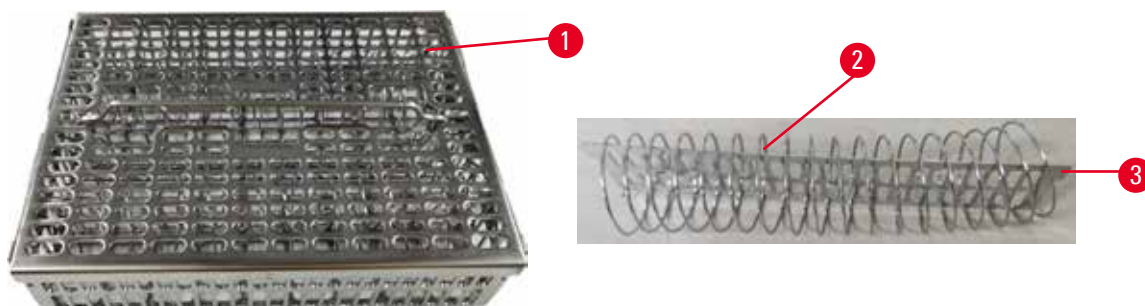

Kuva 16

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kasettitelineet (→ Kuva 16-1) sopivat useimmille tavallisille kasettityypeille. Käytä telineitä käsittelyn aikana. Älä aseta näytteitä suoraan tislusastiaan.

Telineen (→ Kuva 16-2) jousia käytetään varmistamaan, että telineessä olevat kasetit ovat suorassa linjassa ja telineen jakolevyn (→ Kuva 16-3) kanssa, kun se asetetaan telineeseen.



Telineeseen voidaan asettaa korkeintaan 72 näytekasettia jousen kanssa. Ilman jousia kasetit voidaan täyttää tiiviimmin, jolloin telineeseen mahtuu enintään 100 kasettia.

Jousella varustettu teline varmistaa parhaan mahdollisen reagenssien virtauksen minimaalisella siirtymällä ja sitä on käytettävä kaikissa ksyleenittömissä protokollissa.


### Telineen suojus, telineen kahva ja telineen koukku

Telineen suojus sopii tiiviisti telineen verkon ylle, ja sen sisäreunojen kaksi korvaketta sopivat verkon yläreunoissa oleviin aukkoihin. Voit poistaa telineen suojuksen tarttumalla sen sivuihin tukevasti ja nostamalla sitä ylös.

Telineen kahva on upotettu telineen keskiakselin kohdalle ja se voidaan nostaa ylös. Telineen kahva sopii keskellä olevaan aukkoon, mutta pieni osa siitä jää telineen suojuksen ylle. Se toimii yläpuolelle pinotun telineen pysäyttimenä, jotta yläteline ei pääse putoamaan siirtämisen aikana.

Instrumentin mukana toimitetaan telineen koukku. Käytä koukkuja, kun nostat telineen tislusastiasta.

### Telinekiinnikkeet

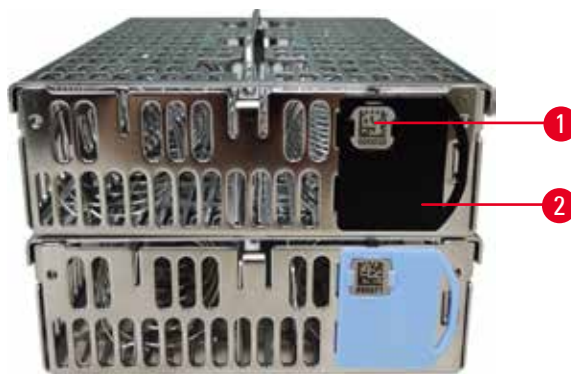


Kuva 17

Telinekiinnikkeitä (→ Kuva 17-2) voidaan käyttää suositelluissa protokollissa eli yhdistämään tietyt telineet tiettyihin protokolleihin. Telinekiinnikkeitä on kahta väriä: sinisiä ja mustia.

Molempien telineiden kanssa tulee yksi kiinnikepari. Yhteen parin kiinnikkeeseen on painettu ainutlaatuinen viivakoodi (→ Kuva 17-1). Se voidaan skannata ennen kuin teline asetetaan tislusastiaan. Tunnistettu viivakoodi tallennetaan yhdessä muiden prosessiajon tietojen kanssa (→ s. 144 – 8.3.4 [Seurantavaihtoehto](#)). Kun viivakoodi on skannattu ja telineen kuva on otettu, teline voidaan asettaa tislusastiaan.

Suosittellemme käyttämään Leica Biosystemsin ennakoon määrittämiä / validoimia käyttötarvikkeita (telineitä ja kasetteja).

## 4.4.3 Parafiinialtaat

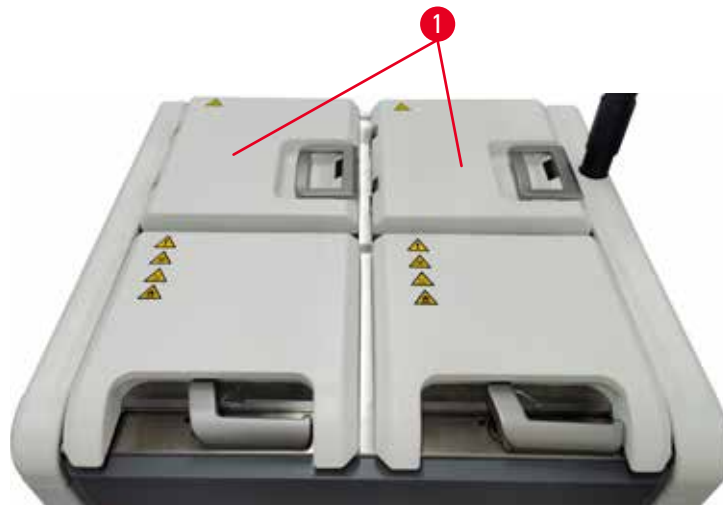

Kuva 18

Instrumentin neljä parafiiniallasta sijaitsevat sen takaosassa ylhäällä, ja niitä suojaavat kaksi parafiinialtaiden kantta (→ [Kuva 18-1](#)). Kaikki altaat toimivat toisistaan erillisinä ja ne sisältävät riittävästi parafiinia tislauksastian täyttämiseen. Vaikka parafiini ei siirry altaasta toiseen, ne on yhdistetty ilmavirtausta varten, joten niiden paine on aina sama.

Käytä parafiinialtaiden kansien avaamiseen kansien kahvoja. Ole varovainen, kun avaat parafiinialtaiden kansia. Käännä näyttöä, jos se on tarpeen parafiinialtaan käsittelyä varten (→ [Kuva 23](#)). Sulje parafiinialtaiden kannet aina kahvoilla ja varmista, että kannet ovat kunnolla kiinni.

Varmista aina ennen parafiinialtaan kannen avaamista, että parafiinialtaan paine on ympäristön paineen tasolla. Jos paine poikkeaa ympäristön paineesta, poista ensin parafiinialtaan ilma. Sen voi tehdä, kun protokollan ajo keskeytetään tai kun instrumentti ei ole käytössä. Käytä **Vent (Ilmanpoisto)**-painiketta näytössä **Reagents (Reagenssit) > Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** (→ s. 129 – 8.1.1 Manuaaliset toiminnot).

Voit tarkastella parafiiniasemien tämän hetkistä lämpötilaa kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat) > Paraffin chambers (Parafiinisäiliöt)**.

Voit asettaa instrumentin puhdistamaan parafiinialtaan parafiinin riippuen käyttämästäsi parafiinista (→ s. 139 – 8.3.2 Käsittelyasetukset).

Tyhjennä käytetty parafiini näytön **Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)** komennoilla. Täytä parafiinialtaat suoraan sulaneella tai kiinteällä parafiinilla (→ s. 126 – 7.4.5 Parafiinin vaihtaminen).

**Varoitus**

Parafinialtaan kansi avataan, kun tislusastiassa on parafiinia tai parafiinia siirretään.

**Henkilövamma**

- Älä koskaan avaa parafinialtaan kantta, kun tislusastiassa on parafiinia tai parafiinia siirretään. Kuumaa parafiinia voi roiskua altaasta.

**Varoitus**

Parafinialtaan avoimiin kansiin osuu jokin.

**Henkilövamma**

- Ole varovainen, jotta avoimiin parafinialtaan kansiin ei osu mitään. Ne voivat murskata sormet tai kädet.

#### 4.4.4 Reagenssikaappi



Kuva 19

Reagenssikaappiin mahtuu 17 reagenssipulloa ja yksi kondensaattipullo (→ Kuva 19-1). Pullot ovat läpinäkyviä, jotta pullojen reagenssitason tarkastaminen on helpompaa.

Reagenssikaapissa on taustavalo. Jos pullon reagenssitaso ei ole raja-arvojen mukainen, pullon takana oleva valo vilkkuu. Vaihda reagenssi välittömästi.

#### Reagenssipullot

Reagenssikaappiin mahtuu 17 reagenssipulloa. Reagenssimäärä riittää molempien tislusastioiden aikataulutettuihin protokoliin sekä mahdolliseen puhdistusreagenssien käyttöön. Jokaisen aseman reagenssipullo sisältää riittävästi reagenssia yhden tislusastian täyttämiseen.

Reagenssipullot ovat läpinäkyviä ja niiden merkinnät on värikoodattu. Niiden etuosassa on myös merkinnät, jotka osoittavat ajon vähimmäistason (→ Kuva 20-1) ja enimmäistäyttötason (→ Kuva 20-2).



Kuva 20

Reagenssipullo voidaan poistaa vetämällä se ulos. Se voidaan palauttaa paikalleen painamalla se takaisin sisään. Pullo asettuu liitäntäkohtaansa kaapin takaosassa ja päästää napsahdavan äänen.

Reagenssipullon reagenssi voidaan vaihtaa seuraavilla tavoilla:

- manuaalisesti, kun reagenssipullo on poistettu instrumentista
- puolimanuaalisesti, kun reagenssipullo on edelleen paikoillaan reagenssikaapissa, mutta se täytetään näytön **Reagents (Reagenssit)** > **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)** komentojen avulla (→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen).

Jotkin kemikaalit saattavat aiheuttaa reagenssipullojen laajenemista ajan myötä. Tämä on normaalia eikä se vaikuta instrumentin toimintaan.



### Varoitus

Instrumentti on käynnissä, vaikka reagenssipulloja puuttuu tai reagenssipullojen korkit ovat löysällä tai ne puuttuvat kokonaan.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Ympäristön kontaminaatio.**

- Älä koskaan käytä instrumenttia, jos siinä ei ole kaikkia tarvittavia reagenssipulloja tai pullojen korkit ovat löysällä tai puuttuvat kokonaan.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.

### Kondensaattipullo

Kondensaattinestettä kerää erillinen pullo. Se on reagenssipullojen vieressä reagenssikaapin alemmassa osiossa. Tyhjä kondensaattipullo viikottain. Älä anna kondensaattipullon vuotaa yli, sillä kondensaattineste voi kontaminoida muita reagensseja.

**Varoitus**

Instrumentti on käynnissä, vaikka kondensaattipullo puuttuu tai kondensaattipullon korkki on löysällä tai se puuttuu kokonaan.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Myrkyllisten/vaarallisten höyryjen vuotamisen aiheuttama biologinen vaara.**

- Älä koskaan käytä instrumenttia ilman kondensaattipulloa tai jos kondensaattipullon korkki on löysällä tai se puuttuu kokonaan.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihiilisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää, sillä se voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.

**Reagenssipullojen tarramerkinnyt**

Kuva 21

Reagenssipullojen merkintöjä on kahdeksassa värissä. Väritykset on sovitettu instrumentin yksittäisten reagenssiryhmien valittavien värien palettiin. Merkitse reagenssipullot aseman **Tila**-näytön määritelmien mukaisesti.

Nelikulmaiset merkinnät (→ Kuva 21-1) liimataan reagenssipullojen etuosaan. Pyöreät merkinnät (→ Kuva 21-2) liimataan reagenssipullojen korkkeihin. Reagenssipullojen pintojen on oltava puhtaita ja kuivia, kun merkinnät kiinnitetään niihin. Paina erityisesti reunat hyvin paikalleen. Merkinnät kestävät instrumentissa käytettäviä reagensseja.

**4.4.5 Tippa-astia**

Kuva 22

Tippa-astia sijaitsee muiden lisätarvikkeiden kanssa instrumentin pakkauksessa. Työnnä tippa-astia (→ Kuva 22-1) reagenssikaapin alle.

Tippa-astia kerää ylivuotaneet tai läikkyneet reagenssit, jotta instrumentin sisäosat tai sen alapuoli eivät saastuisi. Tilavuus on vähintään 3,88 l.

Tippa-astia on tarkistettava säännöllisesti vuotaneiden reagenssien varalta. Tippa-astian voi tarkistaa vetämällä sen ulos kahvan avulla. Tyhjennä se tarvittaessa ja työnnä se sitten takaisin paikalleen.



### Varoitus

Tippa-astiaa ei ole asennettu tai se on asennettu virheellisesti, jolloin nestettä vuotaa lattialle.

#### Henkilövamma.

#### Ympäristön kontaminaatio.

- Älä käytä instrumenttia ilman tippa-astiaa.
- Käytä henkilönsuojaimia, kun käytät instrumenttia.

### 4.4.6 Näyttö

Instrumentin oikealle puolelle kiinnitetty kosketusnäyttö on liitetty instrumentin tietokoneeseen, joka hallitsee kaikkia instrumentin toimintoja.

Käytä kosketusnäyttöä instrumentin määrittämiseen, protokollien ajamiseen ja aputoimintojen suorittamiseen, kuten reagenssien vaihtamiseen. Napauta painikkeita ja kuvakkeita sormellasi tai tylpällä esineellä. Älä käytä teräviä esineitä. Varmista, ettei kosketusnäyttö joudu kosketuksiin voimakkaiden liuottimien kanssa.

Kosketusnäyttö on tavallisessa käyttöasennossaan parafiinialtaan kannen päällä, mutta näyttöä voidaan kääntää, jotta parafiinialtaaseen pääsee käsiksi alla olevan kuvan mukaisesti (→ Kuva 23). Sitä voidaan kääntää myös hieman ylös tai alas käyttäjän pituuden huomioiden.



Kuva 23

## 4.4.7 HistoCore I-Scan






Kuva 24

HistoCore I-Scan sijaitsee kosketusnäyttöä tukevassa telineessä olevassa pidikkeessä. USB-kaapeli kuljettaa sekä virtaa että tietoja skannerin ja instrumentin välillä.

1D/2D-viivakoodin skannaaminen ja kuvan kuvaaminen. Sen avulla voi nopeasti syöttää käyttäjätunnuksen, telinekiinnikkeen tunnuksen (→ s. 41 – Telinekiinnikkeet) ja reagenssin erän tai valmistuserän numeron ja ottaa kuvia telineistä.

Skanneria voidaan käyttää kolmen painikkeen (→ Kuva 24-1) avulla.

Painike	Nimi	Toiminto
	Lisä-LED-valon virtapainike	Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kameran valon.
	Skannauksen/kuvaamisen laukaisinpainike	<p>Viivakoodin skannaustilassa skannauspalkki kulkee näytöllä, mutta tähdätyn viivakoodin esikatselu ei ole näkyvissä. Kun laukaisinpainiketta painetaan, skanneri skannaa viivakoodin. Valo syttyy ja tähtäinvalo on näkyvissä. Skanneri lähettää viivakoodisisällön instrumenttiin, kun viivakoodi on tunnistettu. Skanneri näyttää valintamerkin, kun instrumentti on vastaanottanut tiedot onnistuneesti, tai varoitusmerkin, jos lähetyksessä oli ongelmia.</p> <p>Kuvaustilassa LCD-näytössä näkyy kameran esikatselu. Paina laukaisinpainiketta, niin kamera tarkentaa kohteeseen ja ottaa siitä kuvan. Näytössä näkyy valintamerkki, kun instrumentti on vastaanottanut kuvan onnistuneesti, tai varoitusmerkki, jos lähetyksessä oli ongelmia. Käsien tärinä tarkentamisen ja kuvan ottamisen aikana aiheuttaa epäselviä kuvia. Kameran tarkentaminen ja kuvan ottaminen kestää noin 2 sekuntia.</p>

Painike	Nimi	Toiminto
	Valintamerkki	Vahvistaa tiedot ja siirtyy seuraavaan täytettävään kenttään.


Jos viivakoodin vahvistus epäonnistuu, yritä skannata se uudelleen. Suositeltava skannausetaisyys on seuraavanlainen:

- EAN-13 50–200 mm (13 milj.)
- Code39 40–90 mm (5 milj., 10 tavua)
- QR-koodi 25–240 mm (20 milj., 16 tavua)
- Datamatriisi 50–90 mm (10 milj., 20 tavua)
- PDF 417 30 130 mm (6,67 milj., 7 tavua)

Jos varoitusmerkki ei poistu, irrota skanneri instrumentista ja yhdistä se sitten uudelleen. Jos tämä ei auta, käynnistä instrumentti uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoedustajaan.

Skanneri siirtyy lepotilaan, jos sen painikkeita ei paineta tai se ei vastaanota komentoja 5 minuuttiin. Lepotilassa LCD-näyttö sammuu. Instrumentin mikä tahansa komento tai painikkeen painaminen herättää skannerin.

#### 4.4.8 USB-portit

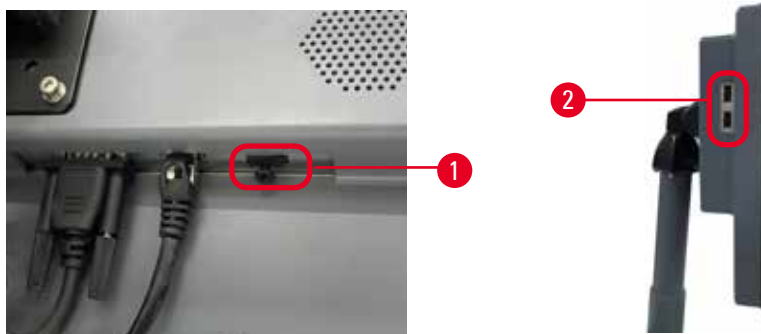

Kuva 25

Näytössä on kolme USB-porttia, yksi (→ Kuva 25-1) sen alareunassa ja kaksi (→ Kuva 25-2) näytön vasemmalla sivulla.

Näytön alareunassa olevaa USB-porttia suositellaan käytettäväksi skannerille (ja tämä on laitteiston oletusmääritys).

Kahta muuta USB-porttia voidaan käyttää:

- lokien ja tapahtumaraporttien viemiseen
- protokollatiedostojen viemiseen ja tuomiseen.

Suosittellemme virusten varalta tarkistetun USB-muistitikun käyttöä, jotta varmistetaan, että virukset eivät pääse saastuttamaan instrumenttia.



Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään tietojen siirtämistä varten. Jos sinua pyydetään käyttämään USB-muistitikku, instrumentti ei tunnista USB-muistitikkuasi. Yritä asettaa USB-muistitikku uudelleen. Jos se ei toimi, tarkista, onko USB-muistitikulla riittävästi tilaa ja että se toimii kunnolla. Jos ongelma jatkuu, käytä toista muistitikku.

#### 4.4.9 Hälytysliitännät




##### Varoitus

Paikallinen hälytys / etähälytys ei ole yhdistetty.

##### Näytteiden vauriot

- Paikallinen tai etähälytysjärjestelmä on liitettävä instrumenttiin.

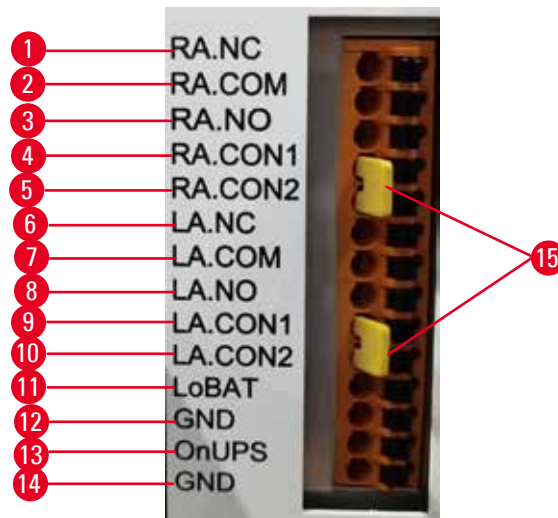

Kuva 26

Instrumentissa on käyttöliittymät paikallisille ja etähälytyksille. Näitä liitäntöjä voidaan käyttää erilaisten hälytyslaitteiden toteuttamien hälytysten hallitsemiseen, mukaan lukien äänihälytykset, visuaaliset hälytykset ja automaattiset puhelut.

Kahden ristiliittimen (→ Kuva 26-15) tarkoituksena on kertoa instrumentille, onko se liitetty hälytysjärjestelmään. Jos instrumentti on liitetty etä- tai paikalliseen hälytysjärjestelmään, ristiliittimet tulee liittää vastaavaan RA.CON- tai LA.CON-liitäntään. Jos instrumenttia ei ole liitetty etä- tai paikalliseen hälytysjärjestelmään, ristiliittimiä ei tule liittää; tämä tarkoittaa, että instrumentin konfiguraation ei tulisi olla koskaan kuvassa esitetyn kaltainen (→ Kuva 26) (liittimet on liitetty, kun hälytyksiä ei ole liitetty).

#### Hälytysliitännöiden tekniset tiedot

Hälytysliitäntään yhdistetty kuormitus ei saa ylittää seuraavia teknisiä tietoja.

- Enimmäisjännite: 30 V DC
- Enimmäisvirta: 1 A (resistiivinen kuorma)
- Enimmäisvirta: 0,5 A (induktiivinen kuorma)

### Hälytysliittimen piikit

Jokaisessa hälytysliitännässä on kolme piikkiä.

#### Etähälytys

**RA.NC** (→ Kuva 26-1) -- Yleensä suljettu; **RA.COM** (→ Kuva 26-2) -- Tavallinen; **RA.NO** (→ Kuva 26-3) -- Yleensä avoin

#### Paikallinen hälytys

**LA.NC** (→ Kuva 26-4) -- Yleensä suljettu; **LA.COM** (→ Kuva 26-5) -- Tavallinen; **LA.NO** (→ Kuva 26-6) -- Yleensä avoin

### Piikkikaavio tavallisen käytön aikana

Kun instrumentti toimii tavallisesti (ei hälytyksiä), hälytyspiikit liitetään alla kuvatulla tavalla.

#### Etähälytys

Piikki **RA.NO** -- Yleensä avoin; Piikki **RA.NC** -- Yleensä suljettu ja yhdistetty kohtaan **RA.COM**

#### Paikallinen hälytys

Piikki **LA.NO** -- Yleensä avoin; Piikki **LA.NC** -- Yleensä suljettu ja yhdistetty kohtaan **LA.COM**

### Piikkikaavio hälytysolosuhteissa

Kun instrumentissa on aktiivinen hälytys, hälytyspiikit liitetään alla kuvatulla tavalla.

#### Etähälytys

Piikki **RA.NO** -- Yleensä avoin ja yhdistetty kohtaan **RA.COM**; Piikki **RA.NC** -- Yleensä suljettu, mutta avoin hälytysolosuhteissa.

#### Paikallinen hälytys

Piikki **LA.NO** -- Yleensä avoin ja yhdistetty kohtaan **LA.COM**; Piikki **LA.NC** -- Yleensä suljettu, mutta avoin hälytysolosuhteissa.

## 4.5 Katkeamattoman virransyötön (UPS) yhdistäminen

Katkeamaton virransyöttö (UPS) suojaa koneita ja instrumentteja virtalähteen toimintahäiriöiltä. Instrumentissa on UPS-käyttöliittymä. Käytä UPS-laitteen määrittämiseen piikkejä **LoBAT** (→ Kuva 26-11), **GND** (→ Kuva 26-12) **OnUPS** (→ Kuva 26-13) ja **GND** (→ Kuva 26-14).

Suosittellemme käytettäväksi aktiivista seuranta-UPS:ää (esim. APC SUA3000 -sarjaa (ja lisäosaa AP9613 Dry Contact I/O SmartSlot Card)), jotta laite ja näytteet on suojattu väliaikaisilta virran toimintahäiriöiltä, jännitepiikeiltä, alijännitteeltä ja ylijännitteeltä.

UPS-laitteen on oltava asennuspaikan virtalähteen jännitteelle sopiva. Ota yhteyttä UPS-laitteen valmistajaan, jos tarvitset lisää apua.

#### 4.6 Käynnistäminen ja sammuttaminen



##### Varoitus

Instrumentti on kytketty samaan virtapiiriin muiden instrumenttien kanssa.

**Instrumentti saattaa toimia epävakaalla jännitteellä/virralla, mikä vaurioittaa näytteitä.**

- Älä käytä jatkojohtoja.
- Kytke instrumentti vain maadoitettuun virtaliitintään. Varmista, että pakollista katkaisijaa käytetään.



##### Varoitus


Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana

##### Näytteiden vauriot

- Tarkista instrumentti ja lisätarvikkeet silmämääräisesti instrumentin kuljetuksen tai siirtämisen aikana mahdollisesti aiheutuneiden vaurioiden varalta ennen kuin käynnistät instrumentin.

Tavallisissa olosuhteissa instrumentti tulee pitää päällä aina, vaikka se olisikin käyttämättömänä pidempiä jaksoja. Instrumentti tulee sammuttaa vain huoltoa tai siirtämistä varten.

##### 4.6.1 Käynnistäminen

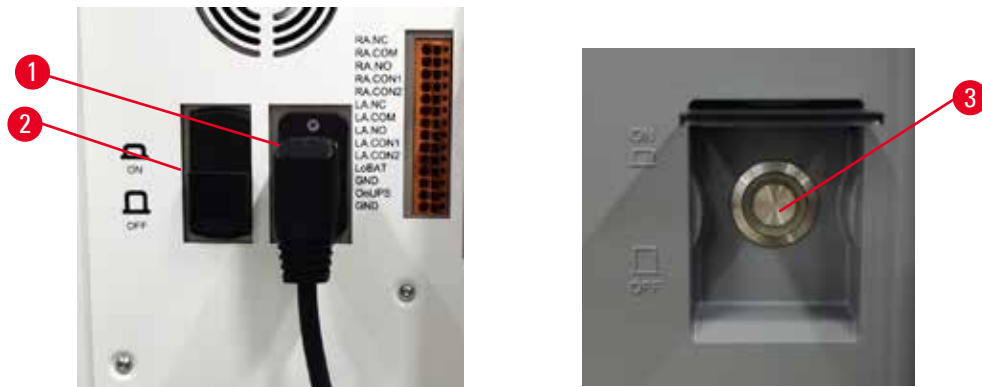

Kuva 27

1. Kytke virtajohto verkkovirran pistorasiaan (→ Kuva 27-1).
2. Varmista, että katkaisija (→ Kuva 27-2) on **ON**-asennossa.
3. Paina instrumentin etuosassa oleva virtakytkin (→ Kuva 27-3) päälle. Laitteen käynnistyminen kestää muutaman minuutin.

4. Sisäänkirjautumisnäyttö tulee näkyviin, kun alustus on suoritettu. Syötä käyttäjänimi ja salasana, niin Tila-näyttö tulee näkyviin (→ s. 70 – 5.4 Tila-näyttö).
5. Käytä ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla (→ s. 58 – Ensimmäinen sisäänkirjautuminen) järjestelmänvalvojan tiliä.

#### 4.6.2 Sammuttaminen



##### Varoitus

Verkkovirtajohtojen irrottaminen tai järjestelmän sammuttaminen, kun protokolla on käynnissä.

##### **Virran katkeamisen aiheuttamat näytteen vauriot**

- Älä irrota verkkovirtajohtoa, kun instrumentti on käynnissä, ellei kyseessä ole hätätilanne eikä etupaneelin virtapainiketta tai verkkovirtakytkintä voida jostain syystä käyttää.
- Älä sammuta järjestelmää, kun protokolla on käynnissä.

Tavallinen sammutus sammuttaa ohjelmiston oikealla tavalla. Instrumentin on oltava käyttämättömänä: protokollia tai muita toimintoja ei saa olla käynnissä.

1. Napauta näytön yläreunassa Leica-logoa ja napauta **Exit (Poistu)**. Voit myös valita kohdat **Settings (Asetukset) > Instrument settings (Laitteasetukset) > Exit software (Poistu ohjelmistosta)**.
2. Vahvista poistuminen. Odota, että kosketusnäyttö sammuu, ja paina sitten päävirtakytkintä.
3. Sammuta katkaisija siirtämällä se **OFF**-asentoon.
4. Sammuta virta pistorasiasta ja vedä pistoke irti.

#### 4.6.3 Hätäsammutus

Paina päävirtakytkintä hätätilanteessa heti.

Jos olosuhteet sen sallivat, sammuta virta pistorasiasta ja vedä pistoke irti.

#### 4.6.4 Uudelleenkäynnistys pitkän sammutettuna säilyttämisen jälkeen

Jos instrumenttia ei enää käytetä huollon tai hävittämisen takia, käyttäjän on ensin kytkettävä pois virtalähde ja sitten irrotettava virtajohto. Varmista, että virtajohto säilytetään oikein. Lisäksi käyttäjän on puhdistettava instrumentin pinta, tislauksastia, reagenssipullot, parafiinialtaat ja tippa-astia. Jos instrumentissa on poistoletku, se on irrotettava.

Jos instrumentti on käynnistettävä uudelleen, käytä alkuperäistä virtajohtoa. Tarkista tislauksastia, reagenssipullot, parafiinialtaat ja tippa-astia epäpuhtauksien varalta. Asenna mahdollinen poistoletku ohjeiden mukaan. Käynnistä instrumentti ja aja validoitu protokolla, jonka avulla instrumentin oikea toiminta voidaan varmistaa.

#### 4.7 Instrumentin siirtäminen



##### Varoitus

Instrumenttia nostetaan ilman työkaluja ja laitteita.

**Instrumentti voi kaatua tai pudota käyttäjien päälle, kun sitä nostetaan, mikä aiheuttaa henkilövammoja.**

- Käytä aina riittävän kuorman kestävää nostolaitetta, kuten kärkyä tai trukkia, kun siirät instrumenttia ylempään kerrokseen.



##### Varoitus

Instrumenttia ei saa siirtää, jos siinä on reagensseja tai parafiinia ja/tai sen virtajohto on kytketty verkkovirtaan.

**Henkilövamma.**

- Aina ennen minkäänlaisia kuljetuksia, joiden aikana instrumentti saattaisi heilua, kallistua tai sitä nostetaan, instrumentti on puhdistettava, mukaan lukien letkut, parafiinialtaat ja reagenssipullot. Virtajohto on irrotettava verkkovirrasta.



##### Varoitus

Lisätarvikkeet/osat/laitteet voivat irrota tai vaurioitua kuljetuksen aikana.

**Näytteiden vauriot**

- Parafiinilämmittimen suojat on suljettava kuljetuksen ajaksi.
- Tislausastian kannet on lukittava kuljetuksen ajaksi.

Sammuta instrumentti ennen sen siirtämistä. Virtajohto on irrotettava verkkovirrasta ja instrumentin on annettava jäähtyä.

1. Poista reagenssipullot ja tippa-astia instrumentista.
2. Poista skanneri pidikkeestä.
3. Avaa instrumentin pyörät.
4. Tue instrumentin kulmia käsin ja työnnä se uuteen sijaintiin.
5. Lukitse pyörät, kun instrumentti on lopullisessa sijoituspaikassaan.
6. Asenna tippa-astia, reagenssipullot ja skanneri uudelleen paikoilleen.

## 5. Protokollan ajaminen


### 5.1 Ohjelmiston käyttö

Instrumentin toimintoja hallitaan kosketusnäytön avulla.


#### 5.1.1 Perustason käyttö

##### Painikkeet

Kosketusnäytön painikkeiden avulla voidaan avata valikoita, näyttöjä ja valintaikkunoita sekä aloittaa ja pysäyttää toimintoja. Painikkeen tilan osoittaa sen väri tai reuna. Käytössä olevasta näytöstä ja saatavilla olevista toiminnoista riippuen käytettävät painikkeet (→ [Kuva 28](#)) voivat olla tummanharmaita, kirkkaansinisiä, pinkkejä tai kirkkaanvihreitä. Käytöstä poistetut painikkeet (→ [Kuva 29](#)) käyttävät vaaleampia versioita perusväristä. Valituissa painikkeissa on sininen reuna (→ [Kuva 30](#)). Vaihtoparin painikkeet ovat tummanharmaita ja kirkkaansinisiä.



Kuva 28



Kuva 29



Kuva 30

##### Kuvakkeet

Kuvakkeilla esitetään järjestelmän eri elementtejä, kuten reagenssiasemia ja tislauksastioita. Valittavat kuvakkeet (→ [Kuva 31](#)) näkyvät korostettuina. Valitse kuvake napauttamalla sitä samalla tavalla kuin painiketta. Valittu kuvake (→ [Kuva 32](#)) näkyy sinisellä reunalla korostettuna.




Kuva 31



Kuva 32

##### Näppäimistöt

Näppäimistöt tulevat näkyviin, kun sinun on kirjoitettava tekstiä tai numeroita. Niitä on kahdenlaisia: aakkosnumeerisia (kirjaimet ja numerot) (→ [Kuva 33](#)) ja numeerisia (vain numerot). Näytöllä olevat näppäimistöt vastaavat tietokoneen näppäimistöä, mutta painikkeet ovat vain näytöllä.

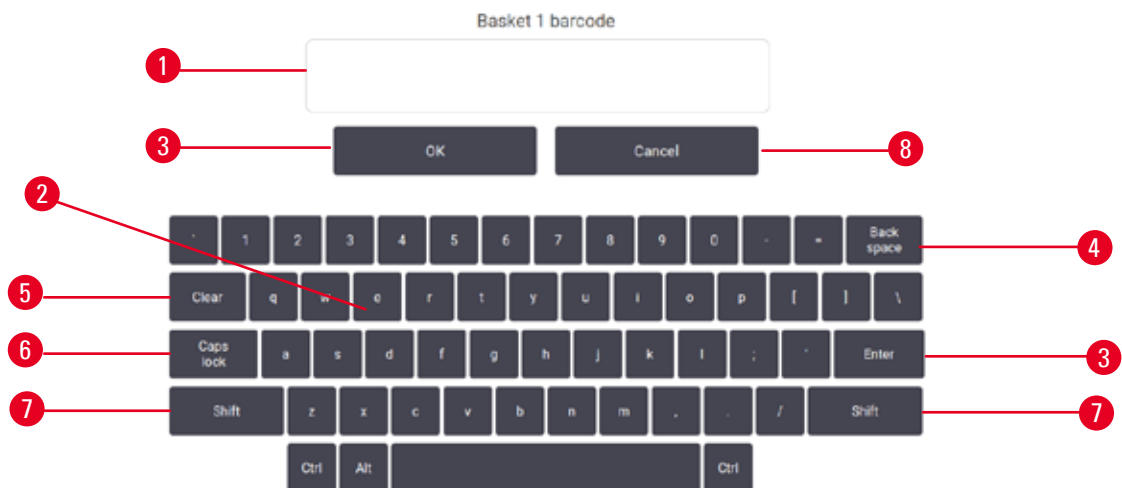

Kuva 33

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teksti-ikkuna</li> <li>2. Kirjaimet ja numerot</li> <li>3. <b>OK</b>-ja <b>Enter</b>-painikkeet – Vahvistaa tiedot</li> <li>4. <b>Askelpalautin</b> -painike – Poistaa edellisen merkin</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Clear</b>-painike – Poistaa kaikki merkit</li> <li>6. <b>Caps Lock</b>-painike – Vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pysyvästi</li> <li>7. <b>Shift</b>-painike – Vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä hetkellisesti</li> <li>8. <b>Cancel</b>-painike – Poistu tallentamatta</li> </ol> |
|--|--|

### 5.1.2 Navigointi

Ohjelmistossa voidaan navigoida näytön yläreunassa olevan toimintopalkin (→ Kuva 34) avulla.



Kuva 34

Toimintopalkki on aina näkyvillä, joten löydät aina haluamasi näytön. Napauta toimintopalkin painiketta, jos haluat avata joko näytön tai valikon, jossa on aiheeseen liittyvien näyttöjen vaihtoehtoja.

Joissakin näytöissä on vaihtoehtoisia näkymiä näytettyjen tietojen jakamista varten. Esimerkiksi **Reagent Stations (Reagenssiasemat)**-näytössä on kaksi näkymää: yksi reagenssipullojen tietoja varten ja toinen parafiinisäiliön tietoja varten. Voit siirtyä vaihtoehtoisten näkymien välillä napauttamalla näiden näyttöjen painikkeita.



Näissä käyttöohjeissa navigointipolut näytetään seuraavalla tavalla: **1** > **2** > **3**

Se tarkoittaa sitä, että toimintopalkkipainikkeesta painetaan ensin kohtaa **1**, sitten **2** ja lopuksi **3**. Esimerkiksi **Administration (Hallinnointi)** > **Protocols (Protokollat)** > **New (Uusi)** tarkoittaa, että sinun on napautettava **Administration (Hallinnointi)**-painiketta toimintopalkista, sitten **Protocols (Protokollat)** (joka on **Administration (Hallinnointi)**-valikossa) ja lopuksi **New (Uusi)** (joka on **Protocol selection (Protokollan valinta)**-näytössä oleva painike).



Kuva 35

Alla olevassa taulukossa on lueteltu ohjelmiston näytöt ja lyhyt kuvaus niiden toiminnasta. Se sisältää myös linkkejä näiden käyttöohjeiden olennaisiin osioihin.

Toimintopalkki-painike	Valikko-painike	Näytön tarkoitus	Katso:
Tila 	--	Lataa ja aja protokollia tai tarkastele järjestelmän tilaa.	(→ s. 70 – 5.4 Tila-näyttö)
Reagenssit 	Asemat	Reagenssiasemien määrittäminen. Voit myös tarkastella sen hetkisiä reagenssikonsentraatioita ja parafiinialtaan tilaa.	(→ s. 115 – 7.3 Reagenssiasemien hallinta)
	Reagenssityypit	Hallinnoi aktiivisten reagenssityyppien luetteloa.	(→ s. 110 – 7.2 Reagenssityyppien hallinta)
	Etätäyttö/-tyhjennys	Täytä tai tyhjennä reagenssipulloja ja tyhjennä parafiiniasemia.	(→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen)
	Manuaaliset toiminnot	Hallinnoi instrumentin yksittäisiä osia manuaalisesti.	(→ s. 129 – 8.1.1 Manuaaliset toiminnot)



Toimintopalkki-painike	Valikko-painike	Näytön tarkoitus	Katso:	
	Järjestelmänvalvonta	Protokollat	Valitse, luo, muokkaa ja hallinnoi protokollia.	(→ s. 94 – 6.2 Protokollien luominen, muokkaaminen ja tarkastelu)
		Suosikkiprotokollat	Aseta suosikkiprotokollia	(→ s. 75 – Suosikkiprotokollat)
		Käyttäjien hallinta	Hallinnoi käyttäjätilejä.	(→ s. 137 – 8.3 Asetusvalikko)
		Raportit	Valitse yksi neljästä raportista: ajon tiedot, käyttäjän toiminta, protokollien käyttö tai reagenssien käyttö.	(→ s. 132 – 8.2.2 Raportit)
		Tapahtumalokit	Tarkastele kaikkia järjestelmän tapahtumia.	(→ s. 136 – 8.2.3 Tapahtumalokit)
	Asetukset	Huolto	Tarkastele instrumentin sarjanumeroa ja ohjelmistoversioita, siirrä lokitiedostoja ja tapahtumaraportteja ja vie tai tuo protokollatiedostoja.	(→ s. 136 – 8.2.3 Tapahtumalokit)
		Käsittelyasetukset	Määritä perustason reagenssienhallintavalinnat.	(→ s. 139 – 8.3.2 Käsittelyasetukset)
		Laiteasetukset	Aseta vaihtoehdot ajan näytölle, aktiivihilisuodattimelle ja manuaalisen toiminnon valumisajalle. Muuta ääni- ja hälytysasetuksia.	(→ s. 141 – 8.3.3 Laiteasetukset)
		Seurantavaihtoehdot	Hallinnoi seurantajärjestelmää ja suositteluja protokollia.	(→ s. 144 – 8.3.4 Seurantavaihtoehdot)
	Huolto	--	Kirjaa muistiin erilaiset suoritettut huoltotehtävät.	(→ s. 147 – 9.2 Huoltonäyttö)
		--	Poistu ohjelmistosta. Avaa käyttöohjeiden PDF-version ohjelmistossa.	--

### 5.1.3 Käyttöoikeustasot


Laboratorion henkilökunnan käytettävissä on kolme käyttäjän käyttöoikeustasoa: operaattori, esihenkilö ja järjestelmänvalvoja. Operaattorit voivat suorittaa kaikki rutiinitehtävät, kuten protokollien ajamisen ja reagenssien vaihtamisen. Operaattorit eivät kuitenkaan voi muokata protokollia tai määrittää reagenssipullojen määritystä. Nämä toiminnot vaativat esihenkilön oikeudet. Esihenkilöillä on myös oikeudet järjestelmän määrittämiseen. Järjestelmänvalvojilla on kaikki samat oikeudet kuin esihenkilöilläkin ja lisäksi he voivat luoda tilejä esihenkilöille ja operaattoreille.

Joidenkin ohjelmistossa näytettyjen määritysasetusten muuttaminen vaatii huoltotason käyttöoikeuden. Saat nämä käyttöoikeudet asetusten tarkastelemista varten, mutta niiden muuttamista varten tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.

### Ensimmäinen sisäänkirjautuminen


Järjestelmänvalvoja-tili ja sen salasana määritetään tehtaalla, ja niiden avulla voidaan luoda uusia tilejä. Oletussalasanana on "admin".

1. Sisäänkirjautumisnäyttö tulee näkyviin, kun alustus on suoritettu. Napauta **Other access** (Muu käyttöoikeus) -painiketta (→ Kuva 36-1) ja valitse **Administrator** (Järjestelmänvalvoja).

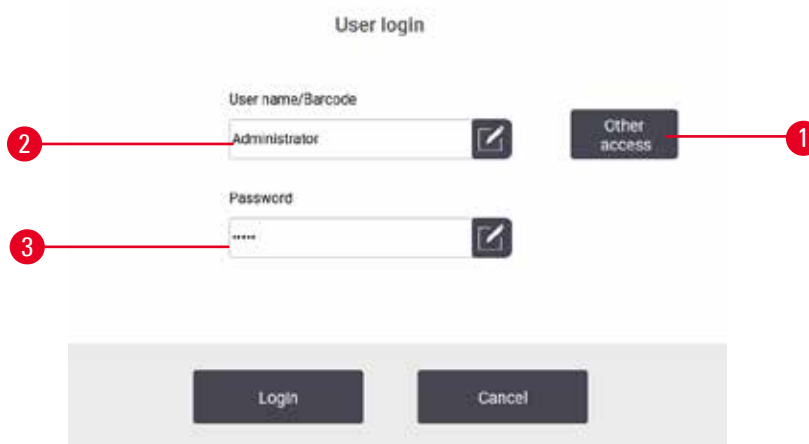

Kuva 36

2. Syötä oletussalasanana "admin" ja napauta **OK**. Salasana on vaihdettava.
3. Syötä näppäimistön avulla "admin", kirjoita uusi salasana sitten kaksi kertaa ja vahvista lopuksi painamalla **OK**. Salasanassa on oltava vähintään 6 merkkiä, joista vähintään yksi on kirjain ja yksi numero. Tila-näyttö tulee näkyviin. Toimintopalkissa oleva merkintä osoittaa käyttäjätunnukseksi (→ Kuva 37-1).



Kuva 37

- ✓ Järjestelmänvalvoja voi nyt luoda esihenkilö- ja operaattoritilejä (→ s. 137 – 8.3 Asetusvalikko).

### Sisäänkirjautuminen

Kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnus (→ Kuva 36-2) ja salasana (→ Kuva 36-3) ja napauta sitten **Kirjaudu sisään**. Voit myös skannata nimikortin viivakoodin.

### Käyttäjän vaihtaminen / uloskirjautuminen

1. Napauta toimintopalkissa käyttäjätunnusta (→ Kuva 37-1).
2. Valitse **Switch user (Vaihda käyttäjää)** tai **Logout (Kirjaudu ulos)**.
3. Jatka seuraavalla haluamallasi valinnalla.

Oletusarvoinen uloskirjautumisaika on 15 minuuttia. Voit muuttaa automaattista uloskirjautumisaikaa kohdassa **Settings (Asetukset) > Service (Huolto) > Lock screen (Lukitusnäyttö)**.

#### 5.1.4 Ohje

Käyttöohjeet toimitetaan PDF-muodossa kannettavassa tietomuodossa. Se sisältyy myös instrumentin ohjelmistoon (PDF-muodossa). Napauta toimintopalkin **Leica**-logoa, jos haluat avata käyttöohjeet. Joillakin näytöillä voit napauttaa **Help (Ohje)**-kohtaa ja avata kyseisen näytön ohjesivun.

## 5.2 Pika-aloitus



### Varoitus

Lisätarvikkeet/osat voivat irrota/vaurioitua kuljetuksen aikana

#### Näytteiden vauriot

- Suorita testiajo ja varmista instrumentin ja käytetyn protokollan soveltuvuus instrumentin kuljetuksen tai siirtämisen jälkeen ennen potilaiden kudospäätteen käsittelyä. Käytä joko ennakkoon määriteltyä protokollaa tai yhdistä toiminto omien protokolliesi validointiin.
- Käsittele potilaiden kudospäätteenä diagnostisiin tarkoituksiin vasta sen jälkeen, kun yllä mainitut tarkastukset on suoritettu onnistuneesti. Jos jokin aiemmista vaiheista epäonnistui, älä käytä instrumenttia. Ota yhteyttä paikalliseen Leica Biosystemsien huoltoedustajaan.



### Varoitus

Käyttäjän määrittämiä protokollia ei ole validoitu.

#### Näytteiden vauriot

- Ennakkoon määritetyt protokollat ja mukautetut protokollat on validoitava käyttäjän toimesta ennen protokollan ajamista, eli potilaan kudosten käsittelyä diagnostiikkaa varten, paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.



### Varoitus

Reagenssipulloa ei ole täytetty riittävästi (tislauksastia ei ole tyhjä).

#### Näytteiden vauriot

- Tarkista aina ennen protokollan ajamista, että tislauksastia on tyhjä.



### Varoitus

Jos tislusastia avataan, kun instrumentti on käsittelyn keskellä / keskeyttämisen jälkeen / protokollan päättymisen jälkeen, käyttäjä joutuu kosketuksiin tislusastian kannen/telineen kuuman pinnan / vaarallisten aineiden/höyryn kanssa.

Jos tislusastia avataan, protokolla ei voi jatkua.

#### Henkilövamma / näytteen vaurioituminen / vaarantuneet näytteet

- Kuuma pinta. Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia käytön aikana.
- Älä avaa tislusastian kantta tai poista reagenssipulloja / parafiinilämmittimen suojusta / parafiinialtaita, kun protokolla on käynnissä, ellei järjestelmän viesti pyydä sinua tekemään niin. Jos haluat poistaa näytteitä tislusastiasta tai lisätä näytteitä tislusastiaan, kun protokolla on käynnissä, paina keskeytyspainiketta.
- Ole varovainen, jos avaat tislusastian tai parafiinialtaan instrumentin toiminnan keskeyttämisen jälkeen. Lue kaikki varoitusviestit (esim. tislusastia on liian kuuma eikä siihen voi koskea turvallisesti) ja noudata soveltuvia varotoimenpiteitä ennen jatkamista.
- Sulanut parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Ole varovainen, kun käsittelet parafiinia ja poistat telineitä.



### Varoitus

Käsittely alkaa ennen kuin parafiini on sulanut kokonaan.

#### Näytteiden vauriot

- Varmista, että parafiinialtaiden parafiini on sulanut kokonaan ennen kuin painat käynnistyspainiketta.



### Varoitus

Näytteet eivät ole reagenssien/parafiinin peitossa.

#### Näytteet kuivuivat ja vaurioituivat.

- Tarkista reagenssipullojen reagenssitaso ulkopuolelta ennen protokollan ajamista. Varmista, että reagenssitasot ovat Min- ja Max-merkintöjen välillä. Tarkista myös parafiinitasot.
- Älä lisää näytteitä tasoanturin yläpuolelle.
- Älä lisää näytteitä suosituksia enempää.
- Varmista, että kasetit on asetettu oikein telineisiin ja telineet on asetettu oikein tislusastioihin.
- Aseman valintaprotokollia ei suositella yön yli toteutettavissa käsittelyissä. Jos reagenssi ei ole jostain syystä saatavilla, protokollaa ei voida suorittaa loppuun.



### Varoitus

Tukos, joka aiheutuu tislusastiasta poistuneista kaseteista/kudoksista tai reagenssien tai parafiinin epäpuhtauksista

#### Näytteiden vauriot

- Käytä käsittelyn aikana telineitä. Älä aseta näytteitä suoraan tislusastiaan.
- Tarkista ennen protokollan ajamista, että tislusastian pohjalle on asennettu siivilä.
- Varmista, ettei tislusastiaan pääse putoamaan mitään, kun tislusastian siivilä poistetaan. Putkissa olevat vierasesineet voivat estää venttiilien oikean toiminnan.

Kaikki tarvitsemasi reagenssit on määritettävä ennen aloittamista (→ s. 115 – 7.3 Reagenssiasemien hallinta). Lisäksi Operaattori-tasoisien käyttöoikeuksien käyttäjien ladattavissa on oltava vähintään yksi validoitu protokolla (→ s. 94 – 6.2 Protokollien luominen, muokkaaminen ja tarkastelu). Etupyörien jarrut on lukittava. Älä siirrä instrumenttia, kun protokollaa ajetaan.

#### Instrumentin tarkistukset ja alkuasetukset


1. Napauta **Status (Tila)**-painiketta, jos haluat näyttää **Status (Tila)**-näytön. Kaikki protokolla-ajot alkavat **Status (Tila)**-näytöstä (→ Kuva 45).
2. Tarkista, että tislusastiakuvake (→ s. 71 – Tislusastiakuvakkeet), jota haluat käyttää, osoittaa, että tislusastia on puhdas tai siinä on jäänteitä vain protokollan ensimmäisen reagenssin kanssa yhteensopivasta reagenssista.
3. Vaihda tarvittaessa reagenssi tai parafiinialtaan parafiini (→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen). Tavallisia reagenssien ja parafiinialtaiden kuvakkeita on muokattu monilla tavoilla, jos vaihto on tarpeen tai sitä suositellaan. Tarkista Pullo-kuvakkeet (→ s. 73 – Pullokuvakkeet) ja Parafiiniallas-kuvakkeet (→ s. 72 – Parafiinialtaiden kuvakkeet).
4. Tarkista, että instrumentti on valmis:
  - A. Kaikkien 17 reagenssipullon ja kondensaattipullon on oltava oikein asennettuna instrumentissa.
  - B. Reagenssipulloissa on oltava riittävästi reagenssia ja parafiinialtaissa parafiinia. Täytä reagenssipullot ja parafiinialtaat **MIN**- ja **MAX**-merkkien väliselle tasolle.
  - C. Avaa käytettävä tislusastia. Tarkista, että se on puhdas tai että mahdolliset reagenssijäänteet ovat yhteensopivia protokollan ensimmäisen reagenssin kanssa.
5. Valmistele kasetit ja lataa ne telineisiin (→ s. 40 – 4.4.2 Kasettitelineet).

#### Lataa protokolla

Käsittelyprotokollan ajamiseen on kolme eri vaihtoehtoa erilaisten seurantatoimintojen asetusten myötä.

- Vaihtoehto 1: Aja käsittelyprotokolla ilman seurantaa
- Vaihtoehto 2: Aja käsittelyprotokolla seurantatoiminnoilla
- Vaihtoehto 3: Aja suositeltu protokolla


6. Käsittelyprotokollan ajaminen ilman seurantaa.
  - A. Valitse protokolla suosikkiluettelon paneelista tai napauta **...More (...Lisää)**-painiketta vasemmassa alareunassa (tislusastian A tapauksessa) tai oikeassa alareunassa (tislusastian B tapauksessa) ja valitse protokolla **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöltä. Vain validoidut protokollat (joissa on vihreä valintamerkki) (→ Kuva 38-1) ovat Operaattori-tason käyttäjien valittavissa.

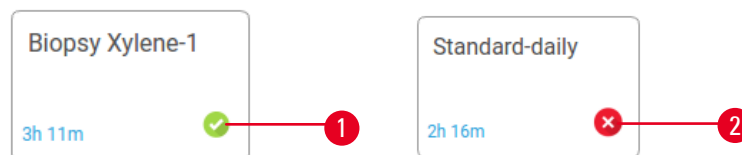

Kuva 38

## 5 Protokollan ajaminen

- B. Jos protokollan ensimmäinen vaihe käyttää reagenssia, joka ei ole yhteensopiva tislauksaltaassa olevien jäänteiden kanssa, laite näyttää varoitusviestin. Sinun on mahdollisesti suoritettava puhdistusprotokolla tai voit mahdollisesti ohittaa protokollan ensimmäiset vaiheet (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla). Tässä tapauksessa voit jatkaa napauttamalla **Clear all (Tyhjennä kaikki)** varoitusvalintaikkunassa.
- C. Jos haluat lisätä huomautuksen protokollaan, napauta **Add note (Lisää huomautus)**. Kirjoita huomautus näyttönäppäimistöllä ja napauta sitten **Enter** tai **OK**. Huomautuksia voidaan lisätä protokollaan myös silloin, kun se on käynnissä.
- D. Napauta **Run (Aja)**-painiketta. Jatka kohdasta 9.
7. Käsittelyprotokollan ajaminen seurantatoiminnoilla. Tässä vaihtoehdossa laitteessa on oltava asennettuna HistoCore I-Scan -skanneri ja seurantatoiminnot on aktivoitava (→ s. 144 – 8.3.4 Seurantavaihtoehdot).
- A. Noudata yllä olevia vaiheita 6A, 6B ja 6C.
- B. Napauta **Run (Aja)**-painiketta. **Retort A/B baskets (Tislusastian A/B telineet)** -näyttö tulee näkyviin.
- C. Syötä telineen 1 tiedot. Paina skannerin Lisä-LED-valon virtapainiketta (→ Kuva 39-1), jotta skannerin valo syttyy. Kun Skannaus/kuvaaminen-laukaisinpainiketta (→ Kuva 39-2) painetaan, viivakoodiskanneri skannaa viivakoodin. Kun viivakoodi on tunnistettu, skannerin näytössä näkyy valintamerkki. Viivakoodin tiedot täytetään Teline 1:n nimikenttään (→ Kuva 39-4) ja seuraava täyttökenttä aktivoituu (→ Kuva 39-5). Ota kuva telineestä painamalla Skannaus/valokuva-painiketta. Tarkista telineen kuva näytön oikealla puolella (→ Kuva 39-6). Säädä kuvaa kuvan tarkastelutyökaluilla (→ Kuva 39-7). Paina valintapainiketta (→ Kuva 39-3). Syötä sitten telineen 2 tiedot (→ Kuva 39-8) vastaavalla tavalla.
- D. Kun olet valmis, napauta **OK**. Jatka kohdasta 9.

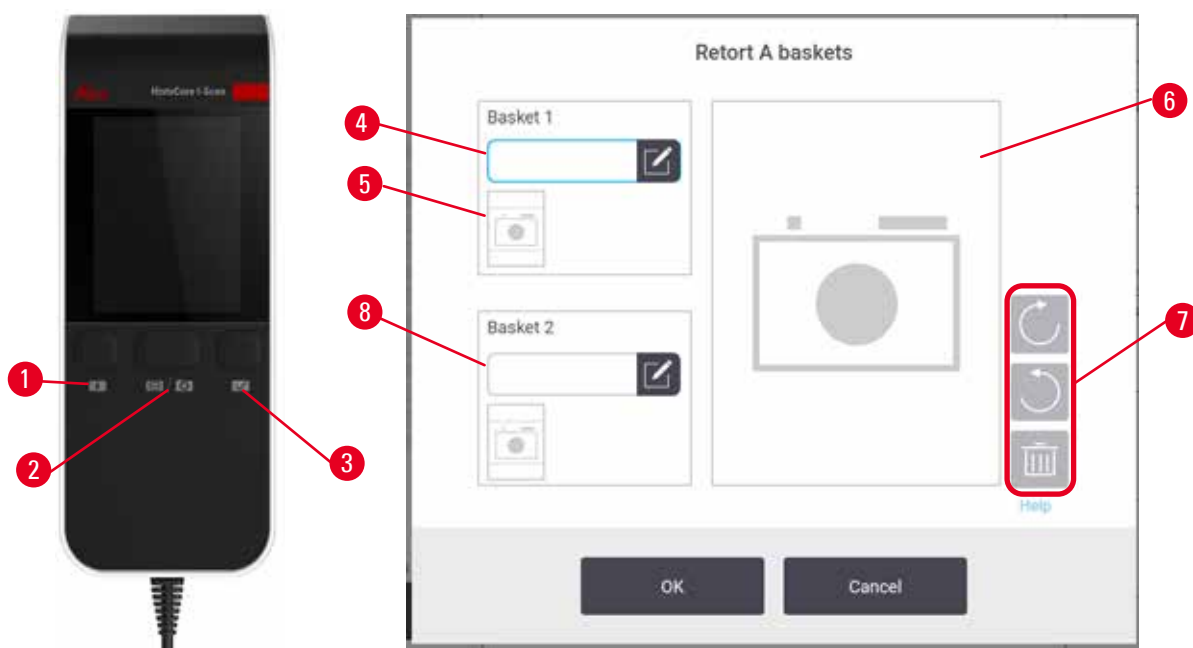


Kuva 39

8. Suositellun protokollan ajaminen. Tässä vaihtoehdossa laitteessa on oltava asennettuna HistoCore I-Scan -skanneri, seurantatoiminnot on aktivoitava ja teline on yhdistettävä suositeltavaan protokollaan (→ s. 144 – 8.3.4 Seurantavaihtoehdot).
  - A. Napauta skanneripainikkeita (→ Kuva 45-2) (→ Kuva 45-7).
  - B. Skannaa viivakoodi ja ota kuva telineestä. Katso kohta 7C.
  - C. Kun olet valmis, napauta **OK**. Jatka kohdasta 9.
  
9. Aseta telineet valittuun tislusastiaan ja sulje tislusastian kansi.


### Protokollan ajaminen

10. Valintaikkuna (→ Kuva 40), johon voit syöttää tislusastiassa olevien kasettien määrän, tulee näkyviin.

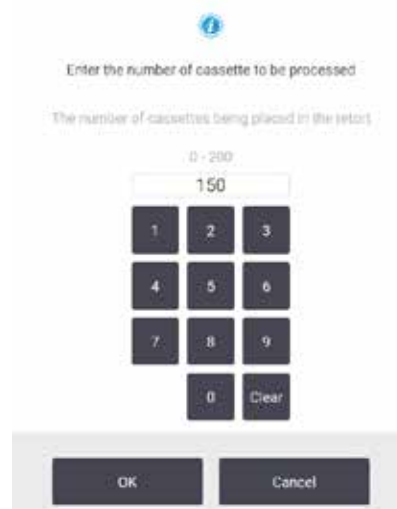

Kuva 40

Näytöllä näkyy esihenkilön asettama oletusmäärä (→ 8.3.2 Käsittelyasetukset). On kuitenkin tärkeää syöttää oikea kasettimäärä. Reagenssinhallintajärjestelmä käyttää syöttämäsi määrää reagenssipitoisuuksien laskemiseen. Syötä määrä ja napauta **OK**. Näkyviin tulee sen jälkeen aikataulunäyttö.

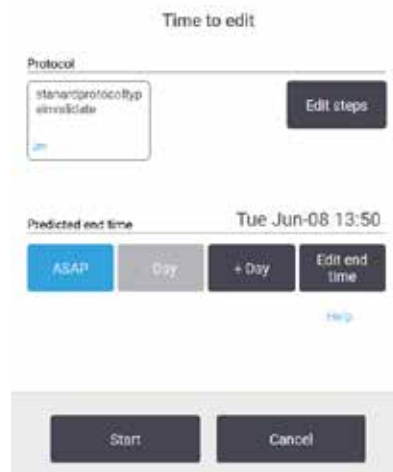

Kuva 41

11. Jos haluat muokata protokollan vaiheita tai vaihtaa vaiheen kestoa, napauta **Edit steps (Muokkaa vaiheita)**. Prosessi selitetään kohdassa (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla).
12. Jos haluat suorittaa protokollan välittömästi, napauta **ASAP (HETI)** ja jatka vaiheeseen 15 alla.
13. Jos haluat viivästyttää ajon alkua:
  - A. vuorokaudella, napauta **+Day (+Päivä)**
  - B. muun ajan verran, napauta **Edit end time (Muokkaa päättymisaikaa)** ja määritä viive (→ s. 78 – 5.5.1 Protokollien aikataulutus).
14. Tarkista, että näytöllä näkyvä ennustettu päättymisaika kelpaa. Jos ei, toista vaiheet vaiheesta 12 alkaen.
15. Napauta **Start (Aloita)**-painiketta, niin järjestelmä aikatauluttaa protokollan.
  - A. Jos järjestelmä ei voi aikatauluttaa protokollaa, näkyviin tulee varoitusviestejä. Napauta **Clear all (Tyhjennä kaikki)** ja korjaa virheet ennen kuin yrität ajaa protokollan uudelleen (→ s. 86 – 5.7.2 Reagenssien ristiriidat, joita ei voida välttää).
  - B. Jos järjestelmä pystyi aikatauluttamaan ajon, protokolla alkaa.
  - C. Jos olet määrittänyt viivästetyn päättymisajan, alun täyttöehto toteutetaan (→ s. 86 – 5.7.1 Viivästetyt päättymisajat ja alkutäytöt).

Voit seurata ajon edistymistä **Status (Tila)**-näytöllä. Voit keskeyttää protokollan ajon ja lisätä lisäasetteja tai keskeyttää ajon kokonaan (→ s. 83 – 5.6 Protokollien keskeyttäminen).

#### Protokolla-ajon viimeistely

16. Kun protokolla on päättynyt, **Protocol complete (Protokolla valmis)** -valintaikkuna tulee näkyviin ja laite antaa äänimerkin.






Kuva 42

Voit poistaa telineet ennen tislauksastian tyhjentämistä, mutta sitä ei suositella. Voit tehdä niin napauttamalla kohtaa **Access now (Avaa nyt)**. Tyhjennä tislauksastia napauttamalla kohtaa **Drain retort (Tyhjennä tislauksastia)**.

17. Avaa tislauksastia, kun näet siihen kehottavan viestin.

18. Kaikkien kudosten poistamista pyytävä viesti tulee näkyviin. Toimi viestin ohjeiden mukaan ja napauta **Done (Valmis)**.

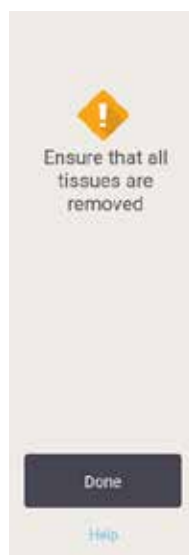

Kuva 43

Älä napauta **Done (Valmis)** ennen kuin kaikki telineet on poistettu tislauksastiasta.

### Puhdistusprotokollan ajaminen

19. Puhdista nyt -paneeli tulee näkyviin. Aja puhdistusprotokolla ennen kuin ajat seuraavan käsittelyprotokollan.



#### Varoitus

Tislausastiaan jää kudoksia, kun puhdistusprotokolla ajetaan.

#### Näytteiden vauriot

- Poista kaikki kudokset tislausastiasta ennen puhdistusprotokollan ajamista, sillä kuivausvaihe vaurioittaa kudoksia.

20. Jos haluat hyväksyä esivalitun oletusarvoisen puhdistusprotokollan, napauta **Start (Aloita)** ja jatka vaiheesta 23. Muussa tapauksessa voit valita puhdistusprotokollan ja ajaa sen samalla tavalla kuin kudokäsittelyprotokollan (tässä toimenpiteessä kuvatulla tavalla).
21. Sinua pyydetään asettamaan likaiset telineet tislausastiaan. Varmista, että kaikki kudokset on poistettu telineistä ennen tätä vaihetta. Napauta **OK**, kun olet asettanut telineet tislausastiaan ja sulkenut tislausastian kannen.
22. Jos haluat muokata puhdistusprotokollan vaiheita, napauta **Edit steps (Muokkaa vaiheita)**.  
(→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla).
23. Aloita ajo napauttamalla **Start (Aloita)**.
24. Kun protokolla on päättynyt, **Protocol complete (Protokolla valmis)** -paneeli tulee näkyviin ja laite antaa äänimerkin. Jatka napauttamalla kohtaa **Access now (Avaa nyt)**.
25. Kun **Access retort now (Avaa tislausastia nyt)** -paneeli tulee näkyviin, avaa tislausastian kansi ja poista telineet.
26. Jatka napauttamalla **Open retort (Avaa tislausastia)**.

### 5.3 Puhdistusprotokollat

Puhdistusprotokollat puhdistavat tislausastiat ja yleiset reagenssilinjat. Voit valita ajon päätteeksi **Clean now (Puhdista nyt)** -vaihtoehdon. Tämä ajaa ennakkoon määritetyn puhdistusprotokollan (**Quick Clean (Pikapuhdistus)**). Voit myös valita toisen puhdistusprotokollan.

Tislausastiat tulisi puhdistaa myös

- kun reagenssi on vaihdettu etätäyttö- ja -tyhjennystoiminnon avulla
- jos reagenssit on täytetty manuaalisesti ja/tai
- jos viimeisin reagenssi ei ole yhteensopiva seuraavan ajettavan protokollan kanssa (→ s. 167 – 10.5 **Reagenssien yhteensopivuustaulukot**).

Useimpien laboratorioiden tapauksessa ennakkoon määritetty **Quick Clean (Pikapuhdistus)**-protokolla on ainoa tarvittava puhdistusprotokolla. Tavallisissa olosuhteissa protokolla puhdistaa tislausastian jäänteet parafiinialtaaseen ennen ensimmäistä vaihetta. Sitä seuraa kaksi reagenssivaihetta: ksyleeni- ja etanolipuhdistus. Näitä seuraa kuivausvaihe. Tässä vaiheessa käytetään korkeaa lämpötilaa, tyhjiötä ja ilmavirtausta poistamaan kaikki reagenssijäänteet. Kuivausvaiheen lopussa lämmittimet sammuvat, mutta ilmavirtaus jatkuu, jotta tislausastiat jäähtyisivät.

Puhdistusprotokollat ladataan ja ajetaan samalla tavalla kuin muut protokollat, mutta tislauksastiasissa ei saa olla kudosta. Kuivausvaihe vahingoittaa kudoksia. Puhdistusprotokollia ei saa koskaan käyttää uudelleen käsittelyajoja varten. Käytä sen sijaan uudelleen käsittelyprotokollaa.

Luo tarvittaessa omia puhdistusprotokolliasi.

Uusia puhdistusprotokollia voi luoda seuraavalla tavalla:

1. Avaa **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näyttö (**Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)**) ja napauta **Cleaning (Puhdistus)**.
2. Napauta **Uusi (New)** ja valitse protokollan tyyppi **Cleaning (Puhdistus)**.
3. Anna puhdistusprotokollalle nimi.
4. Valitse reagenssin valintamenetelmä: **Type (Tyyppi)** tai **Station (Asema)**. Sarja valintaikkunoita ohjaa sinut luomisen ensimmäisen vaiheen läpi.
  - » Puhdistusprotokollissa on automaattisesti lopussa kuivausvaihe. Tätä vaihetta ei voi muokata.
5. Napauta protokollataulukon seuraavaa riviä ja sitten **Insert (Lisää)**, jos haluat lisätä toisen vaiheen. Lisää vaiheita tarpeen mukaan.
6. Halutessasi voit muokata puhdistusprotokollan nimeä napauttamalla **Name (Nimi)**-painiketta.
7. Halutessasi voit lisätä protokollaan liittyviä tietoja napauttamalla **Notes (Huomautukset)**-painiketta.
8. Tallenna protokolla napauttamalla **Save (Tallenna)**-painiketta.
9. Napauta **Done (Valmis)**-painiketta, kun olet valmis.
10. Esiin tulee varoitusikkuna, jossa näkyvät toimenpiteet, joita edellytetään tai suositellaan ennen kuin protokollaa voidaan käyttää. Yksi luettelon varoitus on aina se, että protokollaa ei ole validoitu käyttöön. Oletusarvoisesti juuri luotu protokolla ei ole validoitu protokolla. Laboratorion on validoitava se ennen kliinistä käyttöä. Validoinnin jälkeen esihenkilö voi siirtyä **Edit protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytölle ja napauttaa **Validate protocol (Validoi protokolla)** -painiketta. Sen jälkeen protokolla on operaattorien käytettävissä (jos muut ikkunassa luetellut virheet on myös käsitelty). Napauta tarvittaessa **Default (Oletus)**-painiketta ja määritä puhdistusprotokolla oletuspuhdistusprotokollaksi.

Voit luoda omia puhdistusprotokollia kopioimalla ennalta määritetyn **Quick Clean (Pikapuhdistus)**-protokollan näin:

1. Napauta **Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)** ja sitten **Cleaning (Puhdistus)**.
2. Valitse **Quick Clean (Pikapuhdistus)**-protokolla ja napauta **Copy (Kopioi)**.
3. Syötä protokollalle uusi nimi.
4. Muokkaa puhdistusprotokollaa (→ s. 94 – 6.2.2 Protokollien muokkaaminen). Puhdistusprotokollien viimeistä kuivausvaihetta ei voi muokata.
5. Jatka uuden puhdistusprotokollan luomisohjeiden kohdasta 6.

Puhdistusprotokollat eivät vaadi vesivaihetta ja ne toimivat hyvin yhdessä perinteisten puhdistusreagenssien kanssa.

Jos haluat poistaa ksyleenin kokonaan instrumentistasi, Leica Biosystemsin valikoimassa on ksyleenin Waxsol™-puhdistusliuos (→ s. 107 – 7.1.4 Suositellut reagenssit).

**Varoitus**

Tislausastiaan jää kudoksia, kun puhdistusprotokolla ajetaan.

**Näytteiden vauriot**

- Poista kaikki kudokset tislausastiasta ennen puhdistusprotokollan ajamista, sillä kuivausvaihe vaurioittaa kudoksia.

**Varoitus**

Puhdistusprotokollaa käytetään näytteiden uudelleen käsittelyyn.

**Näytteiden vauriot**

- Älä käytä puhdistusprotokollia uudelleen käsittelyyn, sillä kuivausvaihe vaurioittaa kudoksia.

**Varoitus**

Virheellisten/riittämättömien puhdistustyökalujen/reagenssien käyttö

**Näytteiden vauriot**

- Älä käytä kontaminoituneita vedenpoistoaineita uudelleen puhdistusetanolina. Kontaminoituneet vedenpoistoaineet sisältävät formaliinia (tai muita kiinnitysaineita) ja kuivausvaihe aiheuttaa suolojen kiteytymistä tislausastian sisäpinnoille.
- Käytä puhdistusprotokollaa aina, kun tislausastiassa on ollut parafiinia.

Kaikilla ennakkoon määritetyillä puhdistusreagensseilla on syklien puhtausraja-arvot. Nämä raja-arvot pakottavat reagenssien vaihtamisen kymmenen tai kuuden puhdistuksen jälkeen (jos pitoisuusraja-arvo ei ylity sitä ennen). Raja-arvot on kuitenkin suunniteltu sellaisille puhdistuksille, joissa tislausastioissa on vain kasettitelineitä.

**Varoitus**

Puhdistusprotokollan ajaminen muiden materiaalien kuin telineiden puhdistamista varten.

**Heikentyneet näytteet – Puhdistusreagenssit heikkenevät nopeammin. Jos syklin puhtausraja-arvoa ei madalleta, epäpuhtaat puhdistusreagenssit johtavat heikompiin puhdistustuloksiin.**

- Älä puhdista muita materiaaleja puhdistusprotokollan avulla.

Puhdistusprotokollien muokkaaminen erilaisia tislausastian jäänteitä varten

Suurita kokonainen puhdistusprotokolla aina mahdollisimman pian, jos tislausastioissa on edelleen parafiinia tai puhdistusreagensseja.

Etanoli- tai formaliinijäänteiden tapauksessa protokollan ensimmäinen vaihe tulisi ohittaa ja puhdistus tulisi aloittaa etanolivaiheesta (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla).

Puhtaat formaliinijäänteet voivat jäädä tislusastiaan, jos seuraava käsittelyprotokolla alkaa formaliinivaiheella. Jos tislusastiaan jää formaliinia protokollan loppuun, voit tarvittaessa jatkaa ilman puhdistusta. Kun **Clean now (Puhdista nyt)** -paneeli tulee näkyviin, oletuspuhdistusprotokolla on ladattu valmiiksi ja valmiina ajoon. Voit ohittaa tämän puhdistusprotokollan seuraavalla tavalla:

1. Napauta **...More (...Lisää)**.
2. Napauta mitä tahansa kudostenkäsittelyprotokollaa ja sitten **Load (Lataa)**.
3. Napauta **Run (Aja)**.
4. Napauta **Unload protocol (Poista protokollan kuorma)**.
5. Jatka seuraavalla haluamallasi valinnalla.

#### Esipuhdistustyhjennykset

Puhdistusprotokollat ajetaan yleensä parafiinijäänteiden puhdistamiseksi tislusastioista, sillä parafiini on käsittelyprotokollien viimeinen vaihe. Jotta puhdistusaineen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, instrumentti tyhjentää yleensä kaikki parafiinijäänteet tislusastiasta parafiinisäiliöön, josta parafiini tuli, ennen puhdistusprotokollan aloittamista.

Jos yrität ladata käsittelyprotokollaa tislusastiaan, jossa on yhteensopimattomia jäänteitä, siitä varoitetaan tapahtumalla 10011: "Tislusastiassa on yhteensopimatonta reagenssia. Puhdista tislusastia tai muokkaa protokollaa." Puhdistusprotokolla, joka ajetaan tämän varoituksen jälkeen, ei tyhjennä mitään parafiinisäiliöön. Tämä on siltä varalta, jos tislusastiaan on asetettu uusia kasetteja, jolloin parafiinijäänteet kontaminoituvat formaliinilla. Tyhjennys näissä olosuhteissa kontaminoisi parafiinialtaan formaliinilla.

Jos asetat uusia kasetteja likaiseen tislusastiaan käsittelyä varten, poista kasetit ja yritä ladata käsittelyprotokolla ennen puhdistusprotokollan lataamista. 10011-varoitus, joka näytetään, kun yrität ladata käsittelyprotokollaa, aiheuttaa sen, että puhdistusprotokolla ohittaa parafiinialtaan tyhjennyksen. Tislusastian jäänteet, joissa on nyt formaliinia, eivät siirry parafiinialtaaseen. Ne siirtyvät puhdistusaineeseen.

Kun puhdistusprotokolla on valmis, vaihda puhdistusaine (sillä se on nyt kontaminoitunut formalinilla). Yleisesti ottaen tämä tilanne voidaan välttää puhdistamalla tislusastia aina heti käsittelyajon jälkeen. Laitte kehottaa tekemään niin. Älä aseta uusia kasetteja tislusastiaan, jossa näkyy jäänteitä alla olevan kuvakkeen osoittamalla tavalla (→ [Kuva 44](#)). (Formaliinijäänteet ovat mahdollisesti hyväksyttäviä.)



Kuva 44




### Varoitus

Käsittlemättömiä näytteitä (joissa on formaliinijäänteitä) asetetaan tislusastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista.

**Heikentyneet näytteet – Formaliinijäänteet, jotka siirtyvät parafiinaltaaseen puhdistusajon alussa, voivat vahingoittaa näytteitä myöhemmissä ajoissa.**

- Älä lataa käsittlemättömiä kudoksenäytteitä tislusastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista.
- Jos lataat käsittlemättömiä näytteitä vahingossa tislusastiaan ennen puhdistusprotokollan ajamista, poista näytteet ja yritä ladata käsittelyprotokolla ennen puhdistusprotokollan lataamista. Puhdistusajoa edeltävä tyhjennys ohitetaan.

## 5.4 Tila-näyttö

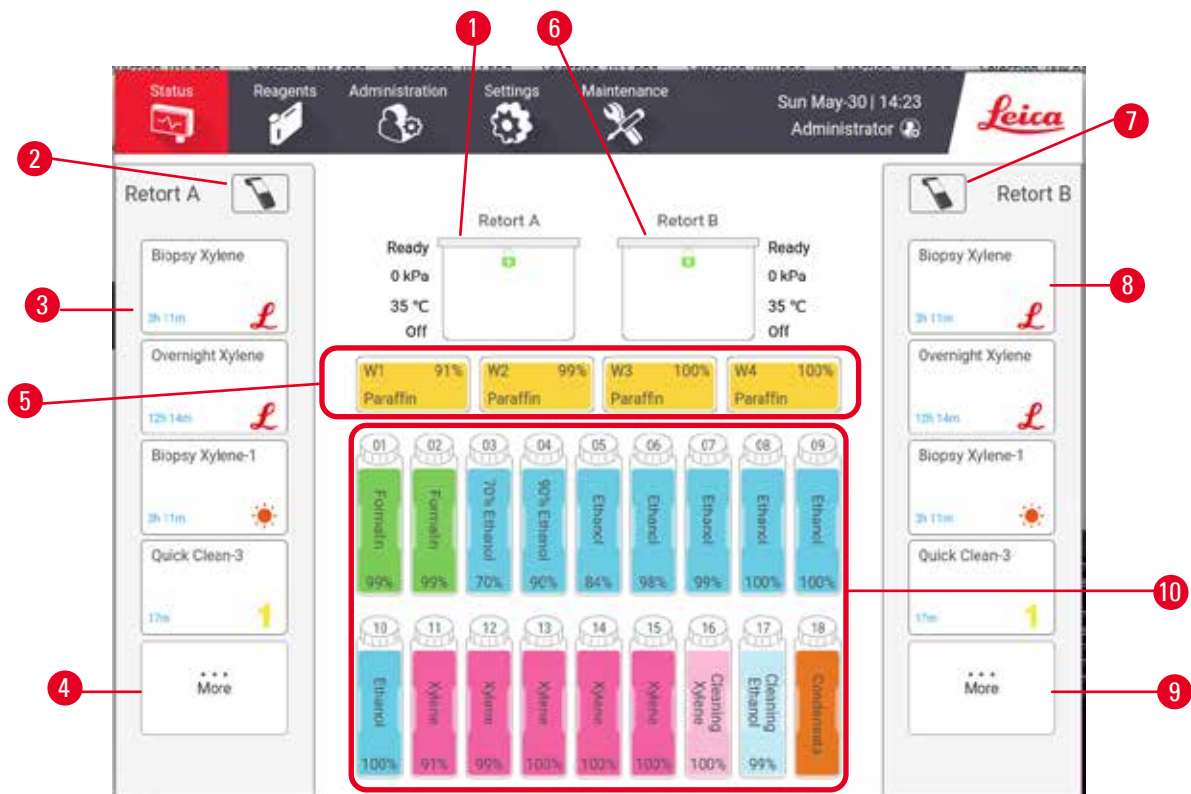

Kuva 45


- |  |  |
|--|--|
| 1. Tislusastia A   | 6. Tislusastia B   |
| 2. Tislusastian A skanneripainike  | 7. Tislusastian B skanneripainike  |
| 3. Tislusastian A suosikkiprotokollapaneeli  | 8. Tislusastian B suosikkiprotokollapaneeli  |
| 4. Tislusastian A ...More (...Lisää)-painike<br>(kaikkien protokollien tarkasteluun) | 9. Tislusastian B ...More (...Lisää)-painike<br>(kaikkien protokollien tarkasteluun) |
| 5. Parafiinaltaat (W1–W4)  | 10. 17 reagenssipulloa ja 1 kondensaattipullo  |

Status (Tila)-näytössä lataat ja ajat protokollia ja seuraat protokollan edistymistä.

### 5.4.1 Tila-alue

Näytön keskialue näyttää tislusastioiden, parafiinialtaiden, reagenssipullojen ja kondensaattipullon tilan.

#### Tislusastiakuvakkeet

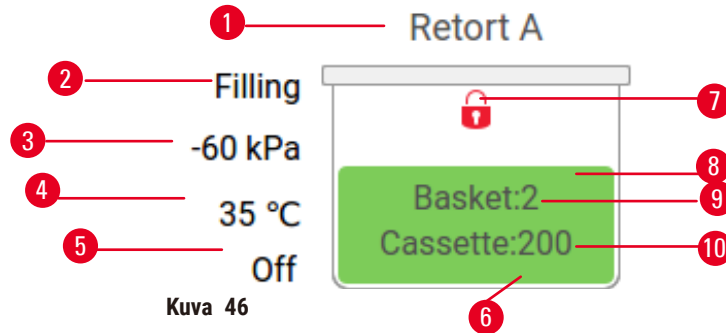

Kuva 46

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tislusastian nimi   | 7. Tislusastian lukitustila                                |
| 2. Nykyinen tislusastian toiminta                            | 8. Väri tai muu kuvio osoittaa tislusastian tilan          |
| 3. * Tislusastian paine                                      | 9. Sellaisten telineiden määrä, joiden tunnus on syötetty. |
| 4. * Tislusastian lämpötila                                  | 10. Tislusastiassa olevien kasettien määrä                 |
| 5. * Sekoitin päällä / pois päältä                           |  |
| 6. Värikoodattu tislusastiassa olevan reagenssiryhmän mukaan |  |








\* Nämä tislusastian tilat eivät näy 10 minuutin jälkeen Operaattori-tasolla tai uloskirjautumisen yhteydessä.

Nykyinen tislusastian toiminta (→ Kuva 46-2) voi olla:

- **Ready (Valmis)** – Tislusastia on valmiina mihin tahansa uuteen toimintaan
- **Reserved (Varattu)** – Protokolla on ladattu, mutta sitä ei ole vielä aloitettu
- **Processing (Käsitellään)** – Tislusastiaa käytetään tällä hetkellä protokollan mukaisesti
- **Completed (Valmis)** – Tislusastia on suorittanut ladatun protokollan
- **Drying (Kuivataan)** – Tislusastiaa kuivataan puhdistusprotokollan viimeisen vaiheen mukaisesti
- **Filling (Täytetään)** – Tislusastiaa täytetään
- **Draining (Tyhjennetään)** – Tislusastiaa tyhjennetään
- **Pending (Odottaa)** (täyttöä tai tyhjennystä) – Tislusastia odottaa, että täyttö tai tyhjennys voidaan suorittaa
- **Aborting (Keskeytetään)** – Tislusastia keskeyttää senhetkisen toiminnan
- **Unavailable (Ei saatavilla)** – Tislusastiaa ei voida käyttää. Ota yhteyttä huoltoedustajaan.

Tislusastialla on kuusi mahdollista tilaa (→ Kuva 46-6).

Kuvake	Tislusastian tila	Kuvaus
	Täysi	Tislusastiassa on oikea määrä reagenssia tai parafiinia.

Kuvake	Tislausastian tila	Kuvaus
	Osittain täynnä	Reagenssi- tai parafiinitaso on tyhjän ja täyden välillä. Tämä tapahtuu yleensä täyttö- tai tyhjennystoiminnon aikana.
	Tyhjä	Tislausastia on tyhjä, mutta siinä on jäänteitä.
	Puhdas	Tislausastiassa ei ole jäänteitä. Tämä tapahtuu vain puhdistusprotokollan jälkeen. Tislausastia on nyt valmis uuden protokollan ajoon.
	Telineet on tunnistettu	Tislausastia on valmis uuteen protokollan ajoon ja vähintään yhden ajon telineen tunnus on syötetty. Numero osoittaa niiden telineiden määrän, joiden tunnus on syötetty.
	Protokollan ajo on suoritettu onnistuneesti; odotetaan kudosten poistamista	Protokolla on ajettu onnistuneesti, mutta et ole vielä vahvistanut, että kaikki kudos on poistettu tislausastiasta.
	Protokollan ajo on suoritettu onnistuneesti	Protokolla on ajettu onnistuneesti, mutta tislausastia ei ole vielä tyhjennetty.
	Täysi ilman telineitä	Manuaalinen reagenssin täyttö on suoritettu.





## Parafiinialtaiden kuvakkeet



1. Parafiinialtaan numero
2. Reagenssityyppi (eli parafiinityyppi)
3. Värikoodi: oranssi parafiinin reagenssiryhmälle
4. Parafinikonsentraatio
5. Väri tai muu kuvio osoittaa aseman tilaa

Parafiinialtailla on neljä mahdollista aseman tilaa:



Kuvake	Parafiinialtaiden tila	Kuvaus
	Täysi	Parafiinialtaassa on riittävästi parafiinia tislauksastian täyttämiseen.
	Osittain täynnä	Parafiinin siirto on käynnissä tai se on keskeytetty. Parafiinitaso on tyhjän ja täyden välillä.
	Tyhjä	Parafiiniallas on tyhjennetty tislauksastian täyttämistä varten. Parafiinialtaassa on edelleen parafiinia.
	Ei sulanut	Parafiinialtaan parafiini ei ole sulanut eikä sitä voida käyttää.

### Pullo kuvakkeet



Kuva 48

1. Pullon numero
2. Reagenssityyppi
3. Värikoodattu reagenssiryhmän mukaan (katso (→ s. 101 – 7.1.1 Reagenssiryhmät, -tyypit ja -asemat))
4. Varoitussymboli ja viivoitetut alueet osoittavat, että reagenssi on raja-arvon ulkopuolella
5. Väri tai muu kuvio osoittaa aseman tilan (katso alta)
6. Reagenssipitoisuus

Kuvake	Pullon tila	Kuvaus
	Täysi	Pullossa on riittävästi reagenssia tislauksastian täyttämiseen määritetyn teline-tason mukaisesti.
	Käytössä	Reagenssin siirto on käynnissä tai se on keskeytetty. Reagenssitaso on tyhjän ja täyden välillä.
	Tyhjä	Pulloa on käytetty tislauksastian täyttämiseen. Pullossa on edelleen reagenssia.
	Kuiva	Pullo on kokonaan tyhjennetty ja siinä on vain pieni määrä jäännösmateriaalia.
	Ei pulloa	Pullo on poistettu.
	Tuntematon	Aiemmin puuttunut pullo on vaihdettu. Syötä reagenssin ja tilan tiedot ennen tämän aseman käyttämistä.


## 5.4.2 Protokollapaneelit

### Suosikkiprotokollat

Suosikkiprotokollia voidaan valita enintään 4 ja ne näkyvät tislauksastian **Status (Tila)**-näytössä. Tislauksastioissa A ja B näkyy sama protokollaluettelo.

Voit asettaa protokollan suosikkiprotokollaksi seuraavalla tavalla:

1. Siirry kohtaan **Administration (Hallinnointi) > Favorite protocols (Suosikkiprotokollat)**.
2. Napauta **Add (Lisää)**-painiketta (→ [Kuva 49-1](#)).

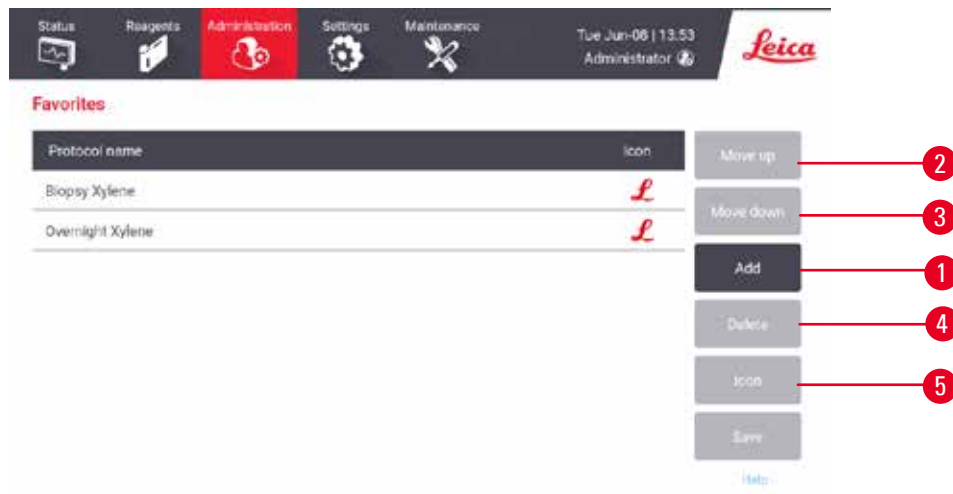

**Kuva 49**

3. Valitse haluamasi protokolla **Protocol selection (Protokollavalinta)**-luettelosta. Napauta näytön oikealla puolella olevaa **Select (Valitse)**-painiketta.
4. **Select icon (Valintakuvake)**-valintaikkuna tulee näkyviin (→ [Kuva 50](#)). Valitse luettelon protokollan kuvake ja napauta **OK**.



Kuva 50


5. Valittu protokolla näkyy **Favorites (Suosikit)**-luettelossa. Napauta **Save (Tallenna) Favorites (Suosikit)**-valintaikkunassa, jolloin valittu protokolla näkyy **Status (Tila)**-näytössä molempien tislusastioiden kohdalla.

Napauta **Move up (Siirrä ylös)**- (→ Kuva 49-2) tai **Move down (Siirrä alas)** -painikkeita (→ Kuva 49-3), jos haluat säätää **Status (Tila)**-näytössä näkyvien suosikkiprotokollien järjestystä. Napauta **Delete (Poista)**-painiketta (→ Kuva 49-4), jos haluat poistaa suosikkiprotokollan **Status (Tila)**-näytöstä. Napauta **Icon (Kuvake)**-painiketta (→ Kuva 49-5), jos haluat vaihtaa suosikkiprotokollan kuvaketta.

#### Protokollapaneelit

Kun valitset protokollan joko suosikkiprotokollien luettelosta tai protokollien valintaluettelosta, protokollan vaiheet näkyvät oleellisen tislusastian **Status (Tila)**-näytöllä. Käytä paneeleita protokollien lataamiseen ja purkamiseen, käsittelyajon aloittamiseen tai ajon keskeyttämiseen. Voit myös seurata ajon etenemistä.

Voit tarkastella paneeleita kahdessa tilassa: tavallinen (→ Kuva 51) ja laajennettu (→ Kuva 52).

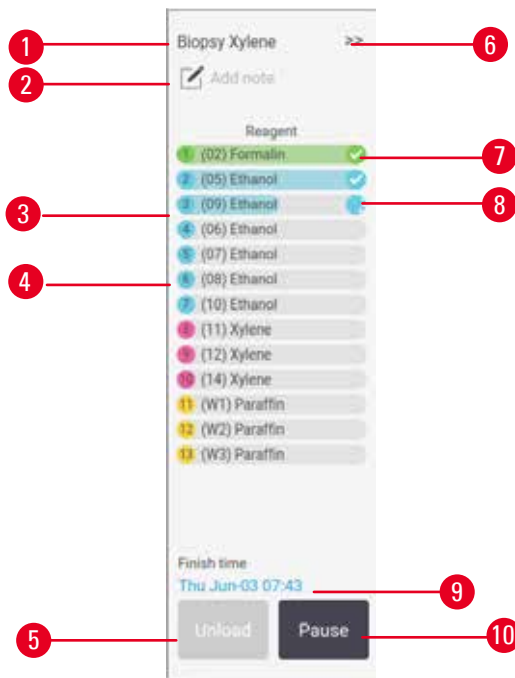

Kuva 51

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokollan nimi</li> <li>2. Huomautusten tila</li> <li>3. Protokollan vaiheet</li> <li>4. Vaihetta varten aikataulutettu asema (voi käyttää eri asemaa)</li> <li>5. <b>Unload protocol (Purkamisprotokolla):</b><br/>Pura protokollat (poistettu käytöstä, kun protokolla on käynnissä)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Laajennettu tila: Napauta nuolta, jos haluat laajentaa protokollan paneelin</li> <li>7. Valmis-vaihe on valittuna</li> <li>8. Värillinen etenemispalkki osoittaa etenemisen nykyisessä vaiheessa</li> <li>9. Protokollan päättymisaika</li> <li>10. <b>Run (Aja)/Pause (Keskeytä):</b> Aloita ladattu protokolla tai keskeytä käynnissä oleva protokolla</li> </ol> |
|---|---|

Laajennetussa tilassa näytetään myös protokollan huomautukset, käsittelyaika ja vaiheen tiedot.



Kuva 52


1. Vaiheen kesto, lämpötila, paine/tyhjiö ja sekoitin päällä/pois päältä

2. Käsittelyaika: protokollan ajamisen kokonaisaika

## 5.5 Protokollan ajamisen vaihtoehdot

Voit myös aikatauluttaa protokollan ajamisen niin, että se valmistuu sopivaan aikaan. Protokollan voi myös asettaa alkamaan toisesta tai myöhemmästä vaiheesta ja vaiheiden kestoja voi muuttaa.

### 5.5.1 Protokollien aikataulutus

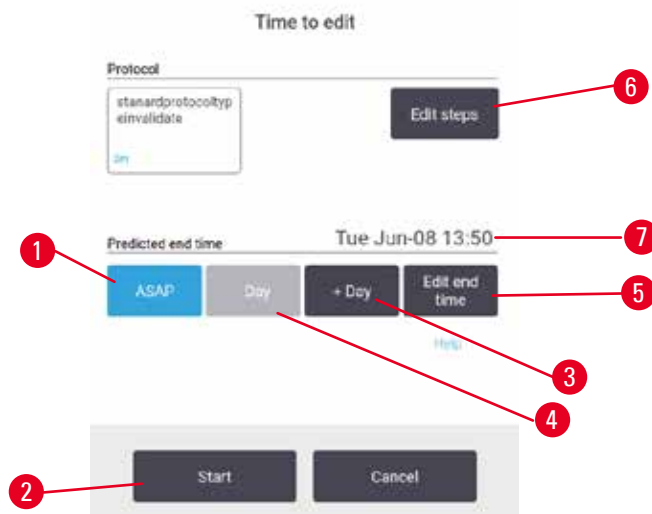

Kuva 53

Protokollan ajo voidaan aikatauluttaa **Time to edit (Muokkausaika)**-valintaikkunassa (→ Kuva 53). Valintaikkuna aukeaa, kun olet ladannut protokollan, syöttänyt telineiden tunnuksot ja syöttänyt kasettien määrän (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla).

Molemmissa tislaukustioissa on oma oletusarvoinen aikataulutusetuksensa (→ s. 80 – Uuden päättymisajan syöttäminen tai oletusaikataulutusetuksen muuttaminen). Voit hyväksyä oletusetuksen tai vaihtaa ajon asetusta. Vaihtoehdot sisältävät päättymisajan vaihtamisen tai protokollan ajon mahdollisimman pian (**ASAP (HETI)**-vaihtoehto) (→ Kuva 53-1). Voit myös vaihtaa tislaukustian oletusaikaa.

Järjestelmä laskee halutun päättymisajan viimeiseksi hyväksyttäväksi protokollan päättymisajaksi. Protokollat saattavat päättyä haluttua päättymisaikaa aiemmin resurssien samanaikaisen käytön estämiseksi.

Puhdistusprotokollien haluttu päättymisaika on aina **ASAP (HETI)**.



#### Huomaa

- Tarkista aina ennen protokollan aloittamista, että ennustettu päättymisaika on sopiva.

#### Protokollan ajon aikatauluttaminen

Kun **Time to edit (Muokkausaika)**-valintaikkuna tulee näkyviin, tislaukustian oletusaikataulutus näkyy siinä.

- Jos oletuspäättymisaika on **ASAP (HETI)**, protokolla on aikataulutettu päättymään mahdollisimman pian.
- Jos oletusetus on tietty vuorokaudenaika, valintaikkuna asettaa oletusarvoksi kyseisen ajan seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoja on neljä:

- Hyväksy oletusarvot sellaisenaan. Muokkaa ajon protokollaa tarvittaessa (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla) ja aloita ajo napauttamalla **Start (Aloita)** (→ Kuva 53-2).
- Käytä oletusaikaa, mutta muuta protokollan ajopäivää. Naputa **+ day (+ päivä)**- (→ Kuva 53-3) tai **- day (- päivä)** -painikkeita (→ Kuva 53-4), jos haluat käyttää samaa päättymisaikaa, mutta vaihtaa päivää. Jos oletusetus on tietty vuorokaudenaika, valintaikkunassa ajo on asetettu seuraavalle päivälle. Jos haluat ajaa protokollan samana päivänä, napauta **- day (- päivä)** -painiketta kerran. Riippuen ajasta, jolloin teet tämän, uusi päättymisaika ei välttämättä ole mahdollinen. Arvioitu päättymisaika (→ Kuva 53-7) näytetään silloin punaisella korostettuna.
- Aloita ajo mahdollisimman pian. Napauta **ASAP (HETI)**-painiketta. Protokolla alkaa yleensä heti. Jos toisessa tislaukustiasassa on kuitenkin käynnissä protokolla, joka aiheuttaa reagenssien ristiriidan, protokollan todellinen aloitus voi viivästyä (→ s. 86 – 5.7.1 Viivästetyt päättymisajat ja alkutäytöt).
- Määritä uusi päättymisaika. Napauta **Edit end time (Muokkaa päättymisaikaa)** -painiketta (→ Kuva 53-5) ja avaa **Enter required end time (Syötä haluttu päättymisaika)** -valintaikkuna. (Katso ohjeet seuraavasta osiosta.)

## 5 Protokollan ajaminen

### Uuden päättymisajan syöttäminen tai oletusaikataulutusasetuksen muuttaminen



Kuva 54

Voit muuttaa tällä hetkellä valitun ajon päättymisaikaa **Enter required end time (Syötä haluttu päättymisaika)** -valintaikkunassa (→ [Kuva 54](#)), joka avataan **Time to edit (Muokkaamisaika)**-valintaikkunasta napauttamalla **Edit end time (Muokkaa päättymisaikaa)** -painiketta (→ [Kuva 53-5](#)).


Voit myös määrittää, että aikataulutusasetus on uusi oletusasetus senhetkisellet tislusastialle.

- Voit määrittää uuden päivämäärän käyttämällä **Tomorrow (Huomenna)**-, **Next Monday (Ensi maanantaina)**-, **+ Day (+ päivä)**- ja **- Day (- päivä)** -painikkeita (→ [Kuva 54-1](#)) päivän muuttamiseen. Voit määrittää uuden päättymisajan käyttämällä numeronäppäimistöä (→ [Kuva 54-2](#)) ja syöttämällä ajan (24 tunnin muodossa) tai käyttää **- 15 min-** tai **+ 15 min-** painikkeita (→ [Kuva 54-3](#)) vaihtaaksesi aikaa 15 minuutin askelissa. Napauta **OK** (→ [Kuva 54-4](#)), kun olet valmis.
- Jos haluat asettaa uuden tislusastian aikataulutusoletusarvon, syötä vuorokaudenaika (vastaavalla tavalla kuin yksittäisen ajon päättymisajan muuttamisen yhteydessä) tai napauta **ASAP (HETI)** (→ [Kuva 54-5](#)). Päivä ei ole olennainen oletusasetuksen kannalta. Napauta **Set as default (Määritä oletusarvoksi)** (→ [Kuva 54-6](#)) ja sitten **OK**.

#### 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla

Kun olet valinnut protokollan ja ennen sen alkamista, voit muuttaa vaihetta, josta se alkaa.



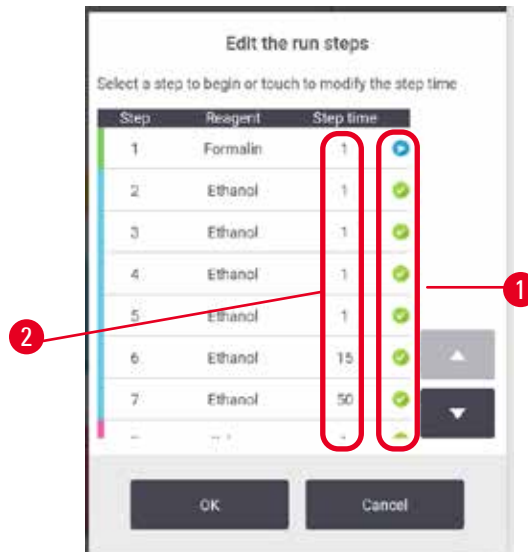

Kuva 55

1. Aloita protokolla tavalliseen tapaan **Status (Tila)**-näytöltä ja jatka, kunnes **Time to edit (Muokkaamisaika)**-valintaikkuna (→ Kuva 53) tulee näkyviin. Napauta **Edit steps (Muokkaa vaiheita)** (→ Kuva 53-6) ja avaa **Edit the run steps (Muokkaa ajon vaiheita)** -valintaikkuna (→ Kuva 55).
2. Jos haluat ohittaa yhden tai useamman protokollan vaiheen, napauta vaiheen kuvaketta (→ Kuva 55-1) sen vaiheen kohdalla, josta haluat protokollan alkavan. Aiempien vaiheiden kuvakkeet katoavat, mikä osoittaa, ettei niitä suoriteta. Uudeksi ensimmäiseksi vaiheeksi valittua reagenssia käytetään tarvittaessa alun täyttöä varten (→ s. 86 – 5.7.1 Viivästetyt päättymisajat ja alkutäytöt).
3. Napauta **OK**. **Time to edit (Muokkaus aika)**-valintaikkuna tulee näkyviin. Voit nyt aikatauluttaa ajon.



**Huomaa**

- Vaiheiden ohittaminen vaikuttaa protokollan aikataulutukseen. Vahvista, että uusi Aikataulutusvalintaikkunassa näkyvä arvioitu päättymisaika on hyväksyttävä ennen kuin jatkat.
- Jos haluat vaihtaa takaisin alkuperäiseen protokollaan tässä vaiheessa, sinun on purettava muutettu protokolla ja ladattava alkuperäinen uudelleen.

**5.5.3 Vaiheen keston muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla**

Kun olet valinnut protokollan ja ennen sen alkamista, voit muuttaa yhden tai useamman protokollan vaiheen kesto.

1. Aloita protokolla tavalliseen tapaan **Status (Tila)**-näytöltä ja jatka, kunnes **Time to edit (Muokkaamisaika)**-valintaikkuna (→ Kuva 53) tulee näkyviin. Napauta **Edit steps (Muokkaa vaiheita)** (→ Kuva 53-6) ja avaa **Edit the run steps (Muokkaa ajon vaiheita)** -valintaikkuna (→ Kuva 55).
2. Jos haluat vaihtaa vaiheen kesto, napauta vaiheen sen hetkistä kesto (→ Kuva 55-2).
3. Määritä uusi kesto valintaikkunassa.

Step time

Enter the step duration

The step duration is the period between the fill and the drain for this step.

0 - 9999 min

0 min

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 Clear

OK Cancel

Kuva 56

4. Napauta **OK** ja toista vaiheet tarvittaessa vaiheesta 2 alkaen, jos haluat vaihtaa muiden vaiheiden kestoa.

**Huomaa**

- Ole varovainen, ettet napauta valintaikkunan oikealla puolella olevaa vaihekuvaketta. Vaihekuvakkeen napauttaminen voi vaihtaa protokollan aloitusvaihetta.

5. Napauta **OK**. **Time to edit (Muokkaus aika)**-valintaikkuna tulee näkyviin. Voit nyt aikatauluttaa ajon.

**Huomaa**

- Vaiheiden keston muuttaminen vaikuttaa protokollan aikataulutukseen. Vahvista, että uusi **Predicted end time (Arvioitu päättymisaika)**, joka näkyy Muokkaus aika-valintaikkunassa, on hyväksyttävä ennen kuin jatkat.

## 5.6 Protokollien keskeyttäminen




### Varoitus

Jos tislusastia avataan, kun instrumentti on käsittelyn keskellä / keskeyttämisen jälkeen / protokollan päättymisen jälkeen, käyttäjä joutuu kosketuksiin tislusastian kannen/telineen kuuman pinnan / vaarallisten aineiden/höyryn kanssa.

Jos tislusastia avataan, protokolla ei voi jatkua.

#### Henkilövamma / näytteen vaurioituminen / vaarantuneet näytteet

- Kuuma pinta. Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia käytön aikana.
- Älä avaa tislusastian kantta tai poista reagenssipulloja / parafiinilämmittimen suojusta / parafiinialtaita, kun protokolla on käynnissä, ellei järjestelmän viesti pyydä sinua tekemään niin. Jos haluat poistaa näytteitä tislusastiasta tai lisätä näytteitä tislusastiaan, kun protokolla on käynnissä, paina keskeytyspainiketta.
- Ole varovainen, jos avaat tislusastian tai parafiinialtaan instrumentin toiminnan keskeyttämisen jälkeen. Lue kaikki varoitusviestit (esim. tislusastia on liian kuuma eikä siihen voi koskea turvallisesti) ja noudata soveltuvia varoimenpiteitä ennen jatkamista.
- Sulanut parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Ole varovainen, kun käsittelet parafiinia ja poistat telineitä.

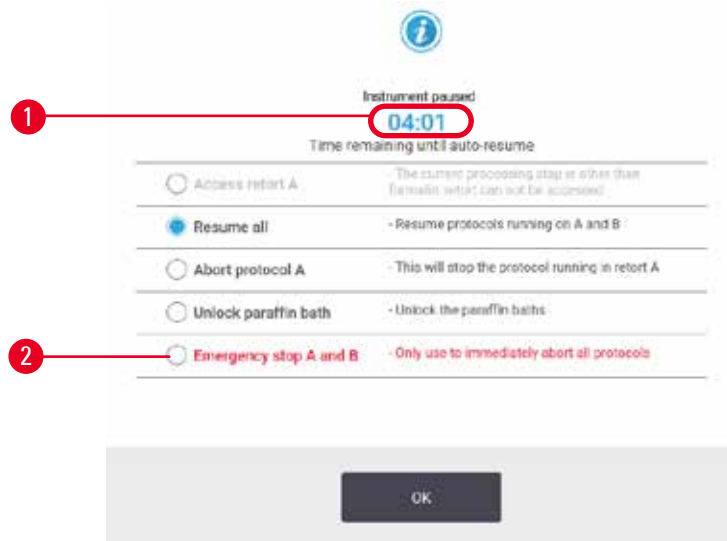

Kuva 57

Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan protokollan, napauta jotakin **Pause (Keskeytä)**-painikkeista **Status (Tila)**-näytön protokollapaneeleissa. Kun napautat kumpaa tahansa **Pause (Keskeytä)**-painiketta, molempien tislusastioiden protokollat keskeytyvät ja **Instrument paused (Instrumentti keskeytetty)** -valintaikkuna (→ Kuva 57) tulee näkyviin vaihtoehtoinen:

- Keskeytä pysyvästi kaikki käsittely tai vain yhden tislusastian protokolla.
- Avaa tislusastia (esimerkiksi kasettien lisäämistä varten) ja jatka siinä ajettavaa protokollaa.
- Tyhjennä parafiinialtaat, jotta voit avata ne.

Kun järjestelmä alkaa laskea alaspäin (→ Kuva 57-1), valinnat ovat käytettävissä. Sinulla on viisi minuuttia aikaa valita jokin vaihtoehto, minkä jälkeen käsittely jatkuu automaattisesti.

#### Hätäpysäytys ja -keskeytys

Kun instrumentti on keskeytetty, voit keskeyttää pysyvästi kaikki protokollat **Hätäpysäytys**-painikkeella (→ Kuva 57-2). Huomioi, että tämä ei sammuta instrumenttia tai kytke pois sen virtaa (→ s. 51 – 4.6 Käynnistäminen ja sammuttaminen).

Vaihtoehtoisesti voit keskeyttää pysyvästi vain valitun tislusastian protokollan ajon soveltuvalla **Abort (Keskeytä)**-painikkeella. Toisessa tislusastiassa ajettavaa protokollaa jatketaan.

Kun käsittely päättyy, instrumentti käy läpi samat rutiinit kuin tavallisen protokollan ajon päätteeksi. Se pyytää tyhjentämään tislusastian (jos se on täynnä), poistamaan kasetit ja suorittamaan puhdistusprotokollan. Palautusvaiheissa on kuitenkin ylimääräinen ilmoitus (näytöllä olevat ohjeet auttavat sen toteuttamisessa) (→ s. 85 – 5.6.1 Keskeytyneen ajon jälkeinen palautuminen).



#### Huomaa

- Kun protokolla on keskeytetty pysyvästi, kasettien palauttamiseen saatetaan tarvita uudelleen käsittelyprotokolla. Siinä tapauksessa kasetteja ei tule poistaa eikä puhdistusprotokollaa tule suorittaa, kun instrumentti niin ilmoittaa. Soveltuvat toiminnot pysyvästi keskeytetyn ajon jälkeen löytyvät kohdasta (→ s. 85 – 5.6.1 Keskeytyneen ajon jälkeinen palautuminen).
- Jos viimeisin reagenssi oli kiinnitysaine, voit ohittaa puhdistusprotokollan, sillä jäänteet eivät estä tavallisen käsittelyprotokollan ajamista. Jos päätät ajaa puhdistusprotokollan, määritä ensimmäinen vaihe puhdistusetanoliksi (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla). Puhdistusliuottimet eivät ole yhteensopivia kiinnitysaineiden kanssa.

#### Tislusastian avaaminen

Voit avata keskeytetyn instrumentin tislusastiat (esimerkiksi näytteen lisäämistä tai poistamista varten). Jos tila riittää, voit lisätä kasetteja telineisiin tai lisätä telineen yhteen tai molempiin tislusastioihin, jos molemmissa tislusastioissa oli vain yksi teline. Jos lisäät telineitä, voit syöttää niiden tunnuksen joko skannaamalla tai syöttämällä tiedot suoraan ennen ajon jatkamista.

Jos haluat lisätä enemmän kasetteja tai telineitä, tislusastia kannattaa tyhjentää ennen sen avaamista.



#### Varoitus

Kiinteiden näytteiden lisääminen käynnissä olevaan protokollaan.

#### Heikentyneet näytteet.

- Ole varovainen, kun lisäät kiinteitä näytteitä käynnissä olevaan protokollaan. Ylimääräinen kiinnitysaine kontaminoi sen hetkessä vaiheessa käytetyn reagenssin, mutta reagenssinhallintajärjestelmä ei seuraa tätä kontaminaatiota.

**Varoitus**

Lisänäytteiden lisääminen käsittelyn aikana.

**Heikentyneet näytteet.**

- Mitä pidemmälle protokolla on edennyt ennen kuin lisää näytteitä, sitä heikompi kyseisten näytteiden käsittelylaatu on. Näytteitä tulee lisätä vain kiinnitysainevaiheissa tai ensimmäisen vedenpoistoainevaiheen aikana.

Tislausastian avaaminen, kun instrumentti on käynnissä:

1. Keskeytä instrumentti napauttamalla jotakin **Pause (Keskeytä)**-painikkeista **Status (Tila)**-näytöllä.
2. Napauta soveltuvaa **Access retort (Ava tislusastia)** -painiketta **Instrument paused (Instrumentti keskeytetty)** -valintaikkunassa.
3. Valitse **The retort is not empty (Tislausastia ei ole tyhjä)** -valintaikkunassa, haluatko tyhjentää tislusastian vai et. Odota ohjeiden mukaisesti, jos tyhjänsä sen.
4. Kun **Retort Baskets (Tislausastian telineet)** -valintaikkuna aukeaa, poista telineet tislusastiasta ja lisää tai poista kasetteja tarpeen mukaan.
5. Palauta telineet tislusastiaan (skannaa tai syötä tunnukset tarvittaessa) ja napauta **OK Retort Baskets (Tislausastian telineet)** -valintaikkunassa.
6. Napauta **Resume All (Jatka kaikkia) Instrument (Instrumentti) paused (keskeytetty)** -valintaikkunassa, kun haluat jatkaa protokollaa.

### 5.6.1 Keskeytyneen ajon jälkeinen palautuminen

1. Kerää tietoja
  - A. Tarkista **Run Detail (Ajon tiedot)** -raportti (**Administration (Hallinnointi) > Reports (Raportit) > Run Details (Ajon tiedot)**).
  - B. Tarkista tapahtumalokit (**Administration (Hallinnointi) > Event Logs (Tapahtumalokit)**).
2. Tee päätöksiä
  - A. Tuleeko kudosten käsittelyä jatkaa instrumentilla raporttien ja lokien tietojen perusteella?
  - B. Jos instrumentissa on esiintynyt virhe, poista kudokset ja käytä **Run Details (Ajon tiedot)** -raporttia, kun päätät, mistä vaiheesta jatkat toisen instrumentin kanssa.
  - C. Jos instrumentti on kunnossa, mutta jokin reagenssi puuttuu tai sen taso on matala, korjaa tilanne ja käytä sitten **Run Details (Ajon tiedot)** -raporttia, kun päätät, mistä vaiheesta jatkat.
3. Toimi: Päätöksesi perusteella voit joko
  - A. poistaa kudoksen instrumentista ja soittaa huoltoon tai
  - B. jatkaa käsittelyä lataamalla protokollan ja valita soveltuvan aloitusvaiheen käyttämällä **Edit steps (Muokkaa vaiheita)** -toimintoa (→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla).

### 5.7 Tislausastian aikataulut

Järjestelmä sallii protokollien samanaikaisen ajamisen molemmissa tislusastioissa. Automaattinen aikataulutustoiminto pyrkii määrittämään reagenssiasemat ja aloitusajat niin, ettei protokollien välillä ole ristiriitoja. Instrumentti voi muuttaa haluamaasi päättymisaikaa aloittamalla protokollan aiemmin tai viivästyttämällä yhtä tai useampaa vaihetta (→ s. 86 – 5.7.1 Viivästetyt päättymisajat ja alkutäytöt).

Kun toinen protokolla alkaa, protokollan lataamisen aikana määritetyt reagenssiasemat voivat muuttua. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisen protokollan reagenssivaatimukset ovat aina ensisijaisia.

Toista protokollaa ei voida aina aikatauluttaa. Tätä ja sen mahdollisia ratkaisuja käsitellään kohdassa (→ s. 86 – 5.7.3 Reagensseja ei saatavilla). Protokollat voivat myös joskus epäonnistua, jos reagenssiasema ei ole jostain syystä yhtäkkiä käytettävissä. Katso kohdasta (→ s. 86 – 5.7.3 Reagensseja ei saatavilla) tapoja, joilla tämä tilanne voidaan välttää.

### 5.7.1 Viivästetyt päättymisaajat ja alkutäytöt

Protokollien ei tarvitse alkaa heti ja niille on mahdollista määrittää haluttu päättymisaika, mikä aiheuttaa viiveen ennen protokollan aloittamista. Viive voi olla jopa useita päiviä. Kun valitset **HETI** (mahdollisimman pian) -aikataulusvalinnan tai kun olet pyytänyt päättymisaikaa, jota ei voida toteuttaa, instrumentin on mahdollisesti viivästyttävä protokollan alkua. Protokollaviiveen aikana instrumentti suojaa kasetteja peittämällä ne reagenssilla. Tätä prosessia kutsutaan alkutäytöksi.

Alkutäytön aikana tislauksastia täytetään ensimmäisellä aikataulutetulla reagenssilla (yleensä kiinnitysaineella) näyttöjen suojaamista varten. Jos reagenssi on jokin muu kuin parafiini, se ei aiheuta lämpenemistä tai sekoittamista. Jos alkuvaihe on parafiinivaihe (vain uudelleen käsittelyprotokollat tai pelkästään parafiinia käyttävät protokollat), tislauksastian lämpötila asetetaan parafiinin valmiustilaan ja sekoitin asetetaan ensimmäisen vaiheen nopeuden mukaiseksi. Kun alkutäytösjakso on ohitettu, protokolla suoritetaan tavalliseen tapaan ja se päättyy arvioituna päättymisaikana.

Suosittellemme, että kaikki protokollat alkavat kiinnitysainevaiheella (vaikka se olisikin lyhyt), jolloin kiinnitysainetta käytetään kaikissa alkutäytöissä. Jos kiinnitysainevaihetta ei ole, alkutäyttö voi jättää kudokset vedenpoistoaineella peitetyiksi pitkäksi aikaa, mikä voi aiheuttaa kudosten kovettumista ja hapertumista.

### 5.7.2 Reagenssien ristiriidat, joita ei voida välttää

Ristiriidat, joita ei voida välttää, tapahtuvat, kun reagenssiasemia ei ole riittävästi saatavilla molempia protokollia varten, jotta reagenssien valintasäännöt voidaan täyttää (→ s. 89 – 6.1.2 Reagenssien valintatapa). Tämä tapahtuu enimmäkseen silloin, kun käytetään tyyppipohjaisia tai asemapohjaisia protokollia, sillä niiden asemamäärityksen joustavuus on rajallista.

Varmista aina, että ensimmäisen reagenssiryhmän tai -tyypin asemat ovat riittäviä, jotta asema on aina saatavilla alkutäyttöä varten.

### 5.7.3 Reagensseja ei saatavilla

Protokollan alettua tyyppiperusteiset protokollat saattavat määrätä asemia uudelleen, jotta ne palautuvat virheistä, jotka johtuvat siitä, että jotkin reagenssit eivät ole käytettävissä (pullo on esimerkiksi tiheysmittarin lukitsema). Tämä uudelleenmääritys saattaa käyttää toiselle protokollalle määritettyjä reagensseja.



#### Huomaa

- Asemapohjaiset protokollat epäonnistuvat, jos määritetty reagenssi ei ole enää käytettävissä. Tyyppipohjaiset protokollat epäonnistuvat, jos määrätyn tyyppin asemia on vain yksi ja se ei ole enää käytettävissä.

Yleisiä syitä ovat se, ettei asema ole käytössä, ja syiden välttämistapoja kuvataan alla.

- Asemassa ei ole riittävästi reagenssia. Tarkista ennen jokaista ajoa, että jokaisen aseman reagenssitaso on riittävä sen hetkiselälle täyttötasolle. (Nykyinen taso näkyy kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat)**.)
- Käyttöön aikataulutettu pullo poistetaan reagenssikaapista. Turvallisuussyistä reagenssipulloja ei tule poistaa, kun protokolla on käynnissä. Jos kuitenkin poistat pullon, varmista, että poistettavaa pulloa ei ole aikataulutettu käytettäväksi kummassakaan tislusastiassa.
- Parafiiniasema ei ole sulanut siihen mennessä, kun sitä tarvitaan. Varmista, että parafiinilla on riittävästi aikaa sulaa ja että oikea parafiiniasema on määritetty ([→ s. 117 – 7.3.2 Reagenssiaseman ominaisuuksien hallinta](#)).
- Tiheysmittari on laskenut pitoisuuden, eikä se vastaa reagenssille **Reagent Stations (Reagenssiasemat)**-näytössä tallennettua pitoisuutta (**Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat)**). Pullon sisältö on vaihdettava tai tarkistettava (operaattorien tai esihenkilöiden toimesta) ja esihenkilön on päivitettävä pitoisuus. Tiheysmittarit tarkistavat pitoisuuden uudelleen.

## 6. Protokollan alkuasetukset

### 6.1 Protokollan yleiskatsaus

Protokolla koostuu vaiheista, jotka suoritetaan tislauksastian kudoksille sarjana. Tislauksastia täyttyy jokaisessa vaiheessa (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) reagenssilla protokollan hallitsemien olosuhteiden ja keston mukaisesti. Jokaisessa protokollan vaiheessa määritetään:

- käytettävä reagenssi
- aika, jonka reagenssi on tislauksastiassa
- reagenssin lämpötila
- tislauksastian paine: ympäristön paine, paineistettu tai tyhjiö tai vaihteleva paineistetun ja tyhjiön välillä
- tislauksastian sekoitin päällä / pois päältä
- valumisaika eli aika, jonka aikana reagenssi saa valua kaseteista ja tislauksastian seinämistä ennen kuin protokolla aloittaa seuraavan vaiheen. Pidemmät valumisajat vähentävät siirtymiä.

Poikkeuksellinen vaihetyyppi on puhdistusprotokollan viimeinen kuivausvaihe, jossa ei käytetä reagensseja.

Protokollatyyppiä on viisi. Protokollan tyyppi määrittää rajoituksia sille, mitä reagensseja voidaan käyttää ja missä järjestyksessä.

Muut protokollan ominaisuudet ovat reagenssien valintatapa ja pakollinen siirtymäarvo.

#### 6.1.1 Protokollatyytit

Instrumentti käyttää viittä protokollatyyppiä: ne sopivat eri käsittelytoimintoihin. Protokollatyytit sallivat erilaisia reagenssijaksoja ja lämpötila-alueita ([→ s. 167 – 10.5 Reagenssien yhteensopivuustaulukot](#)) ([→ s. 167 – 10.4 Protokollavaiheiden lämpötilat](#)). Kun protokolla on luotu, sen tyyppiä ei voida muuttaa.

Protokollatyytit ovat:

- **Standard (Tavallinen)** – Perinteinen kudostenkäsittelyjakso, joka käyttää ksyleenin kaltaista kirkastajaa. Nämä protokollat soveltuvat tavallisten käsittelyvaatimusten täyttämiseen ja voivat sisältää rasvanpoistovaiheita.
- **Xylene-free (Ksyleenitön)** – Protokollat, joissa käytetään korkean lämpötilan parafinivaiheita ja edistyneitä käsittelytekniikoita kudosten käsittelyyn ilman perinteisiä puhdistusvaiheita. Nämä protokollat soveltuvat tavallisten käsittelyvaatimusten täyttämiseen.
- **Cleaning (Puhdistus)** – Protokollat, joiden avulla puhdistetaan tislauksastiat ja yleiset reagenssilinjat. Aja puhdistusprotokolla aina mahdollisimman pian sen jälkeen, kun parafiinia on ollut tislauksastiassa. Katso lisätietoja kohdasta Puhdistusprotokollat ([→ s. 66 – 5.3 Puhdistusprotokollat](#)).
- **Standard Reprocessing (Tavallinen uudelleenkäsittely)** – Alikäsitellyn kudoksen palauttaminen instrumentissa, joka on määritetty tavallista käsittelyä varten. Nämä protokollat alkavat puhdistusreagensseilla ennen kuin ne aloittavat tavallisen kudostenkäsittelyjakson.



- **Xylene-free Reprocessing (Ksyleenitön uudelleen käsittely)** – Alikäsitellyn kudoksen palauttaminen instrumentissa, joka on määritetty ksyleenitöntä käsittelyä varten. Nämä protokollat alkavat puhdistusreagensseilla ennen kuin ne aloittavat ksyleenittömän kudosten käsittelyjakson.

Protokollatyypeissä käytetyt kuvakkeet on selitetty kohdassa (→ s. 94 – 6.2.1 Protokollan valinta -näyttö).

Huomioi seuraavat:

- Ksyleenittömän reagenssin valinta – Ksyleenittömät protokollat käyttävät kahta vedenpoistoainetta toisin kuin vakioprotokollat, joissa vedenpoistoainetta seuraa kirkastaja.
- Ksyleenittömät telineet – Käytä aina jousellisia telineitä ksyleenittömissä protokollissa.
- Siirtymän uudelleen käsittely – Uudelleen käsittelyprotokollien aikana reagenssin siirtymää ei ole merkittävästi puhdistusaineiden käytön takia. Kun olet ajanut uudelleen käsittelyprotokollan, viimeisen puhdistusreagenssin jälkeen käytetyt kolme ensimmäistä käsittelyreagenssia tulisi vaihtaa.

### 6.1.2 Reagenssin valintatapa

Kaikissa protokollissa käytetään toista kahdesta reagenssin valintatavasta: tyyppi tai asema. Kun protokolla on luotu, sen reagenssin valintatapaa ei voi muuttaa.

Protokollan reagenssin valintatapa määrittelee tavan, jolla järjestelmä valitsee reagenssiasemia, kun protokolla on käynnissä. Asemavalintatavassa voit määrittää tarkalleen, mitä asemaa käytetään missäkin vaiheessa, joten järjestelmä ei tee itse valintoja. Tyypivalintatavassa järjestelmä valitsee parhaan saatavilla olevan aseman (→ s. 89 – Aseman valintasäännöt). Yhteenveto:

- **Type selection (Tyypivalinta)** – Järjestelmä valitsee protokollan vaiheessa määritetyn reagenssin sopivista asemista. Valinnassa käytetään asemien reagenssinimiä (eli tyyppiä) ja pitoisuutta. Instrumentissa voi olla esimerkiksi kaksi pulloa, joiden reagenssityyppi on 70-prosenttinen etanoli. Jos ensimmäinen protokollan vedenpoistoainevaihe määrittää reagenssiksi 70-prosenttisen etanolin, käytetään 70-prosenttista etanolipulloa, jonka pitoisuus on alempi.
- **Station selection (Asema valinta)** – Järjestelmä käyttää protokollassa määritettyjä asemia. (Yleensä pullot määritellään järjestyksessä: ensin pullo 1, sitten pullo 2 ja pullo 3 jne.). Asemat on määritelty numeroin, joten valinnassa ei käytetä aseman reagenssin nimeä (sen tyyppiä) tai reagenssiryhmää. Yllä olevan esimerkin mukaisesti: jos instrumentissa on kaksi 70-prosenttistä etanolipulloa ja protokollan ensimmäinen vedenpoistoainevaihe määrittelee kahdesta pullosta ensimmäisen, kyseistä pulloa käytetään aina toisen pullon reagenssin pitoisuudesta riippumatta.

#### Aseman valintasäännöt

Järjestelmä käyttää seuraavia sääntöjä valitakseen protokollille asemat tyyppipohjaisen reagenssivalinnan tapauksessa. Jaksolla tarkoitetaan jatkossa protokollan vaiheiden sarjaa, joka käyttää samaa reagenssityyppiä.

- Jakson ensimmäinen vaihe käyttää pitoisuudeltaan matalinta mahdollista asemaa.
- Jakson viimeinen vaihe käyttää pitoisuudeltaan korkeinta mahdollista asemaa.
- Jakson välivaiheet käyttävät matalimman pitoisuuden asemaa, jota ei ole vielä käytetty.
- Jos tietyllä reagenssiryhmällä tai -tyypillä on vain yksi vaihe, siinä käytetään korkeimman pitoisuuden asemaa.
- Asemat, jotka ovat ylittäneet käyttöraja-arvonsa (eikä niitä ole lukittu), valitaan vain silloin, kun muita asemia ei ole saatavilla.

### Reagenssien valintatapojen vertailu

Protokollia luodessa on syytä päättää, mikä tapa sopii parhaiten käsittelytarpeisiin ja reagenssien hallintastrategiaan. Huomioi, että ksyleenittömissä protokollissa vedenpoistoaineita käytetään kahteen eri toimintoon.

Tyyppin valinta tarjoaa seuraavat edut: optimaalinen reagenssien valinta pitoisuuden mukaan, erittäin vähän tarvetta reagenssien hallintaan, tehokas reagenssien käyttö ja hyvin vähän aikataulutuksen ristiriitoja.

Aseman valinta antaa sinulle täyden reagenssien valinnan hallinnan. Huomioi kuitenkin, että kun reagenssit heikkenevät, protokollien välissä on mahdollisesti vaihdettava pullojen järjestystä, jos haluat varmistaa, että protokollan aikana käytetään sopivia reagensseja. Tämä lisää hallinnon aiheuttamaa kuormaa merkittävästi ja voi aiheuttaa virheitä. Aseman valintatapa ei myöskään salli instrumentille joustavuutta protokollien aikataulutuksen aikana. Se ei esimerkiksi voi palautua käsittelyvirheestä, joka johtuu odottamattomasta reagenssin puuttumisesta.



#### Huomaa

- Kun käytät aseman valintaa käyttäviä protokollia, tarkista määrättyjen asemien pitoisuudet ennen ajon aloittamista, sillä pitoisuudet eivät ole välttämättä oikeassa järjestyksessä muiden protokollien ajon jäljiltä.

Reagenssien valintatavan päätöksessä on huomioitava myös se, miten monta ja minkälaisia reagenssityyppejä käytät sekä niille määritetyt pitoisuusraja-arvot. Huomioi, että kaikki järjestelmän ennakkoon määritetyt protokollat käyttävät tyyppivalintaa, mutta suositellulla pullomäärityksellä, joissa reagenssityyppejä on mahdollisimman vähän ([→ s. 160 – 10.2.2 Ennalta määritettyjen protokollien luettelo](#)) ([→ s. 164 – 10.3 Aseman määritykset](#)).

### 6.1.3 Ennakkoon määritetyt protokollat

Järjestelmässä on 5 ennakkoon määritettyä protokollaa: Biopsia – ksyleeni, Yön yli – ksyleeni, Biopsia – ksyleeniton, Yön yli – ksyleeniton ja Pikapuhdistus. Kaikkien protokollien tavoin myös ennakkoon määritettyjä protokollia voidaan käyttää kohdassa **Hallinnointi > Protokollat**.

Ennakkoon määritetyt protokollat on suunniteltu käytettäväksi pullomääritysten kanssa ([→ s. 164 – 10.3 Aseman määritykset](#)). Leica Biosystems on testannut protokollia laajalti ja saanut niistä erinomaisia tuloksia (yhdessä kunnollisen reagenssien hallinnan ja laitehuollon kanssa). Käyttäjien tulee silti validoida kaikki heidän laboratorioissaan käytettävät protokollat, myös ennalta määritetyt protokollat, sillä erilaiset olosuhteet saattavat tuottaa erilaisia tuloksia.


Ennalta määritetyt protokollat voidaan kopioida ja kopioita voidaan muokata tarkoitukseen sopivaksi. Kopiot on nimettävä uudelleen ennen kuin niitä voidaan muokata (→ s. 97 – 6.2.3 Uusien protokollien luominen).

#### 6.1.4 Protokollan validointi

Protokollia luovat tai muokkaavat (tai ennalta määritettyjä protokollia kopioivat) esihenkilöt voivat validoida ne ohjelmistossa. Tämä toimii merkinä siitä, että protokollat ovat läpäisseet laboratorion validointitestit ja niitä voidaan käyttää normaalissa kliinisessä käsittelyssä. Esihenkilöt voivat myös mitätöidä valideja protokollia.

Operaattoritason käyttäjät voivat suorittaa validoituja protokollia, mutta eivät mitätöityjä protokollia. Esihenkilöt voivat suorittaa mitätöityjä protokollia.

Validoitujen protokollien kuvakkeessa on valintamerkki (→ Kuva 58-1) vihreässä ympyrässä, kun taas mitätöityjen protokollien kuvakkeessa on rasti (→ Kuva 58-2) punaisessa ympyrässä.

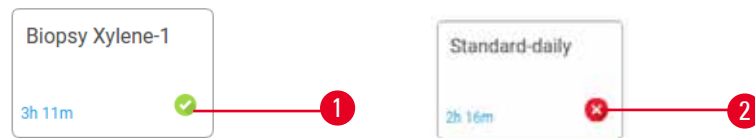

Kuva 58

Aseta protokollan validointitila **Edit protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytöllä napauttamalla **Validate protocol (Validoi protokolla)** (validoidaksesi mitätöidyn protokollan) tai **Invalidate protocol (Mitätöi protokolla)** (mitätöidäksesi validoidun protokollan).

#### 6.1.5 Siirtymäasetus

Kun reagenssi virtaa pois tislauksiasta, tietty määrä reagenssia jää tislauksiastaan ja sekoittuu protokollan seuraavaan reagenssiin. Siirtymäasetus on arvio reagenssimäärästä, joka siirtyy protokollan vaiheesta seuraavaan. Reagenssinhallintajärjestelmä ottaa siirtymäasetuksen huomioon määrittäessään reagenssipitoisuuksia.

Siirtyvä reagenssijäämä voi olla peräisin

- tislauksiasta seinämiin ja telineisiin jääneestä reagenssista
- kudoksen pinnalla tai sisällä olevasta reagenssista
- pienkudoksentajien (esim. biopsiatyynyjen, biopsiakasettien, kääreiden jne.) pinnalla tai sisällä olevasta reagenssista.

Reagenssinhallintajärjestelmä laskee automaattisesti siirtymän tislauksiasta seinämissä ja telineissä ottaen valumisajan huomioon.

Koteloista ja kudoksista johtuva siirtymä lasketaan käyttäjien kunkin käyttökerran alussa syöttämien kasettien määrän perusteella. Laskelmassa käytetään tavalliseen kasettiin jäävän siirtymän määrää. Myös valumisaika otetaan huomioon.

Reagenssinhallintajärjestelmä laskee siirtymän pienkuduskantajista käyttämällä käyttäjän asettamaa protokollan siirtymäarvoa.

Siirtymäarvojen väli on 0–100:

- 0-asetus tarkoittaa, että pienkuduskantajista, kuten biopsiatyynyistä, johtuvaa siirtymää ei ole, eli käyttökerta suoritetaan tavallisilla kaseteilla ilman pienkuduskantajia.
- 100-asetus tarkoittaa, että siirtymän määrä vastaa käyttökerran kaikkien kudosten suorittamista biopsiatyynyillä. (Biopsiatyynyissä on pienkuduskantajista suurin siirtymämäärä.)

Koska biopsiatyynyissä voi olla jopa 10 kertaa tavallisten kasettien siirtymämäärä, on tärkeää asettaa protokoliin todellista vastaava siirtymämäärä (sekä syöttää kasettien määrä oikein kullakin käyttökerralla). Jos siirtymämäärä asetetaan liian korkeaksi, järjestelmä laskee reagensseille liian suuren hajoamisen, jolloin ne täytyy vaihtaa tarpeettoman aikaisin. Jos asetus on liian alhainen, järjestelmä luulee reagenssien olevan todellista puhtaampia. Silloin reagensseja käytetään niiden optimaalista tehokkuutta pidempään, mikä johtaa huonoon käsittelylaatuun.

Vain esihenkilöt voivat asettaa siirtymäarvoja. Oletusarvo asetetaan **Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytöllä (**Settings (Asetukset) > Processing settings (Käsittelyasetukset)**). Tietyn protokollan siirtymäarvoa voidaan muuttaa **Edit Protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytöllä (**Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat) > Edit (Muokkaa)**). Napauta **Carryover (Siirtymä)**-painiketta ja syötä numero välillä 0 (ei siirtymää pienkuduskantajista) ja 100 (suurin siirtymä pienkuduskantajista).

### Siirtymäarvojen laskeminen

Siirtymä riippuu käytettyjen kasettien ja muiden pienkuduskantajien tyypistä: biopsiatyynyt, paperi- tai kudossyötteen, minikasetit, biopsiakasetit jne. Se riippuu myös niiden osuudesta kullakin käyttökerralla.

Siirtymäasetus on protokollakohtainen, ei käyttökertakohtainen, joten se on asetettava kyseistä protokollaa käyttävien käyttökertojen keskimääräisen siirtymäarvon mukaan.

Alla olevassa taulukossa näkyvät siirtymäarvot, joita tulee käyttää Leica Biosystems -merkkisten kasettien ja muiden kuduskantajien kanssa. Taulukon arvot ovat voimassa, kun kaikissa käyttökerran kudoksissa käytetään tiettyä kasetti- tai kantajatyyppeä.

**Taulukko 6.1: Leica Biosystems -merkkisten kuduskantajien siirtymäarvot**

Leica Biosystems -tuotteet	Kuduskantajan yleiskuvaus	Siirtymäarvo, kun 100 % kudoksesta käyttää kantajaa
Surgipath ActivFlo Routine I	Tavallinen kasetti	0
Surgipath-biopsiatyynyt Surgipath ActivFlo Routine I:ssä	Biopsiatyyny tavallisessa kasetissa	100

Leica Biosystems -tuotteet	Kudoskantajan yleiskuvaus	Siirtymäarvo, kun 100 % kudoksesta käyttää kantajaa
ActivFlo-minikasetti Surgipath ActivFlo Routine I:ssä	Minikasetti tavallisessa kasetissa	50
Surgipath-biopsiakääreet Surgipath ActivFlo Routine I:ssä	Biopsiakääreet tavallisessa kasetissa	20
Surgipath IP ActivFlo Biopsy I McCormick MC-605	Biopsiakasetit, joiden huokoskoko on > 1 mm	0

### Esimerkilaskelma

Oletetaan, että protokollan keskimääräinen käyttökerta sisältää seuraavat osuudet kuduskantajia:

- Surgipath ActivFlo Routine I: 40 %
- Surgipath-biopsiakääreet Surgipath ActivFlo Routine I:ssa: 60 %

Kerrotaan kunkin kantajan osuus sen arvolla yllä olevassa taulukossa ja lasketaan kyseisen kantajan lisäsiirtymä:

- Surgipath ActivFlo Routine I:  $40\% \times 0 = 0$
- Surgipath-biopsiakääreet Surgipath ActivFlo Routine I:ssa:  $60\% \times 20 = 12$

Lasketaan tuloksena saadut arvot yhteen:

$$0 + 12 = 12$$

Protokollaan syötetään siirtymäarvo 12.

### Muut tuotteet

Muille kuin taulukossa 6.1 (→ s. 92 – Taulukko 6.1: Leica Biosystems -merkkisten kuduskantajien siirtymäarvot) luetelluille pienkuduskantajille suosittelemme aloitettavan siirtymäasetuksella 50. Muokkaa arvoa kudoksen ja reagenssin laadun tarkkailun perusteella. Kudoksen kutistuminen blokissa ja ylimääräinen liuotin parafinialtaassa saattavat viitata liian alhaiseen siirtymäasetukseen.



#### Varoitus

**Käsittelyssä oleville näytetyypeille sopimattomat siirtoasetukset voivat aiheuttaa näytteen vaurioitumisen!**

Varmista oikeat siirtoasetukset:

- Katso kantautumisasetukset luvusta 6.1.5 "Siirtymäasetus".
- Laboratorion on validoitava ennalta määritellyt ja mukautetut protokollat (mukaan lukien siirtymisarvo) standarditoimintaohjeidensa mukaisesti.



#### Huomaa

- On käyttäjän vastuulla validoida omien protokolliensä siirtymäasetukset. Apua sopivien siirtymäarvojen asettamiseen saa ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

### 6.1.6 Protokollatiedostot

Protokollia voidaan viedä USB-yhteyden kautta tietokantatiedostoon, jonka päätte on .db. Tiedoston voi varmuuskopioida. Protokollat voi myös lähettää huoltoedustajalle vianmääritystä varten. Varmuuskopioidut protokollatiedostot voidaan tuoda HistoCore PEGASUS Plus -ohjelmistoon.

Kohdassa Tiedoston siirto (→ s. 138 – Vie tiedostoja) on ohjeet protokollatiedostojen viemiseen ja tuomiseen.

## 6.2 Protokollien luominen, muokkaaminen ja tarkastelu


Esihenkilöt voivat luoda ja muokata protokollia. Tämä tapahtuu **Protokollan valinta** -näytöllä. Operaattorit eivät voi luoda tai muokata protokollia, mutta he voivat tarkastella protokollatietoja **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöllä.

### 6.2.1 Protokollan valinta -näyttö

Napauta **Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)** ja avaa **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näyttö. Täällä pääset käsiksi kaikkiin protokollan määritysvaihtoehtoihin.

#### Protokollakuvakkeet

Kutakin protokollaa edustaa valittava kuvake **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöllä. Kussakin kuvakkeessa on seuraavat protokollan tiedot:

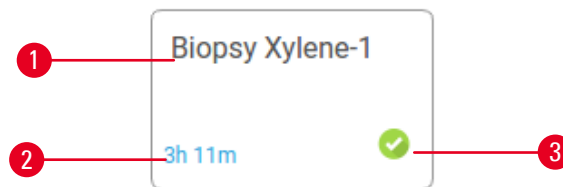


Kuva 59

1. Protokollan nimi
2. Protokollan kestoaika
3. Validointitila


### 6.2.2 Protokollien muokkaaminen

Vain esihenkilöt voivat muokata protokollia. Voit muokata protokollaa avaamalla **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytön (**Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)**), valitsemalla protokollan ja napauttamalla **Edit (Muokkaa)**. **Edit Protocol (Muokkaa protokollaa)** -näyttö avautuu.

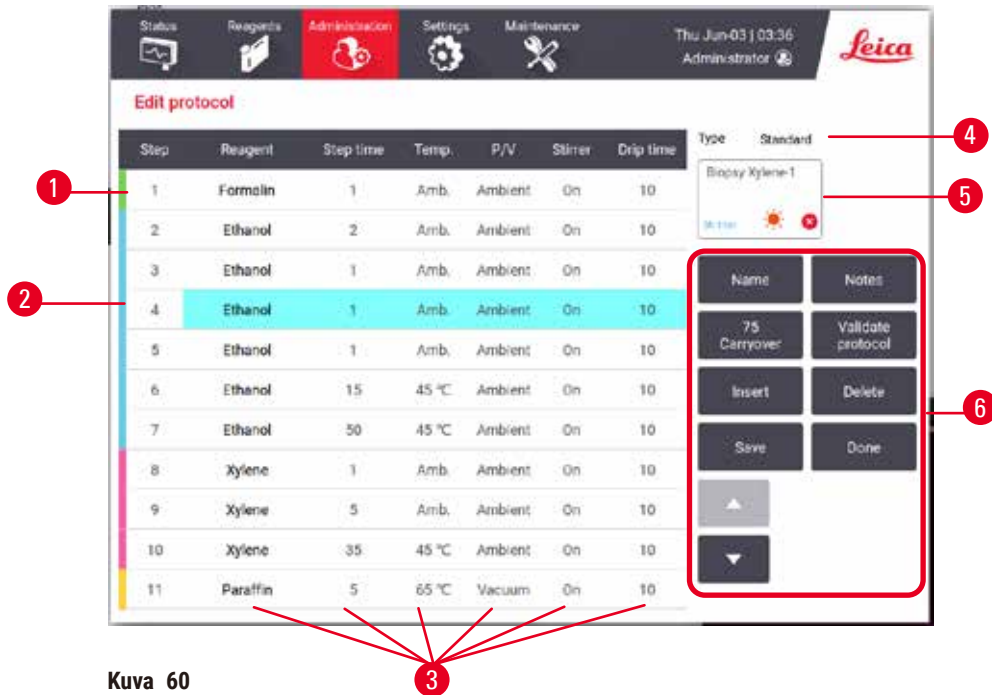

Kuva 60

1. Jokainen rivi edustaa protokollan vaihetta.
2. Valitse vaihe napauttamalla vaiheen numeroa.
3. Vaiheen taulukon solut osoittavat kunkin vaiheen asetukset. Avaa valintaikkuna ja muuta asetuksia napauttamalla solua.
4. Protokollan tyyppi (ei muutettavissa).
5. Protokollan kuvake: päivitytty, kun protokollaa muokataan.
6. Protokollan määrittämissä painikkeet.

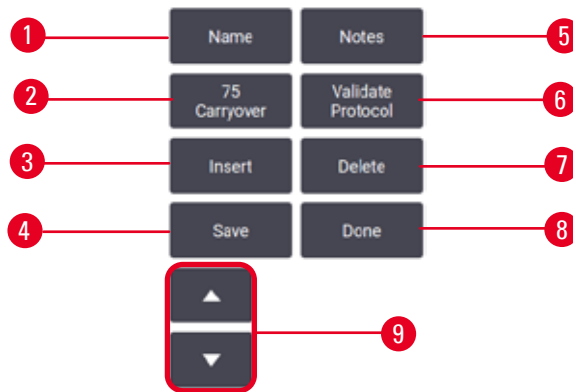

Kuva 61

1. **Name (Nimi):** muuta protokollan nimeä
2. **Carryover (Siirtymä):** aseta siirtymäarvo
3. **Insert (Lisää):** lisää vaihe ennen valittua vaihetta
4. **Save (Tallenna):** tallenna protokollan muutokset
5. **Notes (Huomiot):** syötä protokollan kuvaus tai muita huomioita
6. **Validate (Validoi)/Invalidate (Mitätöi)** protokolla: aseta protokolla validoiduksi tai mitätöidyksi
7. **Delete (Poista):** poista valittu vaihe protokollasta
8. **Done (Valmis):** vahvista protokollan muutokset ja palaa **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytölle
9. Siirry edelliselle/seuraavalle riville

Vaiheita voidaan lisätä ja poistaa ja vaiheen tietoja (esim. vaiheen aikaa, lämpötilaa jne.) voidaan muuttaa. Protokollan nimi, huomiot, siirtymäasetukset ja validointitila ovat myös muutettavissa. Protokollan tyyppiä tai reagenssin valintamenetelmää ei kuitenkaan voi muuttaa eikä puhdistusprotokollan kuivausvaihetta voi poistaa.


Oletusarvoisesti muokatut protokollat eivät ole validoituja protokollia. Käyttäjän on validoitava ne ennen kliinistä käyttöä. Validoinnin jälkeen esihenkilö voi palata **Edit protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytölle ja napauttaa **Validate protocol (Validoi protokolla)** -painiketta. Sen jälkeen protokolla on operaattorien käytettävissä.

### Reagenssien valinta

Reagenssia voi muuttaa napauttamalla nykyistä reagenssia **Reagent (Reagenssi)**-sarakeessa **Edit protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytöllä. Avautuva valintaikkuna riippuu reagenssin valintamenetelmästä.

Vain reagenssit, jotka ovat yhteensopivia edellisen protokollavaiheen kanssa (protokollan tyyppin mukaan), näytetään. Asemaperusteisista protokollista voidaan piilottaa asemat, jotka on jo valittu. Jos valitset yhteensopimattoman tai piilotetun reagenssin, se lisätään protokollataulukkuun asteriskin kera, mikä osoittaa, ettei se ole sallittu. Protokollaa ei voi ladata tai suorittaa.

### Reagenssityypin valinta

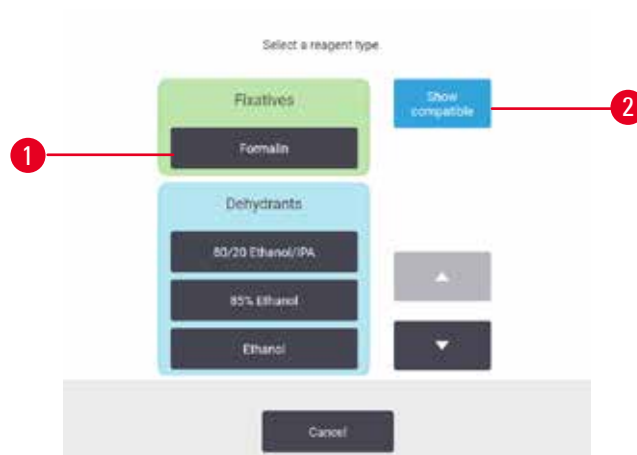


Kuva 62

1. Reagenssityyppi
2. **Show compatible (Näytä yhteensopivat)** / **Show all (Näytä kaikki)**: näytää vain yhteensopivat reagenssiryhmät / näytää kaikki reagenssiryhmät

Jos protokolla perustuu reagenssityypeille, laitteelle määritetyt reagenssit ryhmitellään tyyppin mukaan. Voit valita tietyn tyyppin.



Aseman reagenssin valinta

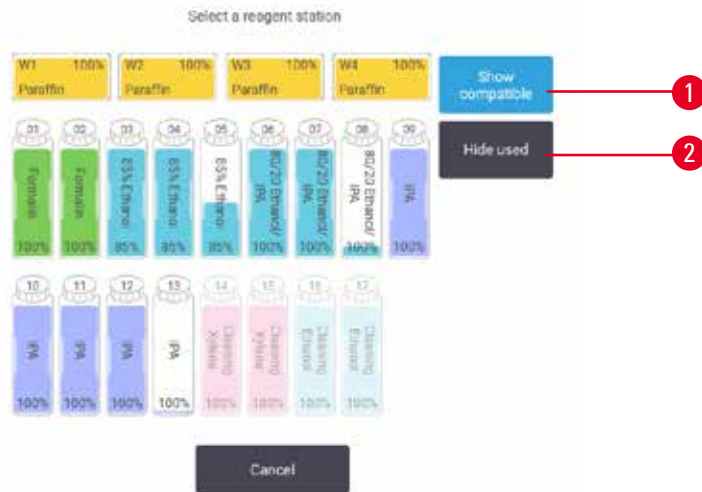

Kuva 63

1. **Show compatible (Näytä yhteensopivat) / Show all (Näytä kaikki):** näytä vain yhteensopivat asemat saatavilla / näytä yhteensopimattomat asemat saatavilla
2. **Hide used (Piilota käytetyt):** piilota asemat, jotka on jo valittu ei saatavilla oleviksi

Jos protokolla perustuu asemiin, näet kaikki asemat, jotka laitteelle on määritetty. Valittavana olevat pullot näkyvät 3D-piirroksina korkkeineen ja kahvoineen. Pullot, jotka eivät ole saatavilla, koska ne ovat jo käytössä tai ne eivät ole yhteensopivia, näkyvät harmaana. Parafiiniasemat on samoin piirretty korostettuina kuvakkeina (saatavilla) tai harmaina kuvakkeina (ei saatavilla). Valitse asemat protokollaa varten.

Protokollan poistaminen

Vain esihenkilöt voivat poistaa protokollia.

Protokolla poistetaan valitsemalla sen kuvake **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöllä ja napauttamalla **Delete (Poista)**.

Ennalta määritettyjä protokollia ei voi poistaa. Muita protokollia ei voi noutaa, ellei niitä ole kopioitu ulkoiselle laitteelle. Tällöin protokollat voi tuoda tiedoston siirtotoiminnon avulla.

**6.2.3 Uusien protokollien luominen**

Vain esihenkilöt voivat luoda uusia protokollia.

Uusia protokollia voi luoda alusta alkaen tai kopioimalla tai muokkaamalla olemassa olevaa protokollaa (ennalta määritettyä tai muuta). Varmista, että valitset aluksi oikean protokollatyyppin ja reagenssin valintamenetelmän (tai kopioit protokollan, joka on oikean tyyppinen ja jossa on oikea reagenssin valintamenetelmä), koska näitä asetuksia ei voi muuttaa sen jälkeen, kun uuden protokollan määrittäminen on aloitettu.

**Varoitus**

Käyttäjän määrittämiä protokollia ei ole validoitu.

**Näytteiden vauriot**

- Ennakkoon määritetyt protokollat ja mukautetut protokollat on validoitava käyttäjän toimesta ennen protokollan ajamista, eli potilaan kudosten käsittelyä diagnostiikkaa varten, paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.

Uusien protokollien luominen alusta alkaen

1. Avaa **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näyttö (**Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)**) ja napauta **New (Uusi)**.
2. Valitse protokollan tyyppi (→ s. 88 – 6.1.1 Protokollatyyppit).
3. Syötä protokollalle nimi.
4. Valitse reagenssin valintamenetelmä (→ s. 89 – 6.1.2 Reagenssien valintatapa). Sarja valintaikkunoita ohjaa sinut luomisen ensimmäisen vaiheen läpi.
5. Lisää seuraava vaihe napauttamalla protokollataulukon seuraavaa riviä. Sinua pyydetään antamaan reagenssi ja vaiheen aika. Muut vaiheen ominaisuudet (paine, sekoitin jne.) kopioidaan edellisestä vaiheesta. Voit muuttaa niitä napauttamalla kyseistä ruutua.
  - » Käytä porrastettua etanolia formaliinivaiheen jälkeen. 100-prosenttisen etanolin käyttäminen heti formaliinivaiheen jälkeen voi johtaa suoloittumiseen. Puhdistusprotokollissa on automaattisesti lopussa kuivausvaihe. Tätä vaihetta ei voi muokata.
6. Lisää vaiheita tarpeen mukaan.
7. Halutessasi voit muokata protokollan nimeä napauttamalla **Name (Nimi)**-painiketta.
8. Halutessasi voit lisätä protokollaan liittyviä tietoja napauttamalla **Notes (Huomautukset)**-painiketta.
9. Napauta **Carryover (Siirtymä)**-painiketta ja aseta siirtymäarvo (→ s. 91 – 6.1.5 Siirtymäasetus).
10. Tallenna protokolla napauttamalla **Save (Tallenna)**-painiketta.
11. Napauta **Done (Valmis)**-painiketta, kun olet valmis.
12. Esiin tulee varoitusikkuna, jossa näkyvät toimenpiteet, joita edellytetään tai suositellaan ennen kuin protokollaa voidaan käyttää (→ Kuva 64). Yksi luettelon varoitus on aina se, että protokollaa ei ole validoitu käyttöön. Oletusarvoisesti juuri luotu protokolla ei ole validoitu protokolla. Laboratorion on validoitava se ennen kliinistä käyttöä. Validoinnin jälkeen esihenkilö voi siirtyä **Edit Protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytölle ja napauttaa **Validate protocol (Validoi protokolla)** -painiketta. Sen jälkeen protokolla on operaattorien käytettävissä (jos muut ikkunassa luetellut virheet on myös käsitelty).



Kuva 64

- ✓ Uusi protokolla näkyy nyt protokollan valintaluettelossa.

Tietoa uuden puhdistusprotokollan luomisesta on kohdassa Puhdistusprotokollat (→ s. 66 – 5.3 Puhdistusprotokollat).

### Protokollien kopioiminen

Esihenkilöt voivat kopioida minkä tahansa **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöllä näkyvän protokollan ja luoda sen pohjalta uuden.

1. Napauta **Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)** ja tee sitten **Protocol selection (Protokollan valinta)** -näytöllä jompikumpi seuraavista:
  - A. valitse kopioitava protokolla ja napauta **Copy (Kopioi)**
  - B. napauta **New (Uusi) > Pre-defined (Ennalta määritetty)** -kuvaketta ja valitse ennalta määritetty protokolla kopioitavaksi.
2. Syötä protokollalle uusi nimi.
3. Näytölle ilmaantuu varoitus siitä, että uutta protokollaa ei ole vielä validoitu käyttöön. Sulje varoitus napauttamalla **OK. Edit protocol (Muokkaa protokollaa)** -näyttö avautuu ja siinä näkyvät kopioidun protokollan tiedot.
4. Muokkaa protokollaa (→ s. 94 – 6.2.2 Protokollien muokkaaminen). Puhdistusprotokollien viimeistä kuivausvaihetta ei voi muokata.
5. Tallenna protokolla napauttamalla **Save (Tallenna)**-painiketta.
6. Napauta **Done (Valmis)**-painiketta, kun olet valmis.
7. Esiin tulee varoitusikkuna (→ Kuva 64), jossa näkyvät toimenpiteet, joita edellytetään tai suositellaan ennen kuin protokollaa voidaan käyttää. Yksi luettelon varoitus on aina se, että protokollaa ei ole validoitu käyttöön. Oletusarvoisesti juuri luotu protokolla ei ole validoitu protokolla. Laboratorion on validoitava se ennen kliinistä käyttöä. Validoinnin jälkeen esihenkilö voi siirtyä **Edit Protocol (Muokkaa protokollaa)** -näytölle ja napauttaa **Validate protocol (Validoi protokolla)** -painiketta. Sen jälkeen protokolla on operaattorien käytettävissä (jos muut ikkunassa luetellut virheet on myös käsitelty).

- ✓ Uusi protokolla näkyy nyt protokollan valintaluettelossa.

**6.2.4 Protokollien tarkastelu**

Operaattoritason käyttäjät eivät voi luoda tai muokata protokollia. He voivat kuitenkin tarkastella protokollan tietoja (mm. vaiheen tietoja, huomioita ja protokollan viimeisimmän muutoksen päivää ja aikaa).

1. Napauta **Administration (Hallinnointi) > Protocols (Protokollat)**.
2. Napauta protokollaa, jota haluat tarkastella.
3. Napauta **View (Tarkastele)**.

## 7. Reagenssin määrittäminen

### 7.1 Yleiskatsaus

Oikean reagenssin käyttäminen oikeaan aikaan ja oikeassa koostumuksessa on erittäin tärkeää kudosten korkealaatuisen käsittelyn takaamiseksi. Järjestelmässä on edistynyt reagenssinhallintajärjestelmä (RMS), joka auttaa varmistamaan tasalaatuisen käsittelyn ja antaa joustavuutta työnkulkuun.

#### 7.1.1 Reagenssiryhmät, -tyypit ja -asemat

Järjestelmä hallinnoi reagensseja ryhmien, tyyppien ja asemien mukaan.

##### Ryhmät

Ryhmät määrittävät reagenssin funktion. Esimerkiksi fiksatiivireagenssiryhmä sisältää kaikki reagenssit, joita voidaan käyttää fiksatiiveina.

Tehtaalla määritettyjä ryhmiä on 10. Jokaisella ryhmällä on oma väri, jota käytetään kaikkialla ohjelmistossa, pullojen etiketeissä ja korkeissa. Alla olevassa taulukossa luetellaan ryhmät, niiden funktiot ja värit.

**Taulukko 7.1: Reagenssiryhmät ja -värit**

Ryhmä	Toiminto	Väri
Fiksatiivit	Kudoksen säilöntäaine	Vihreä
Vedenpoistoaineet	Veden poistaminen kudoksesta	Sininen
IPA	Veden poistaminen kudoksesta	Vaaleanvioletti
Rasvanpoistaja	Rasvakertymien poistaminen kudoksesta	Keltainen
Rasvanpoiston jälkeinen	Rasvanpoiston jälkeen käytettävä vedenpoistoaine	Violetti
Kirkastajat	Vedenpoistoaineiden poistaminen kudoksesta	Vaaleanpunainen
Parafiini	Kiinnitysaine	Oranssi
Prosessivesi	Fiksatiivien poistaminen kudoksesta	Taivaansininen
Puhdistusliuotin	Ensimmäinen puhdistusreagenssi	Vaalea pinkki
Puhdistusetanoli	Toinen puhdistusreagenssi	Vaaleansininen

Reagenssin yhteensopivuus protokollan suorittamiseen perustuu sen ryhmään ([→ s. 109 – 7.1.6 Reagenssien yhteensopivuus](#)).

##### Tyypit

Reagenssityypit ovat tiettyjä reagensseja kussakin ryhmässä, esimerkiksi formaliini, ksyleeni tai Waxsol. Kemiallisen koostumuksen lisäksi reagenssityypin määritelmät voivat sisältää pitoisuuksia. Esimerkiksi "70-prosenttinen etanoli" ja "80-prosenttinen etanoli" ovat reagenssityyppejä (ja ne on määritelty tässä järjestelmässä).

Reagenssityypeillä on seuraavat ominaisuudet:

- yksilöllinen nimi
- oletuspitoisuus: tuoreen reagenssin pitoisuus
- puhtausraja-arvo: heikentyneen reagenssin vaihtamisen varmistamiseksi (→ s. 104 – 7.1.3 Raja-arvot)
- lämpötilaraja-arvot: käsittelyn laadun ja reagenssin turvallisen käsittelyn varmistamiseksi (→ s. 104 – 7.1.3 Raja-arvot)

Järjestelmä sisältää useita ennalta määritettyjä reagenssityyppejä. Ne riittävät useimmille laboratorioille. Voit kuitenkin luoda omia reagenssityyppejä tarvittaessa. Napauta **Reagents (Reagenssit) > Reagent types (Reagenssityypit)** ja määrittele ja muokkaa reagenssityyppejä (→ s. 110 – 7.2 Reagenssityyppien hallinta).



#### Huomaa

- Reagenssityyppien nimet eivät vaikuta reagenssin pitoisuuksiin. Jos esimerkiksi osoitetaan asemalle reagenssityyppi nimeltä "etanoli 70 %", alkuperäinen pitoisuusarvo on tyyppin oletusarvo (luultavasti 70 %), mutta voit asettaa alkuperäisen pitoisuuden mihin tahansa välille 0–100 %.

#### Asemat

Järjestelmässä on 21 reagenssiasemaa: 17 reagenssipulloa ja 4 parafiiniallasta.

Jokaisella asemalla on seuraavat ominaisuudet:

- aseman sisältämä reagenssityyppi
- reagenssinhallintajärjestelmän laskema aseman sisältämän reagenssin pitoisuus
- aseman käyttöhistoria eli
  - A. asemassa reagenssin kanssa käytettyjen kasettien lukumäärä
  - B. asemassa reagenssin kanssa suoritettujen käyttökertojen (eli syklien) lukumäärä
  - C. reagenssin asemassa olleiden päivien lukumäärä
- aseman nimi, joka voi olla
  - A. **Dry (Kuiva)**: asema on kokonaan tyhjennetty ja siinä on vain pieni määrä jäännösmateriaalia. Se voidaan täyttää millä tahansa yhteensopivalla reagenssilla.
  - B. **Empty (Tyhjä)**: reagenssi on poistettu asemasta tislauksastian täyttämiseksi. Tislauksastian täyttämisestä yli jäänyt reagenssi on edelleen asemassa.
  - C. **In use (Käytössä)**: reagenssin siirtäminen on kesken tai keskeytetty.
  - D. **Full (Täynnä)**: asemassa on riittävästi reagenssia tislauksastian täyttämiseen.
  - E. **Not molten (Ei sulaa)**: koskee vain parafiinisäiliöitä, asetus kiinteän parafiinin lisäämistä varten (→ s. 126 – 7.4.5 Parafiinin vaihtaminen).
- koskee vain parafiinialtaita: parafiinialtaan tämänhetkinen lämpötila.

Kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat)** voit määrittellä reagenssiasemia ja valvoa niiden historiaa ja pitoisuuksia (→ s. 115 – 7.3 Reagenssiasemien hallinta).

### 7.1.2 Pitoisuuksien hallinta

Järjestelmän tuottama korkealaatuinen kudosten käsittely on suurelta osin sen ansiota, että reagenssien pitoisuuksia valvotaan tarkasti jokaisessa asemassa.

#### Pitoisuus järjestelmässä

Pitoisuus on reagenssin sisältämä osuus siitä ryhmästä, johon reagenssi on määritelty. Seuraavat esimerkit osoittavat, miten pitoisuus määritellään.

- Vedenpoistoaineen, josta 80 % on etanolia (vedenpoistoaine) ja 20 % vettä (ei vedenpoistoaine), pitoisuus on 80 %.
- Vedenpoistoaineen, josta 80 % on etanolia (vedenpoistoaine) ja 20 % IPA:ta (myös vedenpoistoaine), pitoisuus on 100 %.
- Puhtaan etanolin (100 % vedenpoistoaine), joka on kontaminoitunut puhtaan IMS:n (100 % vedenpoistoaine) siirtymällä, pitoisuus on 100 %, koska sekä alkuperäinen reagenssi että kontaminantti ovat vedenpoistoaineita.
- Uuden ksyleenin (100 % kirkastaja), joka on kontaminoitunut puhtaan etanolin (100 % vedenpoistoaine) siirtymällä, pitoisuus on alentunut (yleensä noin 94 % yhden syklin jälkeen), koska se koostuu 94-prosenttisesti ksyleenistä (kirkastaja) ja 6-prosenttisesti etanolista (ei kirkastaja).

Reagenssin, jota käytetään saman ryhmän jakson aikaisessa vaiheessa, pitoisuus laskee nopeasti, sillä suurin osa sen saamasta kontaminaatiosta on peräisin edellisestä ryhmästä. Reagenssin, jota käytetään saman ryhmän jakson myöhemmässä vaiheessa, pitoisuus laskee hitaammin, sillä suurin osa sen saamasta kontaminaatiosta on peräisin samasta ryhmästä.

#### Pitoisuuksien hallinta

Ohjelmisto käyttää reagenssipitoisuuksia asemien valitsemiseen, kun protokollia suoritetaan (paitsi jos protokolla käyttää asema-reagenssi-valintaa). Se valitsee aseman, jossa on matalin raja-arvojen sisällä oleva pitoisuus reagenssiryhmää tai -tyyppiä, kyseistä ryhmää tai tyyppiä käyttävään ensimmäiseen vaiheeseen ja sen jälkeen seuraaviin vaiheisiin asemia nousevassa pitoisuusjärjestyksessä. Se käyttää aina suurimman pitoisuuden reagenssin viimeiseen vaiheeseen ennen kuin vaihtaa toiseen reagenssiryhmään tai -tyyppiin. Ohjelmisto käyttää pitoisuustietoja (muiden tekijöiden lisäksi) lisäksi huomauttaakseen, että on aika vaihtaa reagenssit, jotka ovat ylittäneet puhtausraja-arvot.

Korkealaatuisen käsittelyn ja tehokkaan reagenssien käytön kannalta on erittäin tärkeää, että ohjelmiston käyttämät pitoisuustiedot ovat tarkkoja. Ohjelmisto seuraa automaattisesti reagenssipitoisuuksia jokaisessa asemassa ja päivittää arvot jokaisen käyttökerran jälkeen. Jotta se voi suorittaa työn tehokkaasti, tiedot on annettava tarkasti. On esimerkiksi asetettava realistiset protokollan siirtymäarvot ja syötettävä jokaiselle käyttökerralle oikea määrä kasetteja. Ohjelmisto on myös päivitettävä tarkasti aina, kun reagensseja vaihdetaan.

Ohjelmisto määrittää pitoisuuden oletusarvoisesti "laskelmien perusteella". Tässä menetelmässä käytetään käsiteltyjen kasettien määrää, siirtymäasetusta ja mukana olevia reagenssiryhmiä laskemaan kunkin aseman pitoisuus.

Tasalaatuisen käsittelyn varmistamiseksi reagenssit on aina vaihdettava heti kun ohjelmisto kehottaa siihen ja korvattava ne tuoreella, oletuspitoisuuden sisältävällä reagenssilla. Jos poistat laitteesta pullon, tarkista aina, että annat pullosta oikeat reagenssitiedot, kun palautat sen. Esihenkilöt voivat muuttaa aseman pitoisuusarvoja manuaalisesti **Reagent (Reagenssi) > Stations (Asemat)** -näytöllä, jos arvot ovat väärin. Varmista, että pitoisuus vahvistetaan tällöin erikseen.

#### Pitoisuuden automaattinen tarkistus

Järjestelmässä on kaksi tiheysmittaria, yksi kullekin tislauksastialle. Mittarit mittaavat tiettyjen reagenssien pitoisuuksia, jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa 7.2, kun niitä käytetään käsittelyssä ensimmäisen kerran jommankumman alla olevan ehdon täytyessä:

- reagenssi on korvattu
- esihenkilö on muuttanut kyseisen reagenssin tallennettua pitoisuutta

Jos mitattu pitoisuus ei vastaa kyseiselle pullolle tallennettua pitoisuusarvoa **Reagent Stations (Reagenssi asemat)**-näytöllä, pullo lukitaan (ja sen kuvakkeen kohdalle lisätään varoitusmerkki **Status (Tila)**-näytöllä). Lukittu pullo ohitetaan kaikilla seuraavilla käyttökerroilla (olettaen, että käyttöä voidaan jatkaa ilman lukittua pulloa).



#### Huomaa

- Tiheysmittarit tarkistavat vain etanoli- (mukaan lukien reagenssitason etanoli ja IPA–etanoli-seokset), IPA- ja ksyleenireagenssit. Fiksatiiveja, puhdistusreagensseja ja reagenssin korvikkeita (esim. Histolenea) ei tarkisteta. Taulukossa 7.2 luetellaan tarkistettavat reagenssit. Mitään muita reagensseja, mukaan lukien itse luotuja, ei tarkisteta.

#### Taulukko 7.2: Luettelo tiheysmittarien tarkistamista reagensseista

- |                           |                           |                       |                          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| • 50-prosenttinen etanoli | • 95-prosenttinen etanoli | • 70-prosenttinen IMS | • Isopropanoli           |
| • 70-prosenttinen etanoli | • Absoluuttinen etanoli   | • 80-prosenttinen IMS | • IPA                    |
| • 80-prosenttinen etanoli | • 80/20 etanoli/IPA       | • 90-prosenttinen IMS | • 50/50 etanoli/ksyleeni |
| • 85-prosenttinen etanoli | • Etanoli                 | • 95-prosenttinen IMS | • Ksyleeni               |
| • 90-prosenttinen etanoli | • 50-prosenttinen IMS     | • Absoluuttinen IMS   |                          |

#### 7.1.3 Raja-arvot

Jokaisella reagenssityypillä on useita raja-arvoja. Ne on suunniteltu varmistamaan käsittelyn laatu ja käyttäjäturvallisuus. Esihenkilöt voivat määrittää raja-arvot kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Reagent types (Reagenssityypit)**.

Oletusraja-arvot ennalta määritetyille reagenssityypeille ovat yleensä riittävät useimmille laboratorioille, mutta vaihtoehtoiset asetukset saattavat sopia paremmin joillekin laboratorioille. Kysy neuvoa asiakastuesta ennen raja-arvojen muuttamista. Validoi kaikki raja-arvojen muutokset laboratorion käytäntöjen mukaisesti.



Raja-arvot voidaan jakaa kahteen luokkaan:

- Puhtausraja-arvot: nämä asettavat reagensseille käyttörajat puhtauden mukaan.
- Lämpötilaraja-arvot: nämä asettavat rajoituksia tislauksastian lämpötilan mukaan.

#### Puhtausraja-arvot

Järjestelmä käyttää puhtausraja-arvoja reagenssin käytön rajoittamiseen, kun reagenssi kontaminoituu muista ryhmistä peräisin olevilla reagenssijäämillä.

Kun raja-arvo lähestyy tai ylittyy, ohjelmisto kehottaa vaihtamaan reagenssin. Oletusasetuksissa voit käyttää asemaa, jonka reagenssi on ylittänyt raja-arvot vielä kerran kehotuksen jälkeen. Sen jälkeen asema lukittuu (eli sitä ei voi käyttää ennen kuin tuore reagenssi on ladattu).

Reagenssin puhtaus tarkistetaan yhdellä tai useammalla alla olevalla menetelmällä:

- reagenssin pitoisuus
- reagenssin kanssa käytettyjen kasettien lukumäärä
- reagenssin kanssa suoritettujen käsittelysyklien määrä
- reagenssin laitteessa viettämien päivien lukumäärä

Kaikki menetelmät ovat oletusarvoisesti määriteltävissä yksittäisten reagenssityyppien mukaan (minkä voi tehdä **Reagent types (Reagenssityypit)**-näytöllä). **Reagent threshold check (Reagenssin raja-arvotarkistus)** -osio **Settings (Asetukset) > Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytöllä osoittaa järjestelmän käytettävissä olevat menetelmät (→ [Kuva 65](#)).



**Kuva 65**

Vain asiakastuen edustajat voivat muuttaa näitä tarkistusmenetelmien asetuksia.

Tarkistusmenetelmät on suunniteltu valvomaan kolmenlaisia puhtausraja-arvoja:

- reagenssin lähestyvän vaihtamisen raja-arvot
- reagenssin vaihtamisen raja-arvot
- lopulliset reagenssin raja-arvot.

Ne on selitetty alla.

Laitteen tiheysmittarit suorittavat lisäksi pitoisuuspuhtauden tarkistuksia. Tämä on selitetty kohdassa (→ [s. 104 – Pitoisuuden automaattinen tarkistus](#)).

### Reagenssin lähestyvän vaihtamisen raja-arvot

Asemien, joiden reagenssi lähestyy vaihtamisen raja-arvoa, ohessa näkyy varoitusmerkki **Status (Tila)**-näytöllä. Napauttamalla varoitusmerkkiä pullon yläpuolelle ilmestyy sitä koskeva viesti, joka kehottaa valmistelemaan reagenssin etukäteen.

### Reagenssin vaihtamisen raja-arvot

Asemien, joiden reagenssi on ylittänyt vaihtamisen raja-arvon, ohessa näkyy raidallinen kuvake **Status (Tila)**-näytöllä.

Järjestelmä ei käytä vaihtamisen raja-arvojen ulkopuolella olevia asemia, paitsi jos muita asemia ei ole käytettävissä. Jos muita asemia ei ole käytettävissä, vaihtamisen raja-arvojen ulkopuolella olevia asemia käytetään vielä yhden kerran ennen niiden lukitsemista. Lukittuja asemia ei voi käyttää ennen kuin reagenssi on vaihdettu. Järjestelmä ei salli sellaisten protokollien lataamista, joihin tarvitaan lukittua asemaa.

### Lopulliset reagenssin raja-arvot

Lopulliset reagenssin raja-arvot asettavat reagenssin puhtaudelle rajat, joiden jälkeen protokollasyklissä vaihdetaan välittömästi toiseen reagenssiryhmään (tai -tyyppiin niissä protokollissa, jotka on määritetty tyyppin mukaan).

Lopulliset reagenssin raja-arvot ovat korkeammat kuin vaihtamisen raja-arvot. Näin varmistetaan minimikontaminaatio edeltävästä reagenssiryhmästä seuraavaan reagenssiryhmään.

Kun reagenssityyppi tai -ryhmä ylittää lopulliset reagenssin raja-arvot (eli kun yksikään kyseisen tyyppin tai ryhmän pullo ei ole lopullisen reagenssin raja-arvon kohdalla tai sen yläpuolella), kyseisen tyyppin tai ryhmän vähiten puhtaan pullon kohdalle ilmestyy oranssin vinoneliön sisällä oleva varoitusmerkki. Lisäksi pullon yläpuolelle ilmestyy viesti.

Jos suljet viestin, voit avata sen uudelleen napauttamalla pullokuvakkeen kohdalla olevaa varoitusmerkkiä.

Kun seuraava sykli alkaa, näkyviin tulee viesti, joka kertoo, että tämä on viimeinen mahdollinen sykli ilman lopullisen raja-arvonsa alapuolella olevan reagenssin vaihtamista.

Voit jatkaa sykliä napauttamalla **OK**. Punaisen kolmion sisällä oleva varoitusmerkki tulee näkyviin pullokuvakkeen kohdalle **Status (Tila)**-näytöllä.

Napauttamalla varoitusmerkkiä pullon yläpuolelle ilmestyy sitä koskeva viesti:

Jos yrität suorittaa toisen protokollan, joka käyttää kyseistä reagenssityyppiä, näkyviin tulee viesti joka kertoo, ettei suorittaminen ole mahdollista ennen kuin reagenssi on vaihdettu.

Toisinaan näkyviin saattaa tulla raidallinen pullo, jonka ohessa on oranssin vinoneliön sisällä oleva varoitusmerkki. Näin tapahtuu silloin, kun sekä lopullinen että vaihtamisen raja-arvo on saavutettu, joten vaihdettava pullo on sekä vähiten puhdas (lopullinen vaihtamisen raja-arvo) että reagenssin vaihtamisen raja-arvon alapuolella.

Huom: Kun saat varoituksen, että reagenssi on ylittänyt lopullisen raja-arvon, vaihda kyseisen reagenssityypin vähiten puhdas pullo. Lopullisen raja-arvon ylittäneessä pullossa, joka laukaisi varoituksen, on edelleen suhteellisen suuren pitoisuuden omaavaa reagenssia. Se hyväksytään edelleen protokollajakson viimeistä edeltävissä vaiheissa, joten sen vaihtaminen on tehotonta.

### Lämpötilaraja-arvot

Kullekin reagenssityypille on kolme lämpötilaraja-arvoa:

- **Ambient (ympäristö)** – korkein sallittu lämpötila tislauksastiassa olevalle reagenssille ympäröivän (ja korkean) paineen mukaan (perustuu reagenssin kiehumispisteeseen)
- **Vacuum (tyhjiö)** – korkein sallittu lämpötila tislauksastiassa olevalle reagenssille, kun tislauksastia tyhjenetään (perustuu reagenssin kiehumispisteeseen)
- **Safe (turvallinen)** – korkein lämpötila, jossa reagenssia sisältävän tislauksastian avaaminen on turvallista.

Et välttämättä voi luoda protokollia, joissa reagenssit asetetaan niiden ympäristö- tai tyhjiölämpötilan raja-arvot ylittäviin olosuhteisiin. Lisäksi ohjelmisto varoittaa, jos tislauksastia on avattava ja se sisältää reagenssia, jonka lämpötila ylittää sen turvallisen lämpötilaraja-arvon.



#### Varoitus

Virheellisesti asetettu reagenssin lämpötilaraja-arvo ylittää kiehumispisteen.

**Henkilövamma / näytteen vaurio / ympäristön kontaminaatio käsittelyn aikana aiheutuvien liiallisten höyryjen takia.**

- Ole äärimmäisen varovainen, jos vaihdat reagenssin lämpötilaraja-arvoa. Korkeammat raja-arvot voivat aiheuttaa reagenssien kiehumista. Kiehuvat reagenssit vapauttavat suuria höyrymääriä, jotka voivat ylikuormittaa sisäistä aktiivihillisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää (jos asennettu). Kiehuvat reagenssit aiheuttavat todennäköisesti myös liiallista painetta instrumentin sisällä sekä reagenssien kontaminaatiota ja reagenssien ylivuotoja. Reagenssien kiehumispisteet ovat matalampia, kun tislauksastiaa käytetään tyhjiössä tai paine-/tyhjiökierrossa.
- Älä käytä instrumenttia ilman aktiivihillisuodatinta tai ulkoista poistojärjestelmää. Vaikka instrumentti olisikin yhdistetty ulkoiseen poistojärjestelmään, toimitettua aktiivihillisuodatinta on silti käytettävä.

#### 7.1.4 Suositellut reagenssit



#### Varoitus

Muiden kuin suositeltujen reagenssien käyttö

**Henkilövamma – Jotkin myrkylliset/syttyvät reagenssit voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.**

**Viivästynyt diagnoosi – Instrumentin osat voivat vaurioitua syövyttävien reagenssien takia.**

- Käytä laitteessa vain alla mainittuja reagensseja.
- Älä käytä pikriinihappoa sisältäviä kiinnitysaineita, sillä pikriinihappo on kuivana räjähdysherkkää.
- Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja sisältäviä reagensseja, kuten elohopeasuoloja, pikriinihappoa, typpihappoa tai suolahappoa.
- Älä käytä asetonia tai muita ketoneja. Ne vahingoittavat instrumentin venttiilejä.

Vaikka jokainen laboratorio on vastuussa valitsemistaan reagensseista ja parafiineista, muiden kuin tälle järjestelmälle suositeltujen reagenssien käyttäminen voi huonontaa käsittelyn laatua tai vaarantaa laitteiden luotettavuuden. Alla olevien ohjeiden noudattaminen varmistaa kudosten korkealaatuisen käsittelyn.

Laboratorion on validoitava muiden reagenssien käyttäminen paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.

Parhaiden tulosten saaminen edellyttää kudoksenäytteiden riittävää kiinnitystä. Tämä on tehtävä ennen näytteiden syöttämistä järjestelmään tai protokollan fiksatiivivaiheisiin.

Seuraavat reagenssit on validoitu järjestelmän käytettäväksi.

### Fiksatiivit

- 10-prosenttinen formaliini (puskuroitu ja puskuroimaton)
- formaliinietanoli (70 % etanolia ja 30 % formaliinia)

### Vedenpoisto

- 100-prosenttinen etanoli
- reagenssilaatua oleva etanoli, jota suositellaan histologiseen käyttöön
- vedellä laimennettu etanoli (deionisoitu tai tislattu)
- 99-prosenttinen etanoli (denaturoitu)
- 99-prosenttinen isopropanoli (käytetään myös välittäjäaineena)
- vedellä laimennettu isopropanoli
- < 50-prosenttinen metanoli

### Kirkastaminen

- alifaattiset hiilivedyt (joita suositellaan histologiseen käyttöön)
- Isopropanoli
- D-limoneeni (jota suositellaan histologiseen käyttöön)
- ParaLast™
- Sub-X
- tolueni
- Ksyleeni

### Imeytyminen

- Histologiseen käyttöön tarkoitetut parafiinipelletit tai sulatettu parafiini, jonka sulamispiste on 56 °C - 58 °C.
- Surgipath-imeytysparafiinit
- Surgipath-parafiini, jonka sulamispiste on 60 °C

## Puhdistusreagenssit

- Etanoli
- reagenssilaatua oleva etanoli, joka sopii histologiseen käyttöön
- reagenssilaatua oleva etanoli, joka sopii histologiseen käyttöön
- Isopropanoli
- limoneeni
- SubX
- tolueneeni
- Ksyleeni
- Waxsol
- vesi (tislattu ja deionisoitu)

### 7.1.5 Reagenssit, joita ei suositella

Seuraavia reagensseja ei suositella käytettäväksi järjestelmässä. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa laitteille tai kudoksille.

- asetoni
- kloroformi
- fiksaatiivit, jotka sisältävät pikriinihappoa
- histologiset parafiinit, jotka sisältävät dimetyylisulfoksidia (DMSO), esimerkiksi Paraplast Plus®
- sinkkikloridi

### 7.1.6 Reagenssien yhteensopivuus

Kudosten käsittely edellyttää yhteensopimattomien reagenssien käyttöä. Ohjelmisto pitää huolen siitä, että vain yhteensopivat reagenssit pääsevät sekoittumaan. Reagenssien sekoittumista tapahtuu yleensä silloin, kun reagenssia pääsee tislaukastiin sen tilan ollessa Tyhjä (eli se sisältää jäännösmääriä edellisestä reagenssista). Tämä voi tapahtua osana protokollaa, manuaalisten toimintojen aikana tai etä-, täyttö- ja tyhjennystoimenpiteiden aikana.

Protokollaa ei voi suorittaa, jos ensimmäinen reagenssi ei sovi yhteen tislaukastian jäännösten kanssa. Protokollan voi kuitenkin ladata yhteensopimattomalla ensimmäisellä vaiheella ja sitten muokata sitä niin, että ensimmäinen käytettävä reagenssi sopii yhteen tislaukastian jäännösten kanssa ([→ s. 80 – 5.5.2 Aloitusvaiheen muuttaminen yksittäisen ajon kohdalla](#)).

Ohjelmisto myös estää sekoittamasta yhteensopimattomia reagensseja etätäyttö- ja etätyhjennystoimenpiteiden aikana.

Reagenssien yhteensopivuus vaihtelee suoritettavan toiminnan tai protokollan mukaan. Tarkista reagenssien yhteensopivuus reagenssitaulukoista ([→ s. 167 – 10.5 Reagenssien yhteensopivuustaulukot](#)) ennen kuin luot protokollia, suoritat manuaalisia toimintoja tai aloitat etätäyttö- tai etätyhjennystoimenpiteitä.

## 7.2 Reagenssityyppien hallinta

Ohjelmisto käyttää kahta reagenssityyppien luetteloa: aktiivista luetteloa (eli käytettäviä reagensseja) ja passiivista luetteloa (eli kaikkia muita järjestelmään määritettyjä reagensseja). Esihenkilöt voivat muokata aktiivisten reagenssien oletuspitoisuuksia, puhtausraja-arvoja ja lämpötilaraja-arvoja ([→ s. 104 – 7.1.3 Raja-arvot](#)). He voivat myös siirtää reagensseja aktiivisen ja passiivisen luettelon välillä ja luoda uusia reagenssityyppejä. Operaattorit voivat ainoastaan tarkastella aktiivista luetteloa.

### 7.2.1 Ennalta määritetyt reagenssit

Jotkin reagenssityypit on ennalta määritetty järjestelmään. Näiden reagenssityyppien ominaisuuksia voi muokata, mutta niitä ei voi poistaa. Ennalta määritettyjä tyyppisiä ei ole pakko käyttää, vaan ne voi jättää passiiviseen luetteloon.

Jos ennalta määritetyn reagenssityypin ominaisuuksia muutetaan, järjestelmä ei voi automaattisesti palauttaa alkuperäisiä arvoja.

Jos ennalta määritetyn etanolin (esim. etanoli) tai kirkastusaineen (esim. ksyleeni) nimeä muutetaan, sen pitoisuutta ensimmäisellä käyttökerralla ei tarkisteta tiheysmittareilla.

### 7.2.2 Aktiivisten reagenssityyppien muokkaaminen

**Reagent types (Reagenssityypit)**-näytöllä (**Reagents (Reagenssit) > Reagent types (Reagenssityypit)**) voit tarkastella ja muokata aktiivisten reagenssityyppien luetteloa. Tältä näytöltä pääset myös muihin reagenssityyppien hallintavaihtoehtoihin.

Kun näyttö avautuu, näkyviin tulee aktiivisten reagenssityyppien luettelo. Nämä reagenssityypit ovat käytettävissä reagenssiasemille määritettäväksi. Aktiivisessa luettelossa on kaksi näkymää: yksi puhtaus- ja toinen lämpötilaraja-arvoille. (Molemmissa näkymissä näkyvät oletuspitoisuudet.) Voit vaihtaa näkymää **Change thresholds (Vaihtamisen raja-arvot)** ([→ Kuva 66](#)), **Final thresholds (Lopulliset raja-arvot)** ([→ Kuva 67](#)) ja **Temperature thresholds (Lämpötilaraja-arvot)** ([→ Kuva 68](#)) -painikkeilla.

Type	DM	Conc.	Conc.	Cassettes	Cycles	Days
Formalin	No	100.00%	50.00%	600	1	1
Formal Saine	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Histochoice	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
NBF	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Prefer	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Zinc Formalin	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% Ethanol	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% IMS	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
70% Ethanol	Yes	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
80% Ethanol	Yes	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kuva 66

1. Valittu reagenssityyppi
2. Aktiivisten reagenssityyppien luettelo
3. Tiheysmittaus
4. Oletusarvot ja pitoisuudet
5. Reagenssin vaihtamisen raja-arvot
6. **Change thresholds (Vaihtamisen raja-arvot)** -painike
7. **Final thresholds (Lopulliset raja-arvot)** -painike
8. **Temperature thresholds (Lämpötilaraja-arvot)**-painike
9. **Add reagent (Lisää reagenssi)** -painike: siirrä reagenssi passiivisesta aktiiviseen luetteloon
10. **Remove reagent (Poista reagenssi)** -painike: siirrä valittu reagenssi aktiivisesta passiiviseen luetteloon

Kaikkia reagensseja ei tarkisteta tiheysmittareilla. Jos **DM**-sarakeessa on reagenssin kohdalla **Yes (Kyllä)** (→ Kuva 66-3), se tarkistetaan tiheysmittareilla.

Type	DM	Conc.	Conc.	Cassettes	Cycles	Days
Formalin	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Formal Saline	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Histochoice	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
NBF	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Prefer	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Zinc Formalin	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% Ethanol	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% IMS	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
70% Ethanol	Yes	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
80% Ethanol	Yes	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Kuva 67

1. Valittu reagenssityyppi
2. Aktiivisten reagenssityyppien luettelo
3. Tiheysmittaus
4. Oletusarvot ja pitoisuudet
5. Reagenssin lopulliset raja-arvot

Type	DM	Conc.	Ambient	Vacuum	Safe
Formalin	No	100.00%	60 °C	60 °C	45 °C
Formal Saline	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Histochoice	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
NBF	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Prefer	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Zinc Formalin	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
50% Ethanol	Yes	50.00%	92 °C	63 °C	45 °C
50% IMS	Yes	50.00%	92 °C	63 °C	45 °C
70% Ethanol	Yes	70.00%	88 °C	59 °C	45 °C
80% Ethanol	Yes	80.00%	85 °C	57 °C	45 °C

Kuva 68

1. Valittu reagenssityyppi
2. Aktiivisten reagenssityyppien luettelo
3. Tiheysmittaus
4. Oletusarvot ja pitoisuudet
5. Reagenssin lämpötilaraja-arvot



Esihenkilöt voivat muokata kaikkien aktiivisten reagenssityyppien oletuspitoisuuksia, vaihtamisen raja-arvoja, lopullisia raja-arvoja ja lämpötilaraja-arvoja.

Tyyppin ominaisuuksia muokataan napauttamalla kyseistä taulukon ruutua ja syöttämällä vaadittu arvo näyttönäppäimistön avulla. Ominaisuudet päivittyvät välittömästi ja niitä käytetään kaikissa reagenssiasemissa ja -protokollissa, jotka käyttävät kyseistä reagenssityyppiä. Muutokset eivät vaikuta käynnissä oleviin protokolliin.



#### Huomaa

- Lämpötilaraja-arvojen laskeminen saattaa mitätöidä protokollavaiheita. Vaiheen lämpötilaa on laskettava niin, että se sopii yhteen uuden reagenssiraja-arvon kanssa, ennen kuin protokolla voidaan ladata tai suorittaa.

Leica Biosystems ei suosittele reagenssipitoisuuksien raja-arvojen alentamista. Pitoisuusraja-arvojen nostaminen saattaa auttaa korjaamaan epäpuhtaista reagensseista johtuvaa huonolaatuista käsittelyä.


Jos aktiivisessa luettelossa olevaa reagenssia ei enää käytetä, se voidaan siirtää passiiviseen luetteloon ja siten pitää aktiivinen luettelo mahdollisimman lyhyenä ja helposti hallittavana. Valitse reagenssityyppi napauttamalla sen nimeä ja napauta sitten **Remove reagent (Poista reagenssi)**.

### 7.2.3 Reagenssien lisääminen, piilottaminen ja poistaminen

Voit lisätä, piilottaa tai poistaa reagensseja kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Reagent types (Reagenssityypit)**. **Reagent types (Reagenssityypit)**-näyttö avautuu (→ [Kuva 68](#)).

#### Reagenssin lisääminen

Voit aktivoida passiivisen reagenssin ja luoda uuden reagenssin (eli lisätä reagenssin, joka ei tällä hetkellä ole aktiivisessa tai passiivisessa reagenssiluettelossa).

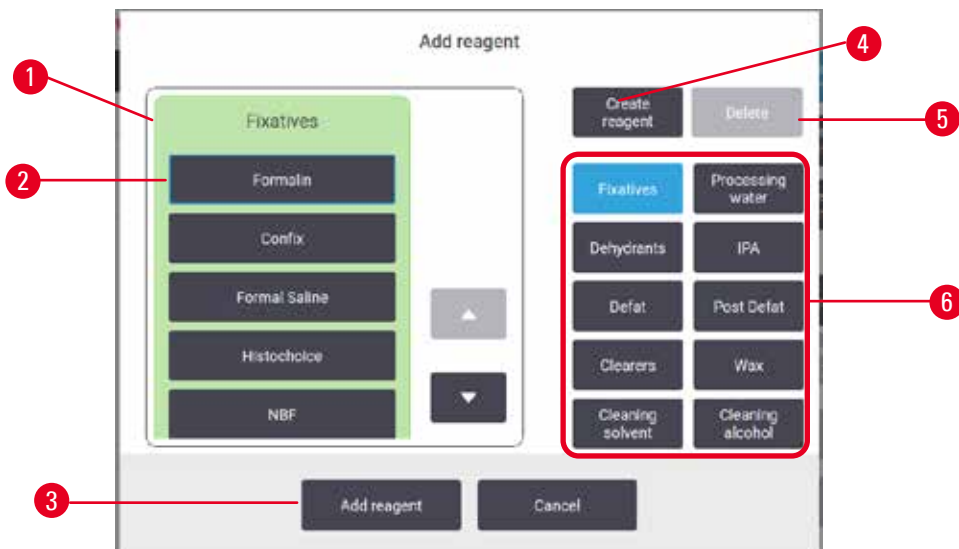

Kuva 69

1. Koko reagenssityyppien luettelo reagenssiryhmän mukaan suodatettuna (painikkeet oikealla)
2. Valittu reagenssityyppi: valitse napauttamalla painiketta
3. **Add reagent (Lisää reagenssi)**: siirrä valittu reagenssi passiivisesta aktiiviseen luetteloon
4. **Create reagent (Luo reagenssi)**: luo uusi reagenssi ja lisää se passiiviseen luetteloon
5. **Delete (Poista)**: poista valittu reagenssityyppi (vain käyttäjän määrittämät protokollat)
6. Reagenssiryhmien suodattimet: napauttamalla näet valittujen ryhmien reagenssityypit

1. Napauta **Add reagent (Lisää reagenssi)**. Avautuu valintaikkuna (→ Kuva 69), jossa näkyvät kaikki reagenssityypit reagenssiryhmän mukaan lajiteltuna.
2. Siirrä passiivinen reagenssi aktiiviseen luetteloon näin:
  - A. Napauta reagenssin ryhmää (fiksatiivit, vedenpoistoaineet jne.) vastaavaa painiketta (→ Kuva 69-6) näytön oikeassa reunassa.
  - B. Valitse reagenssi luettelosta, joka avautuu näytön vasempaan reunaan. (Saatat joutua vierittämään sivua alas löytääksesi sen.)
  - C. Napauta **Add reagent (Lisää reagenssi)** (→ Kuva 69-3).
- ✓ **Reagent types (Reagenssityypit)**-näyttö avautuu uudelleen. Valitsemasi reagenssi on nyt luettelossa.
3. Lisää uusi reagenssityyppi näin:
  - A. Napauta **Create reagent (Luo reagenssi)** (→ Kuva 69-4).
  - B. Valitse ryhmä, johon uusi reagenssi kuuluu.
  - C. Anna reagenssille yksilöllinen nimi ja napauta **Enter (Syötä)**.
- ✓ Uusi reagenssityyppi lisätään passiivisten reagenssien luetteloon.
- D. Jos haluat aktivoida uuden reagenssin, toista yllä olevasta vaiheesta 2. Muussa tapauksessa napauta **Cancel (Peruuta)**. **Reagent types (Reagenssityypit)**-näyttö avautuu uudelleen.

### Reagenssin piilottaminen tai poistaminen

Aktiivisen reagenssin voi piilottaa siirtämällä sen passiiviseen luetteloon. Reagenssin voi myös poistaa. Poistettu reagenssi ei näy aktiivisessa eikä passiivisessa luettelossa. (Vain käyttäjän määrittämiä reagensseja voi poistaa.)

1. Piilota reagenssi näin:
  - A. Valitse se **Reagent types (Reagenssityypit) (Reagenssityypit)**-näytöllä.
  - B. Napauta **Remove reagent (Poista reagenssi)**.
  - C. Napauta vahvistusviestiin **OK**.
  
2. Poista reagenssi näin:
  - A. Napauta **Add reagent (Lisää reagenssi)**. Avautuu valintaikkuna, jossa näkyvät kaikki reagenssityypit reagenssiryhmän mukaan lajiteltuna (→ Kuva 69).
  - B. Napauta reagenssin ryhmää (fiksatiivit, vedenpoistoaineet jne.) vastaavaa painiketta (→ Kuva 69-6) näytön oikeassa reunassa.
  - C. Valitse reagenssi luettelosta, joka avautuu näytön vasempaan reunaan. (Saatat joutua vierittämään sivua alas löytääksesi sen.)
  - D. Napauta **Delete (Poista)** (→ Kuva 69-5). Jos **Delete (Poista)**-painike ei ole käytettävissä, reagenssi on ennalta määritetty eikä sitä voi poistaa.
  - E. Napauta vahvistusviestiin **OK**.
  - F. Palaa **Reagent types (Reagenssityypit)**-näytölle napauttamalla **Cancel (Peruuta)**.

### 7.3 Reagenssiasemien hallinta

Järjestelmässä on 21 asemaa: 17 reagenssipulloa ja 4 parafiiniallasta.

Järjestelmän asemat on asetettava laitteeseen ladattujen reagenssityyppien mukaan. Kun tämä on tehty, järjestelmä seuraa kunkin aseman historiaa (käyttökertojen määrää, käsiteltyjen kasettien määrää ja laitteelle ladattuna vietettyjen päivien lukumäärää), tämänhetkistä pitoisuutta ja parafiinisäiliöiden osalta tämänhetkistä lämpötilaa. Lisätietoja on kohdassa (→ s. 101 – 7.1.1 Reagenssiryhmät, -tyypit ja -asemat).

Esihenkilöt voivat asettaa kullekin asemalle reagenssityypin. He voivat myös muuttaa pitoisuusarvoja, jos he tietävät, että varsinaiset pitoisuudet eroavat järjestelmään tallennetuista pitoisuuksista. Sekä esihenkilöt että operaattorit voivat muuttaa aseman tilaa tarvittaessa. Historiatietoja voidaan vain tarkastella.

Toiminnan turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että reagenssikaapissa on paikoilleen ladattuja pulloja. Jos et halua käyttää tiettyä asemaa, aseta sen tilaksi **Dry (Kuiva)** ja (muille kuin parafiiniasemille) aseta tyhjä pullo aseman reagenssikaappiin.

Laitteeseen ladattavien reagenssityyppien ja niiden pullojen määrän valitseminen on tärkeää. Se riippuu suoritettavasta protokollasta. Kohdassa Aseman määrytykset (→ s. 164 – 10.3 Aseman määrytykset) on tietoa oletusprotokollille sopivista määrytyksistä.

## 7.3.1 Reagenssiasemat-näyttö

Reagenssiasemien asettaminen ja hallinta sekä aseman historian tarkastelu tapahtuu kohdassa **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat)**. **Reagent Stations (Reagenssiasemat)**-näyttö avautuu. Tällä näytöllä on kaksi näkymää: yhdessä on 17 reagenssipulloa (→ [Kuva 70](#)) ja toisessa neljä parafiinisäiliötä (→ [Kuva 71](#)). Voit vaihtaa näkymää napauttamalla **Reagent bottles (Reagenssipullot)** tai **Paraffin chambers (Parafiinisäiliöt)**.

The screenshot shows the 'REAGENT STATIONS' interface. At the top, there are navigation tabs: Status, Reagents, Administration, Settings, and Maintenance. The 'Reagents' tab is active. Below the tabs, there are two buttons: 'Reagent bottles' and 'Paraffin chambers'. The 'Reagent bottles' button is selected. The main area displays a table with the following columns: Station, Type, Conc., Cassettes, Cycles, Days, State, and Lot Number. A red box highlights the 'Cassettes', 'Cycles', and 'Days' columns, and the text 'Since changed' is visible above the table. Red circles with numbers 1 through 9 point to various elements: 1 points to the 'Reagent bottles' button, 2 to the 'Type' column, 3 to the 'Station' column, 4 to the 'Conc.' column, 5 to the selected row (Station 4), 6 to the 'Conc.' value (100.0%), 7 to the 'Since changed' text, 8 to the 'Lot Number' column, and 9 to the 'State' column.

Station	Type	Conc.	Cassettes	Cycles	Days	State	Lot Number
1	Formalin	88.0%	450	3	4	Full	
2	Formalin	95.0%	150	1	4	Full	
3	70% Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
4	90% Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
5	Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
6	Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
7	Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
8	Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	
9	Ethanol	100.0%	0	0	0	Full	

Kuva 70

1. **Reagent bottles (Reagenssipullot)**-painike
2. **Type (Tyyppi)**: aseman reagenssityyppi. Vaihda napauttamalla ruutua.
3. **Station (Asema)**: aseman numero värikoodattuna reagenssiryhmän mukaan
4. Raidallinen ruutu osoittaa, että vaihtamisen raja-arvo on ylitetty. Raja-arvojen ulkopuolella oleva pitoisuusarvo näkyy punaisella.
5. Valittu asema: valitse napauttamalla **Station (Asema)**-ruutua
6. **Conc. (Pit.)**: reagenssin tämänhetkinen pitoisuus asemassa. Vaihda napauttamalla ruutua.
7. **Since changed (Muutettu viimeksi)**: kunkin aseman käyttöhistoria, vain tarkastelu
8. **Lot Number (Eränumero)**: reagenssin eränumerotiedot
9. **State (Tila)**: aseman nykyinen tila. Vaihda napauttamalla ruutua.

The screenshot shows the 'REAGENT STATIONS' interface. At the top, there are two tabs: 'Reagent bottles' and 'Wax chambers'. Below the tabs is a table with columns: Station, Type, Conc., Cassettes, Cycles, Days, Temp., State, and Lot Number. The table contains four rows of data for stations W1, W2, W3, and W4. Red callouts 1 through 9 point to specific UI elements: 1 points to the 'Wax chambers' tab, 2 to the 'Type' column, 3 to the 'Station' column, 4 to the 'W2' row, 5 to the 'Conc.' column, 6 to the 'Cassettes' column, 7 to the 'Lot Number' column, 8 to the 'State' column, and 9 to the 'Temp.' column.

Station	Type	Conc.	Cassettes	Cycles	Days	Temp.	State	Lot Number
W1	Paraffin	100.00%	0	0	342	65 °C	Full	
W2	Paraffin	100.00%	0	0	342	65 °C	Full	
W3	Paraffin	100.00%	0	0	342	65 °C	Full	
W4	Paraffin	100.00%	0	0	342	65 °C	Full	

Kuva 71

1. **Paraffin chambers (Parafiinisäiliöt)**-painike
2. **Type (Tyyppi)**: aseman reagenssityyppi. Vaihda napauttamalla ruutua.
3. **Station (Asema)**: aseman numero värikoodattuna reagenssiryhmän mukaan. Raidallinen ruutu osoittaa, että vaihtamisen raja-arvo on ylitetty. Raja-arvojen ulkopuolella oleva pitoisuusarvo näkyy punaisella.
4. Valittu asema: valitse napauttamalla Station (Asema)-ruutua
5. **Conc. (Pit.)**: reagenssin tämänhetkinen pitoisuus asemassa. Vaihda napauttamalla ruutua.
6. **Since changed (Muutettu viimeksi)**: kunkin aseman käyttöhistoria, vain tarkastelu
7. **Lot Number (Eränumero)**: reagenssin eränumerotiedot
8. **State (Tila)**: aseman nykyinen tila. Vaihda napauttamalla ruutua.
9. **Temp. (Lämpö)**: parafiinisäiliön tämänhetkinen lämpötila

### 7.3.2 Reagenssiaseman ominaisuuksien hallinta

#### Uusien reagenssien määrittäminen asemille

- ① Tämän tehtävän suorittaminen edellyttää esihenkilöasemaa. Kummassakaan tislauksastiassa ei saa olla protokollaa käynnissä tai ladattuna. Reagenssiaseman määritysten muuttaminen protokollan suorittamisen aikana voi johtaa protokollan keskeytymiseen.

Jos asemaan ladattua reagenssityyppiä muutetaan, myös asemalle ohjelmistossa määrättyä reagenssityyppiä on muutettava.

1. Poista vaihdettavan reagenssityypin pullo (tai tyhjä parafiinisäiliö).
2. Siirry kohtaan **Reagent (Reagenssi) > Stations (Asemat)** ja napauta aseman **Type (Tyyppi)**-solua. **Type (Tyyppi)**-valintaikkuna avautuu (→ Kuva 72).



Kuva 72

3. Valitse uusi reagenssityyppi luettelosta. Valintaikkunassa näkyvät kaikki tällä hetkellä aktiiviset reagenssityypit. Jos reagenssia ei ole luettelossa, se saattaa olla passiivisessa reagenssiluettelossa. Kohdassa (→ s. 113 – 7.2.3 Reagenssien lisääminen, piilottaminen ja poistaminen) on ohjeet passiivisen reagenssin aktivoimiseen ja uuden reagenssin lisäämiseen.
4. Kysyttäessä, haluatko nollata valitun aseman ominaisuudet, napauta **Yes (Kyllä)**. Tällöin historialaskimet nollautuvat ja aseman pitoisuus palautuu uuden reagenssityypin oletusarvoon.
5. Puhdista pullo tarvittaessa ja täytä se tuoreella uudentyyppisellä reagenssilla. Lataa pullo takaisin laitteeseen (tai täytä parafiinisäiliö).
6. Pullo:
  - A. Vedä pullo ulos, vaihda reagenssi ja lataa se takaisin reagenssikaappiin. **Replace the reagent bottle (Vaihda reagenssipullo)**-näyttö tulee näkyviin.
  - B. Valitse vaihdetun pullon kuvake ja napauta **Changed (Vaihdettu)**-painiketta.
  - C. Syötä reagenssipitoisuus.
  - D. Syötä halutessasi viimeinen käyttöpäivä ja eränumerotiedot.
7. Parafiinisäiliö: Napauta **State (Tila)**-ruutua ja aseta aseman tilaksi **Full (Täynnä) Reagent Stations (Reagenssiasemat)**-näytöllä.

Kun aseman reagenssityyppiä muutetaan, aseman pitoisuus ja historia kehoitetaan aina nollaamaan. Jos tällöin valitaan **No (Ei)**, edellisen reagenssin pitoisuus ja historia säilyvät. Käytä tätä vaihtoehtoa vain silloin, jos korjaat aiemman virheen aseman reagenssin tiedoissa etkä todellisuudessa vaihda aseman sisältöä.



#### Varoitus

Reagenssien virheelliset määritelmät

**Näytteiden vauriot, jotka johtuvat käyttöjärjestelmän määritelmien ja pullojen merkintöjen välisistä eroista.**

- Päivitä aseman tiedot aina oikeiksi.
- Tarkista asemien määritelmä aina ennen protokollien aloittamista ja aloittamisen yhteydessä.
- Älä koskaan päivitä tietoja, jos reagenssia ei ole vaihdettu.

### Reagenssipitoisuuden muuttaminen

Esihenkilö voi asettaa aseman lasketun pitoisuusarvon. Napauta aseman **Conc. (Pit.)**-solua. Syötä uusi pitoisuus näyttönäppäimistöllä.

Jos taulukossa (→ s. 104 – [Pitoisuuden automaattinen tarkistus](#)) lueteltuun reagenssiin tehdään muutoksia, kyseisen reagenssin pitoisuus tarkistetaan tiheysmittareilla seuraavan kerran, kun sitä käytetään protokollan suorittamiseen.



#### Varoitus

Virheelliset pitoisuusasetukset

#### Näytteiden vauriot tai kudosten käsittelyn laadun heikkeneminen

- Älä muuta käytetyn reagenssin pitoisuutta, jos et pysty vahvistamaan todellista pitoisuutta.

### Aseman tilan asettaminen

Kaikki käyttäjät voivat muuttaa aseman tilaa. Sallitut tilat ovat **Full (Täynnä)**, **Empty (Tyhjä)**, **In use (Käytössä)** ja **Dry (Kuiva)**.

Tätä ei tavallisesti tarvitse tehdä reagenssipulloille. Pullojen tila päivitetään samalla, kun ne poistetaan ja vaihdetaan, ja ohjelmisto seuraa tilaa automaattisesti. Vaihda pulloaseaman tila vain, jos näkyvillä on väärä tila tai jos haluat ottaa täyden pullon pois käytöstä (asettamalla sen tilaksi **In use (Käytössä)** tai **Empty (Tyhjä)**).

Parafiinisäiliöiden osalta aseman tila on muutettava osana tavallista parafiinin vaihtamista.

Muuta aseman tila näin:

1. Siirry kohtaan **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat)**.
2. Napauta aseman **State (Tila)**-solua.
3. Napauta sopivaa kuvaketta näkyviin tulevassa valintaikkunassa (→ [Kuva 73](#)).



Kuva 73

**Varoitus**

Reagenssien virheelliset määritelmät

**Näytteiden vauriot, jotka johtuvat käyttöjärjestelmän määritelmien ja pullojen merkintöjen välisistä eroista.**

- Päivitä aseman tiedot aina oikeiksi.
- Tarkista asemien määritelmä aina ennen protokollien aloittamista ja aloittamisen yhteydessä.
- Älä koskaan päivitä tietoja, jos reagenssia ei ole vaihdettu.

## 7.4 Reagenssien vaihtaminen

Kun järjestelmä huomauttaa, että reagenssi on vaihdettava, se on tehtävä mahdollisimman pian.

Pulloissa oleva reagenssi voidaan vaihtaa kahdella tavalla:

- **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)** – käytä **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näytön komentoja ja pumpkaa vanha reagenssi ulos ja uusi reagenssi sisään. Pulloa ei tarvitse poistaa reagenssikaapista.
- **Manually (Manuaalinen)** – poista pullo reagenssikaapista, tyhjennä ja täytä se uudelleen ja aseta se sitten takaisin kaappiin.

Parafiinin osalta parafiinialtaat on tyhjennettävä **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näytön avulla ja täytettävä manuaalisesti ja sen jälkeen ohjelmisto on päivitettävä.

### 7.4.1 Etätäyttö/-tyhjennys-näyttö

Käytä **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näyttöä (**Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**) reagenssipullojen täyttämiseen ja tyhjentämiseen poistamatta niitä laitteesta. Samaa näyttöä käytetään parafiinialtaiden tyhjentämiseen. Samalla kerralla voi tyhjentää tai täyttää yhden aseman tai kokonaisen ryhmän yhteensopivia asemia. Tällä näytöllä voi myös täyttää ja tyhjentää tislauksastioita. Siten on mahdollista palautua osittain suoritetuista tyhjennys- tai täyttötoimenpiteistä.

**Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näytön (→ [Kuva 74](#)) toiminnot ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä: sekä operaattoreiden että esihenkilöiden.






Kuva 74

1. Täytä/tyhjennä pullot, Tyhjennä jätteisiin tai Täytä/tyhjennä tislauksastia: aloita täyttö tai tyhjennys, kun sopiva asema, etälähde tai tislauksastia on valittu
2. Keskeytä: pysäytä tyhjennys tai täyttö
3. Parafiinijäte: valitse parafiinisäiliön kanssa tyhjentääksesi säiliön
4. Etä: valitse tislauksastian ja pullon kanssa täyttääksesi tai tyhjentääksesi pullon
5. Tislauksastia A: tislauksastian A aikataulutetut täyttö- ja tyhjennystoimenpiteet
6. Tislauksastia B: tislauksastian B aikataulutetut täyttö- ja tyhjennystoimenpiteet
7. Parafiinijärjestelmä: parafiinisäiliöiden aikataulutetut tyhjennystoimenpiteet

#### 7.4.2 Etätäyttö/-tyhjennysliitännät

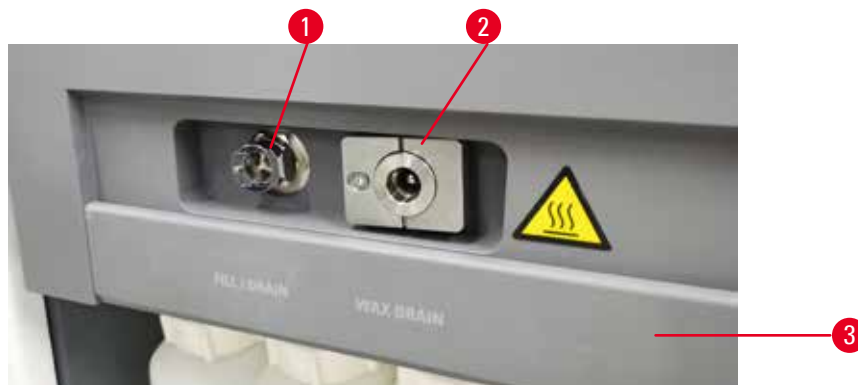

Kuva 75

Etätäyttö-/tyhjennysputki (→ Kuva 75-1) ja parafiinin tyhjennysaukko (→ Kuva 75-2) sijaitsevat reagenssikaapin aktiivihiilisuodattimen vieressä. Liitännöjä peittää suojuukku (→ Kuva 75-3). Parafiinin poistoputki on lämmitetty, jotta parafiini ei kovetu tyhjennyksen aikana.

- Ennen parafiiniaseman tyhjentämistä avaa täyttö-/tyhjennysluukku ja liitä parafiinin poistoletku poistoputkeen. Varmista seuraavat:
  - A. Parafiinin poistoletku tyhjenee sopivaan säiliöön.
  - B. Mikään osa letkusta ei uppoa poistettuun parafiiniin. Tämä estää parafiinia kovettumasta letkun pään ympärille ja tukkimasta sitä.
  - C. Ennen reagenssipullojen täyttämistä tai tyhjentämistä etätäyttö-/tyhjennysletku on liitettävä etätäyttö-/tyhjennysputkeen. Letkussa on työntöliitin, joka varmistaa tiukan kiinnityksen putkeen. Kiinnitä letku avaamalla täyttö-/tyhjennysluukku ja painamalla liitäntä putken päähän. Poista letku liu'uttamalla lukitusrenkas taakse ja vetämällä letku irti täyttö-/tyhjennysputkesta.



#### Varoitus

Reagenssin täyttäminen epävakaasta säiliöstä.

**Henkilövamma – Täyttö-/tyhjennystoiminnoissa on voimakas tyhjennys, joka voi aiheuttaa epävakaan säiliön kaatumisen ja vuotamisen. Käyttäjä voi liukastua lattialle valuneen reagenssin takia.**

#### Ympäristön kontaminaatio.

- Varmista aina, että täytössä ja tyhjennyksessä käytetään suurta, vakaata säiliötä. Säiliön on oltava myös riittävän suuri, jotta kaikki valutettu neste mahtuu siihen. Jos käytät pientä säiliötä, sitä ja letkua on tuettava täytön tai tyhjennyksen aikana.
- Käytä aina instrumentin mukana tullutta letkua.
- Käytä aina kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun käsittelet reagensseja. Kudosten käsittelyyn käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.

#### 7.4.3 Reagenssin vaihtaminen – etätäyttö ja -tyhjennys



#### Varoitus

Liitin ei vastaa letkua / liittimen korrosio, reagenssipullon ylivuoto (ulkoinen reagenssimäärä ei vastaa reagenssipulloa jne.), pullo putoaa reagenssin täyttämisen tai vaihtamisen aikana, letku irtoaa tyhjentämisen aikana.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Biologinen vaara jätereagenssin takia.**

#### Ympäristön kontaminaatio.

- Käytä aina kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun käsittelet reagensseja. Kudosten käsittelyyn käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.
- Käytä aina instrumentin mukana tullutta letkua.
- Älä koskaan täytä reagenssiasemaa, jossa on jo sisältöä.

Sitten reagenssipullot voi tyhjentää ja täyttää uudelleen poistamatta niitä laitteesta. Toimenpide tyhjentää kunkin pullon tislauksastiaan ja tyhjentää sen jälkeen tislauksastian etätäyttö-/tyhjennysputkeen. Täyttämiseen käytetään vastakkaista toimenpidettä.


Jos käytät etätyhjennystä ja -täyttöä usein, älä unohda tarkistaa pullojen puhdistustarvetta. Se on tehtävä kerran viikossa.

Ennen kuin aloitat etätäytön tai -tyhjennyksen, varmista, että molemmat retortit ovat käytettävissä. Kun protokolla on käynnissä retorteissa, etätäyttöä/tyhjennystä ei voi käyttää. Se on suunnitteluominaisuus, ei toimintahäiriö.

- molemmissa retorteissa ei saa olla protokollaa ladattu tai käynnissä
- molempien retorttien on oltava puhtaita tai tyhjiä ja
- molempien retorttien on oltava puhtaita tai retorteissa (jos sellaisia on) olevan jäännöksen on oltava yhteensopivaa pullossa (pulloissa) olevan reagenssin kanssa.

## Tyhjennys

1. Liitä etätäyttö-/tyhjennysletku ja aseta sen pää sopivaan astiaan.
2. Valitse **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näytöllä (**Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**)
  - A. käytettävä tislusastia (→ Kuva 76-1)
  - B. **Remote (Etä)**-kuvake (→ Kuva 76-2)
  - C. tyhjennettävät pullo (yhtä aikaa tyhjennettävissä pulloissa on oltava samantyyppistä reagenssia) (→ Kuva 76-3)

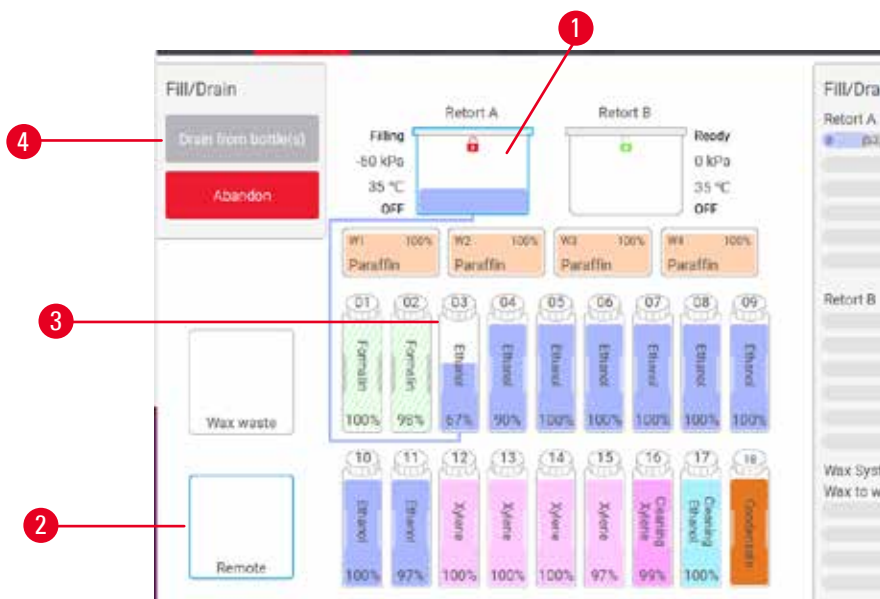

Kuva 76

3. Aloita tyhjennys napauttamalla **Drain from bottle(s) (Tyhjennä pullo)** (→ Kuva 76-4).
4. Tarkista tarvittaessa, että tislusastian kansi on kiinni ja etätäyttö-/tyhjennysletku on kunnolla kiinni.
5. Aloita tyhjennys napauttamalla **OK**.

Laite tyhjentää pullo valittuun tislusastiaan. Voit tarkkailla tyhjennyksen etenemistä tilapaneelissa. Kun tyhjennys on valmis, tislusastian tila on **Empty (Tyhjä)** ja pullon tila **Dry (Kuiva)**.

Täyttö

6. Aseta letku astiaan, jossa on tuoretta reagenssia. Tuoreen reagenssin lämpötilan on oltava yli 5 °C, että reagenssisensorit toimivat kunnolla.
  7. Valitse **Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näytöllä
    - A. käytettävä tislauastia
    - B. **Remote (Etä)**-kuvake
    - C. täytettävät pullot (yhtä aikaa tyhjennettävien pullojen tilan on oltava **Dry (Kuiva)** ja ne on asetettava samalle reagenssityypille).
- Pulloissa olevien jäämien on oltava yhteensopivia uuden reagenssin kanssa.
8. Aloita täyttö napauttamalla **Fill to bottle(s) (Täytä pullot)**.
  9. Tarkista tarvittaessa, että tislauastian kansi on kiinni ja etätäyttö-/tyhjennysletku on kunnolla kiinni. Aloita täyttö napauttamalla **OK**.
  10. Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
  11. Vahvista, että reagenssityyppi, pitoisuus ja historiatiedot ovat oikein. Jos ne eivät ole, napauta sopivaa ruutua ja muuta arvoa. Voit myös skannata reagenssin eränumerotiedot. Jos asetat uuden reagenssityypin, aseman on oltava valmiiksi asetettu kyseiselle tyyppille (→ s. 117 – Uusien reagenssien määrittäminen asemille). Reagenssin on oltava yhteensopiva tislauastian ja pullon reagenssijäämien kanssa.
  12. Aloita täyttö napauttamalla **OK**.

Laite täyttää pullot valitusta tislauastiasta. Voit tarkkailla täytön etenemistä tilapaneelissa. Kun täyttö on valmis, näyttöön tulee viesti. Tislauastian tila on **Empty (Tyhjä)** ja pullon tila **Full (Täynnä)**.

**Huomaa**

- Tyhjennyksen tai täytön aikana voi milloin tahansa pysäyttää kaikki käynnissä ja tulossa olevat täyttö- ja tyhjennystoiminnot napauttamalla Keskeytä-painiketta.
- Jos tyhjennys keskeytetään, kun tislauastia ja pullo ovat osittain täynnä, tislauastia on tyhjennettävä takaisin alkuperäiseen pulloon, jotta toimenpidettä voidaan jatkaa. Tyhjennä tislauastia poistamalla Etä-kuvakkeen valinta ja napauttamalla sitten Tyhjennä tislauastia -painiketta.
- Letkun pinta on puhdistettava pehmeällä, kuivalla liinalla ennen reagenssien etätäyttöä/-tyhjennystä ja sen jälkeen.

Etätäyttö- ja -tyhjennysjaksot

Seuraavia reagenssijaksoja suositellaan useita pulloja täytettäessä ja tyhjennettäessä:

Järjestys	Tyhjennysjakso	Täyttöjakso
1	Fiksatiivit	Puhdistusliuottimet
2	Puhdistusetanoli	Kirkastajat
3	Vedenpoistoaineet	Rasvanpoistoliuottimet
4	Rasvanpoistoetanoli	Rasvanpoistoetanoli

Järjestys	Tyhjennysjakso	Täyttöjakso
5	Rasvanpoistoliuottimet	Puhdistusetanoli
6	Puhdistusliuottimet	Vedenpoistoaineet
7	Kirkastajat	Fiksatiivit

#### 7.4.4 Reagenssin vaihtaminen – manuaalisesti

Vaihda pullo manuaalisesti poistamalla se reagenssikaapista ja hävittämällä vanha reagenssi (laboratorion tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti). Puhdista pullo tarvittaessa ja täytä se sitten tuoreella reagenssilla. Lataa pullo takaisin reagenssikaappiin ja varmista, että se on tiukasti kiinni kaapin takaosan liittimissä.

Reagenssipullo on painettava oikeaan paikkaan **Status (Tila)**-näytöllä näkyvän reagenssin kuvauksen mukaisesti.

Kun pullo on palautettu paikalleen, **Select a bottle to update (Valitse päivitettävä pullo)** -valintaikkuna tulee näkyviin. Siinä näkyvät reagenssityyppi ja pitoisuus, jotka pullossa olivat poistettaessa.

Kun valitset päivitettävän pullon, saatavilla ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Changed (Vaihdettu)** – Syötä reagenssipitoisuus ja halutessasi myös viimeinen käyttöpäivä ja eränumerotiedot.
- **Topped off/up (Täydennetty)** – Valitse tämä, jos et vaihtanut koko reagenssia vaan lisäsit vähän tuoretta, samantyyppistä reagenssia nostaaksesi sen määrää pullossa. (Tällöin pullon tilaksi vaihtuu Täynnä. Pitoisuus- ja historiatiedot eivät muutu.)
- **No change (Ei muutosta)** – Valitse tämä, jos et tehnyt muutoksia pullossa olevaan reagenssiin.
- **Emptied (Tyhjennetty)** – Valitse tämä, jos tyhjensit pullon, mutta et täyttänyt sitä uudelleen.



#### Varoitus

Instrumentin antamat tiedot on jätetty huomiotta.

Reagenssin/aseman parametrit on päivitetty, mutta reagenssia ei ole vaihdettu.

Älä päivitä reagenssin tilaa GUI:ssa tyhjältä täydeksi pullon täyttämisen jälkeen.

Älä aseta tilaa täydeksi ennen pullon täyttämistä, jos et täytä pulloa tai täytät pullon vain osittain.

**Näytteiden vauriot, jotka johtuvat likaisista tai vanhentuneista reagensseista tai riittämättömistä reagensseista.**

**Diagnoosin viivästyminen.**

- Vaihda reagenssit aina, kun sinua pyydetään tekemään niin.
- Päivitä aseman tiedot aina oikeiksi.
- Älä koskaan päivitä tietoja, jos reagenssia ei ole vaihdettu.

## 7.4.5 Parafiinin vaihtaminen



## Varoitus

Avaa/sulje parafiinialtaan kannet, täytä sulanut parafiini, liitin ei vastaa letkua / liittimen korroosia, letku irtoaa tyhjennyksen aikana, jäteparafiinisäiliö ei ole valmis / ei ole vakaa, kun tyhjennys aloitetaan käyttöliittymän kautta, vedä tyhjennysletku ulos.

**Kädet/sormet saavat palovammoja.**

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Kontaminoituneen parafiinin aiheuttama biologinen vaara.**

**Ympäristön kontaminaatio.**

- Käytä kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun täytät/tyhjennät sulanutta parafiinia. Käytetty parafiini voi olla kontaminoitunutta.
- Varmista, että käytetty parafiinin tyhjennysletku on oikean kokoinen, jotta parafiinia ei pääse vuotamaan.
- Putkesta poistuva parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, että parafiini tyhjenetään sopivaan säiliöön, ja pysy tyhjennyksen aikana turvallisen välimatkan päässä.
- Älä poista etätäyttö-/tyhjennysletkua ennen kuin ohjelmisto ilmaisee, että prosessi on suoritettu loppuun ja letku on tyhjenetty paineilmalla. Reagenssivirtauksen päättyminen ei ole merkki siitä, että toimenpide on suoritettu loppuun.

Ennen parafiinin tyhjentämistä on varmistettava, että tislusastioissa ei ole käynnissä protokollaa tai reagenssien täyttöä/tyhjennystä. Tislusastiat eivät vaadi puhdistamista.

Tyhjennettävän parafiinin on oltava sulaa.

Tyhjennys

1. Liitä parafiinin poistoletku ja aseta sen pää sopivaan astiaan.
2. Siirry kohtaan **Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)** ja valitse
  - A. tyhjennettävät parafiiniasemat ja
  - B. **Paraffin waste (Parafiinijäte)**-kuvake.
3. Napauta **Drain to waste (Tyhjennä jätteisiin)**.
4. Näkyviin tulee vahvistusviesti, jossa pyydetään tarkistamaan, että parafiinin poistoletku on kunnolla kiinni ja se laskee sopivaan astiaan.
5. Aloita tyhjennys napauttamalla **OK**. Laite tyhjentää säiliöt. Voit tarkkailla etenemistä tilapaneelissa. Parafiinin tyhjennys saattaa kestää jopa 5 minuuttia. Kun säiliöt on kokonaan tyhjenetty, näkyviin tulee valintaikkuna ja kaikkien tyhjenettyjen säiliöiden tila on **Dry (Kuiva)**. Älä irrota parafiinin tyhjennysletkua ennen kuin tyhjennyksen onnistuminen vahvistetaan valintaikkunassa.
6. Ehkäise parafiinin kovettuminen tyhjennysletkussa poistamalla letku astiasta, jossa tyhjenetty parafiini on.

**Huomaa**

- Jos parafiinia ei tule ulos, parafiiniletku on todennäköisesti tukossa. Jos tukossa oleva letku irrotetaan ennen kuin tyhjennys on keskeytetty, kuumaa parafiinia roiskuu ulos laitteen etuosasta. Keskeytä tyhjennys ennen letkun irrottamista ja parafiinin sulattamista kuumalla vedellä.
- Tyhjennyksen aikana voi milloin tahansa pysäyttää kaikki käynnissä ja tulossa olevat täyttö- ja tyhjennystoiminnot napauttamalla Keskeytä-painiketta.

Täyttö

7. Jos aiot täyttää parafiinisäiliön sulalla parafiinilla, aseta parafiinialtaan ilmanvaihtotulppa parafiinisäiliön takaosassa olevaan ilmanvaihtoaukkoon. Tämä estää parafiinin pääsemistä tuuletusaukkoon täytön aikana.



Kuva 77

8. Täytä parafiinisäiliö sulalla tai kiinteällä parafiinilla.
9. Jos asetit parafiinialtaan ilmanvaihtotulpan ilmanvaihtoaukkoon, poista se.
10. Sulje parafiinialtaan kansi.
11. Siirry kohtaan **Reagents (Reagenssit) > Stations (Asemat) > Paraffin chambers (Parafiinisäiliöt)**. Tyhjennetyt parafiinisäiliön rivillä näkyy oletuspitoisuus. Sillä näkyvät myös vanhat, nollatut arvot. Aseman tila on **Dry (Kuiva)**. Reagenssityyppi ei muutu tyhjennetyt parafiinin myötä, ellei asemalle määrättyä tyyppiä muutettu tyhjennyksen jälkeen.
12. Napauta säiliön Tila-ruutua.
13. Jos lisäsit sulaa parafiinia, valitse **Full (Täynnä)**.
14. Jos käytit kiinteää parafiinia, valitse **Not molten (requires melting) (Ei sulaa (sulatettava))**.
15. Syötä halutessasi uuden parafiinin eränumero.
16. Napauta **OK**.
17. Jos tilaksi asetettiin **Not molten (requires melting) (Ei sulaa (sulatettava))**, alkaa nopea parafiinin kuumennustoimenpide. Parafiinia on ehkä lisättävä, kun se sulaa. Aseman tilaksi vaihtuu automaattisesti Täynnä, kun parafiini on valmista käyttöön.

## 7.4.6 Tislausastioiden täyttäminen ja tyhjentäminen



## Varoitus

Liitin ei vastaa letkua / liittimen korroosio, reagenssipullon ylivuoto (ulkoinen reagenssimäärä ei vastaa reagenssipulloa jne.), pullo putoaa reagenssin täyttämisen tai vaihtamisen aikana, letku irtoaa tyhjentämisen aikana.

**Voi aiheuttaa liukastumisen tai myrkyllisten/vaarallisten höyryjen hengittämistä.**

**Biologinen vaara jätereagenssin takia.**

**Ympäristön kontaminaatio.**

- Käytä aina kemikaalisuojavaatteita, suojalaseja, hengityssuojainta, kumisia käsineitä ja muita tarvittavia henkilönsuojaimia, kun käsittelet reagensseja. Kudosten käsittelyyn käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.
- Käytä aina instrumentin mukana tullutta letkua.
- Älä koskaan täytä reagenssiasemaa, jossa on jo sisältöä.

**Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**-näyttöä voidaan käyttää myös tislausastioiden täyttämiseen tai tyhjentämiseen. Tämä on erityisen hyödyllistä kesken jääneiden etätäyttö-/tyhjennystoimenpiteiden jälkeen. Tislausastian täyttö- ja tyhjennystoiminnot toimivat reagenssien kontaminaation, reagenssiroiskeiden ja reagenssin ylikuumenemisen välttämiseksi suunniteltujen sääntöjen mukaan. Jotkut säännöistä voidaan ohittaa, mutta seurauksena saattaa olla alentunut reagenssipitoisuus.

Myös **Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** -näytöllä (→ s. 129 – 8.1.1 Manuaaliset toiminnot) voi täyttää ja tyhjentää tislausastioita.

Tislausastioiden täyttämistä ja tyhjentämistä koskevat säännöt ovat seuraavat:

- Tislausastian on oltava puhdas tai tyhjä ennen tislausastian täyttötoimenpiteen aloittamista.
- Jos tislausastia on tyhjä, valitussa asemassa on oltava yhteensopivaa reagenssia (→ s. 167 – 10.5 [Reagenssien yhteensopivuustaulukot](#)).
- Tislausastiaa ei voi täyttää reagenssilla, jonka lämpötilaraja-arvo on alempana kuin tislausastialle asetettu lämpötila.
- Tislausastiaa tyhjennettäessä reagenssi tai parafiini on palautettava alkuperäiseen asemaansa.
- Tislausastiaa tyhjennettäessä asemassa on oltava riittävästi tilaa tislausastian sisällölle, eikä se saa olla täynnä tai käytössä.

Huom: Vältä nesteroiskeet varmistamalla, että asemassa on riittävästi tilaa ennen kuin ohitat riittämättömän tilan varoitukset.

Täytä tai tyhjennä tislausastia näin:

1. Siirry kohtaan **Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain (Etätäyttö/-tyhjennys)**.
2. Valitse täytettävä tai tyhjennettävä tislausastia.
3. Valitse reagenssiasema, josta tislausastia täytetään (tai johon tislausastia tyhjennetään).
4. Napauta **Fill retort (Täytä tislausastia)**- tai **Drain retort (Tyhjennä tislausastia)** -painiketta.
5. Voit keskeyttää täytön tai tyhjennyksen milloin tahansa napauttamalla **Abort (Keskeytä)**.



## 8. Lisäasetukset ja -toiminnot

### 8.1 Reagenssit-valikko

Monia reagenssien käsittelyominaisuuksia järjestelmässä voi hallita manuaalisesti **Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** -näytöllä.

#### 8.1.1 Manuaaliset toiminnot

Monia laitteen ominaisuuksia voi hallita manuaalisesti **Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** -näytöllä (**Reagents (Reagenssit) > Manual operations (Manuaaliset toiminnot)**) (→ [Kuva 78](#)). Kaikki käyttäjät – operaattorit ja esihenkilöt – voivat suorittaa näitä toimintoja.



Kuva 78

1. Tislausastia A:n hallinta
2. Tislausastia B:n hallinta
3. **Fill/Drain retort (Täytä/tyhjennä tislausastia):** täytä tai tyhjennä tislausastia valitussa asemassa
4. **Tislausastian avaaminen**
5. **Paraffin heater (Parafiinin kuumennin):** Ota parafiinialtaan kuumentimet käyttöön / pois käytöstä
6. **Stirrer (Sekoitin):** käynnistä tai sammuta tislausastian sekoitin
7. **Pressure (Paine):** aseta tislausastian paine: ympäristö, tyhjiö, paine tai sykkipaine ja tyhjiö
8. **Temp. (Lämpö):** aseta tislausastian lämpötila
9. **Abort (Keskeytä):** pysäytä täyttö- tai tyhjennystoiminto
10. **Vent paraffin (Parafiinin ilmaus):** vapautaa parafiinisäiliöiden paine tai tyhjiö

**Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** -näytöllä ei voi

- ohittaa käynnissä olevaa protokollaa
- täyttää tai tyhjentää tislusastiaa, johon on ladattu protokolla.

### Tislusastian lämpötila-alue

Tislusastian lämpötila-alue rajoittuu seuraaviin arvoihin:

- **Reagent (Reagenssi)**: Reagenssi: enintään 35 °C – 85 °C (enimmäisarvo rajattu 65 °C:een kudostenkäsittelyprotokollia suoritettaessa).
- **Paraffin (Parafiini)**: Parafiinin sulamispiste + vähintään 2 °C, enintään 85 °C (rajattu 77 °C:een vakioprotokollia suoritettaessa). Tarkista kulloinenkin parafiinin sulamispiste **Settings (Asetukset) > Processing settings (Käsittelyasetukset)** -näytöllä.

Tislusastian tilasta ja tislusastiassa olevasta reagenssista riippuen saattaa olla muita rajoituksia. Tislusastian lämpötilaa ei voi nostaa yli reagenssin turvallisen lämpötilan raja-arvoja.

### Parafiinin siirtäminen

Parafiinialtaan (mukaan lukien parafiiniventtiilit ja siirtoputket) ja tislusastian on oltava parafiinin odotuslämpötilassa ennen tislusastian täyttämistä parafiinilla. Jokaisessa tislusastiassa on parafiinin kuumennin tämän saavuttamiseksi.

1. Siirry kohtaan **Reagents (Reagenssit) > Manual operations (Manuaaliset toiminnot)**.
2. Aktivoi parafiinin kuumennin napauttamalla oikeaa **Disabled Paraffin heater (Parafiinin kuumennin pois päältä)** -painiketta (→ [Kuva 78-5](#)).
3. Napsauta vahvistusviestiin **OK**. Anna kuumentimen käydä vähintään viiden minuutin ajan.
4. Pysäytä kuumennin napauttamalla oikeaa **Enabled Paraffin heater (Parafiinin kuumennin päällä)** -painiketta.
5. Napsauta vahvistusviestiin **OK**.

### Tislusastioiden täyttäminen ja tyhjentäminen

Täytä (tai tyhjennä) tislusastia reagenssiasemassa käyttämällä **Manual operations (Manuaaliset toiminnot)** -näytön komentoja. Tislusastioiden manuaalista täyttämistä ja tyhjentämistä koskevat säännöt ja toimenpiteet ovat samat kuin silloin, kun toiminto suoritetaan **Reagents (Reagenssit) > Remote fill/drain screen (Etätäyttö/-tyhjennys -näytöltä)** (→ s. 128 – 7.4.6 Tislusastioiden täyttäminen ja tyhjentäminen).

## 8.2 Hallinnointivalikko


**Administration (Hallinnointi)**-valikossa voit suorittaa raportteja, tarkastella tapahtumalokeja ja muuttaa käyttäjätason asetuksia.

### 8.2.1 Käyttäjien hallinta

User management (Käyttäjien hallinointi) -näytöllä (Administration (Hallinointi) > User management (Käyttäjien hallinointi)) voit hallinnoida käyttäjätilejä.

#### Käyttäjätilin lisääminen/muokkaaminen/poistaminen

- ① Ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen (→ s. 57 – 5.1.3 Käyttöoikeustasot) järjestelmänvalvoja voi luoda Esihenkilö- ja Operaattori-tason tilejä.

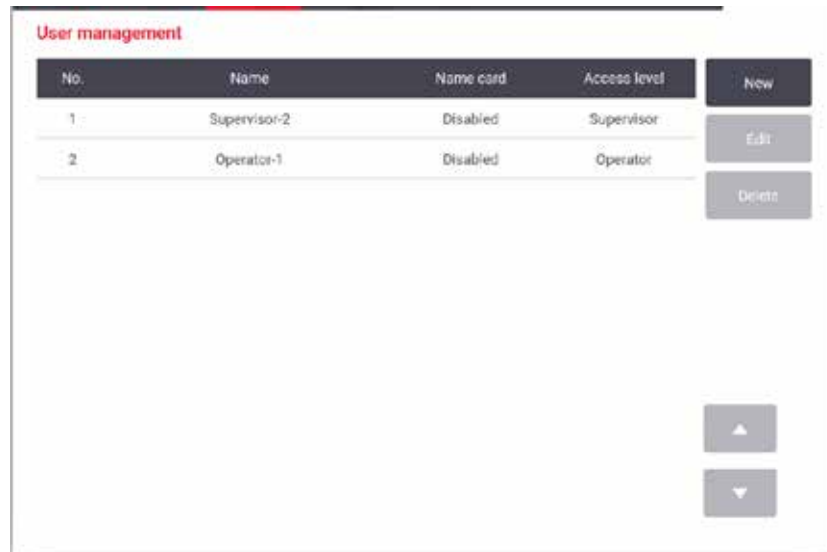

No.	Name	Name card	Access level	
1	Supervisor-2	Disabled	Supervisor	New
2	Operator-1	Disabled	Operator	Edit
				Delete

Kuva 79

Lisää uusi käyttäjätili näin:

1. Siirry User management (Käyttäjien hallinointi) -näytölle (Administration (Hallinointi) > User management (Käyttäjien hallinointi)).
2. Napauta **New (Uusi)**. Näkyviin tulee Add/Edit user (Lisää käyttäjä / muokkaa käyttäjää) -näyttö.
3. Syötä käyttäjänimi, salasana ja käyttäjätaso.
4. Ota nimikortti käyttöön skannaamalla viivakoodi. Luotu käyttäjä voi kirjautua sisään skannaamalla nimikortin viivakoodin. Jos nimikortti ei ole käytössä, luotu käyttäjä kirjautuu käyttäjänimellä ja salasanalla.
5. Napauta **OK**.

Muokkaa käyttäjätiliä näin:

1. Siirry User management (Käyttäjien hallinointi) -näytölle (Administration (Hallinointi) > User management (Käyttäjien hallinointi)).
2. Valitse käyttäjätili taulukosta ja napauta **Edit (Muokkaa)**. Näkyviin tulee Add/Edit user (Lisää käyttäjä / muokkaa käyttäjää) -näyttö.
3. Muokkaa käyttäjänimeä, salasanaa tai käyttäjätasoa tai ota nimikortti käyttöön tai poista se käytöstä.
4. Napauta **OK**.

Poista käyttäjätili näin:

1. Siirry **User management (Käyttäjien hallinnointi)** -näytölle (**Administration (Hallinnointi) > User management (Käyttäjien hallinnointi)**).
2. Valitse käyttäjätili taulukosta ja napauta **Delete (Poista)**.
3. Napauta **OK** vahvistusikkunassa.

Salasanojen / viivakoodin numeron muuttaminen

- ① Ylläpitäjä voi muuttaa kaikkien käyttäjätasojen salasanoja / viivakoodin numeroita. Esihenkilöt ja operaattorit voivat muuttaa vai omia salasanojaan / viivakoodiensa numeroita.

Vaihda ylläpitäjän salasanat näin:

1. Napauta käyttäjätunnuskuvaketta oikeassa yläkulmassa ja napauta **Switch user (Vaihda käyttäjää)**.
2. Näkyviin tulee **User login (Käyttäjän sisäänkirjautuminen)** -näyttö. Napauta **Other access (Muu käyttöoikeus)**.
3. Näkyviin tulee **Access level (Käyttäjätaso)**-näyttö. Napauta **Change password (Vaihda salasana)**.
4. Syötä nykyinen salasana, sitten uusi salasana kahdesti, ja napauta **OK**.

Vaihda esihenkilön tai operaattorin salasana / viivakoodin numero itse näin:

1. Kirjaudu sisään esihenkilönä tai operaattorina, napauta **Administrator (Ylläpitäjä) > User management (Käyttäjien hallinnointi)**.
2. Valitse oma tilisi ja napauta **Edit (Muokkaa)**.
3. Näkyviin tulee **Add/Edit user (Lisää käyttäjä / muokkaa käyttäjää)** -näyttö. Napauta salasanat / viivakoodin numero -kuvaketta.
4. Syötä uusi salasana ja viivakoodin numero ja napauta **OK**.

### 8.2.2 Raportit

**Administration (Hallinnointi) > Reports (Raportit)**-valikossa on saatavilla neljä raporttia:

- Suoritustiedot-raportti
- Käyttäjien toiminta -raportti
- Protokollien käyttö -raportti
- Reagenssien käyttö -raportti

Suoritustiedot-raportti

Tämä raportti sisältää tietoa tietyistä protokollan suorituksista. Kun se valitaan, ensin näytössä näkyy luettelo joko kaikista protokollan suorituksista, edeltävän kuukauden aikaisista tai edellisten 30 päivän aikaisista (→ [Kuva 80](#)). Valitse haluamasi aikaväli napauttamalla oikeassa laidassa olevaa painiketta.

**Protocol runs** Clear

End date	End time	Retort	Protocol name	#Cassettes	Started by
2021-09-04	07:17	Retort A	Test-1	150	Administrator
2021-09-04	06:45	Retort A	Test-1	150	Administrator
2021-09-04	06:23	Retort A	Test-1	150	Administrator
2021-09-04	05:58	Retort A	Test-1	150	Administrator
2021-09-04	03:38	Retort A	Test-1	10	Administrator
2021-09-04	03:30	Retort A	Test-1	200	Administrator

Last 30 Days  
August  
All  
Generate

▲  
▼

Kuva 80

Protokollaluettelossa voit tarkastella yhden tai useamman tietyn suorituskerran tietoja valitsemalla ne ja napauttamalla **Generate (Luo)**. **Run Details (Suoritustiedot)**-raportti tulee näkyviin ja siinä näkyvät tiedot kaikista valitsemistasi suorituskertoista (→ Kuva 81). Raportti sisältää aloitus- ja lopetusajan, käyttäjätunnuksen, tislusastian, kasettien lukumäärän, telinetunnukset, protokollavaiheet, aseman ja reagenssin (ja eränumeron, jos se on syötetty) jokaisessa vaiheessa sekä vaiheen keston. Kaikki protokollan aikana tapahtuneet erityistapahtumat tallennetaan.

**Run details report** PXXXX

standardprotocoltypeinvaliddate Invalidated

Run started	Run ended	User	Retort	#Cassettes
2021-06-08 06:48	2021-06-08 06:51	Administrator	Retort A	100

Basket 1: Basket 2:

Step	Station	Type	#Lot	Concentration	Duration(mins)
1	S4	85% Ethanol		85.0%	0s

Date	Time	Run stage	User	Event code	Message
2021-06-08	06:48	Step 1	Administrator	13	Protocol paused by user.
2021-06-08	06:49	Step 1	Administrator	4	protocol resumed.

Back  
Export  
▲  
▼

Kuva 81

Voit viedä suoritustiedot napauttamalla **Export (Vie)**. Jos USB-muistitikku ei ole syötetty, järjestelmä kehottaa syöttämään sellaisen. CSV-tiedoston voi tallentaa tietokoneelle ja avata Excelissä.

Käyttäjien toiminta -raportti

Tässä raportissa luetellaan käyttäjän toiminnot, jotka käyttäjätunnuksella on tehty kuluvan kuun aikana (→ [Kuva 82](#)). Tiedot voidaan järjestää ajan tai toiminnon mukaan. Käyttäjätunnus näytetään vain, jos raportti suoritetaan esihenkilötilassa.

Date	Time	User	Action
2021-06-08	13:53	Administrator	Protocol loaded - Biopsy Xylene with Retort A.
2021-06-08	13:53	Administrator	Protocol loaded - Quick Clean with Retort A.
2021-06-08	13:49	Administrator	Protocol resumed all
2021-06-08	13:48	Administrator	User pause - stanardprotocoltypeinvalidate with Retort_A
2021-06-08	13:48	Administrator	Started run - stanardprotocoltypeinvalidate with Retort A
2021-06-08	13:48	Administrator	Retort_A: set cassettes number:100
2021-06-08	13:48	Administrator	Retort_A: add baskets count:0
2021-06-08	13:48	Administrator	Try to record basket barcode and cassette image with Retort B
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol loaded - stanardprotocoltypeinvalidate with Retort A.
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol copied - Biopsy Xylene1234567890 from Biopsy Xylene
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol created - stationcleanvalid

Kuva 82

Voit viedä käyttäjän toimintotiedot napauttamalla **Export (Vie)**. Jos USB-muistitikku ei ole syötetty, järjestelmä kehottaa syöttämään sellaisen. CSV-tiedoston voi tallentaa tietokoneelle ja avata Excelissä.

Protokollien käyttö -raportti

Tässä raportissa luetellaan prosessisuoritusten ja kasettien lukumäärä sekä suorituskohtainen kasettien keskiarvo (→ [Kuva 83](#)). Tiedot voi järjestää päivän, viikon tai kuukauden mukaan.

Protocol and cassette report - preview

# Runs	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	6	0	0	0	0	0	0
Total	6	0	0	0	0	0	0

# Cassettes	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	2710	0	0	0	0	0	0
Total	2710	0	0	0	0	0	0

# Cassettes per run	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	451	0	0	0	0	0	0
Total	451	0	0	0	0	0	0

Monthly  
Weekly  
Daily  
Export

▲  
▼

Kuva 83

Voit viedä protokollien käyttötiedot napauttamalla **Export (Vie)**. Jos USB-muistitikku ei ole syötetty, järjestelmä kehottaa syöttämään sellaisen. Luotava tiedosto on Excelin kanssa yhteensopiva. Napauta **Done (Valmis)** tiedonsiirron päätyttyä.

### Reagenssien käyttö -raportti

Tässä raportissa luetellaan käytetyn reagenssin kokonaistilavuus vaihtokertojen seurannan perusteella (→ Kuva 84). Tietoja voi tarkastella päivän, viikon tai kuukauden mukaan.

Reagent change report - preview

Reagent(Ltr)	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Ethanol	3.5	0	0	0	0	0	0
Formalin	3.5	0	0	0	0	0	0

Monthly  
Weekly  
Daily  
Export

▲  
▼

Kuva 84

Voit viedä reagenssien käyttötiedot napauttamalla **Export (Vie)**. Jos USB-muistitikku ei ole syötetty, järjestelmä kehottaa syöttämään sellaisen. Luotava tiedosto on Excelin kanssa yhteensopiva. Napauta **Done (Valmis)** tiedonsiirron päätyttyä.

## 8.2.3 Tapahtumalokit

Tapahtumalokissa (**Administration (Hallinnointi) > Event logs (Tapahtumalokit)**) näkyy järjestelmän tapahtumahistoria. Tiedot voi järjestää ajan tai toistumistiheyden mukaan. Tapahtumia voi myös suodattaa sen mukaan, minkä tyyppisiä tapahtumia haluat tarkastella. Voit lisätä viestin ja tallentaa sen käyttäjätapahtumana.

Code	Time	Description
1000	2021-09-04 12:17	Protocol Test-1 in Retort A completed successfully in 2m 26s. 150 cassettes processed.
1000	2021-09-04 11:48	Protocol Test-1 in Retort A completed successfully in 2m 27s. 150 cassettes processed.
1000	2021-09-04 11:23	Protocol Test-1 in Retort A completed successfully in 2m 27s. 150 cassettes processed.
1000	2021-09-04 10:58	Protocol Test-1 in Retort A completed successfully in 2m 27s. 150 cassettes processed.
1207	2021-09-04 10:54	Instrument has recovered from temperature sensor fault. Heater tuned back on. Instrument is now operating normally. Disregard previous 1206 error.

Kuva 85

Ajan mukaan järjestetyssä näkymässä jokainen tapahtumakerta on järjestetty siten, että uusin tapahtuma on näytön ylälaidassa. Jokaisessa tapahtumassa on tapahtumatyyppin numero, tapahtuman vakavuuden värikoodi (→ s. 137 – [Tapahtuman vakavuus](#)), tapahtuman aika ja tapahtuman kuvaus.

Toistumistiheyden mukaan järjestetyssä näkymässä on yksi rivi kutakin tapahtumatyyppin lukumäärää kohden, esim. kaikki 1 000 ”protokollan suorittaminen onnistui” -tapahtumaa ovat yhdellä rivillä. Tapahtumien määrän lisäksi näytetään vakavuuden värikoodi ja kuvaus, tapahtumakertojen lukumäärä sekä tapahtuman ensimmäisen ja viimeisen kerran päivämäärä ja aika.

Vain huoltohenkilökunta voi tyhjentää tapahtumalokin.

- Näkymää voi vaihtaa napauttamalla **Show by time (Näytä ajan mukaan) / Show by frequency (Näytä toistumistiheyden mukaan)** -painiketta.
- Napauttamalla **On filter (Suodatin)**-painiketta avautuu **Configuration options ... (Määrittäsvaihtoehdot...)**-valintaikkuna, jossa voi valita tarkasteltavat tapahtumatyyppit. Valitsemalla painikkeita **Retort filter**, **Severity filters (Tislausastiasuodattimet-, Vakavuussuodattimet-)** ja **Alarm filters (Hälytysuodattimet-)** osioissa näet niihin liittyvät tapahtumatyyppit. Jokaisessa osiossa on valittava vähintään yksi painike, jotta tapahtumia näytetään. Jos valintasi on esimerkiksi **Retort A (Tislausastia A) Retort filter (tislausastiasuodattimessa)**, **Information (Tiedot) Severity filters (vakavuussuodattimessa)** ja **Non-alarmed events (Hälytyksettömät tapahtumat) Alarm filters (hälytysuodattimissa)**, näet kaikki tislausastian A tietotapahtumat, jotka eivät aiheuttaneet hälytystä.
- Luo käyttäjätapahtuma valitsemalla **Create user event (Luo käyttäjätapahtuma)**. Näyttönäppäimistö avautuu. Kirjoita tiedot, jotka haluat tallentaa, ja napauta **Enter (Syötä)**, niin viesti tallentuu tapahtumana. Tapahtuman vakavuus on ”Information (Tiedot)”.



### Tapahtuman vakavuus

Tapahtuman vakavuustasoja on kolme, joista jokaisella on oma värikoodi:


Värikoodi	Vakavuustaso	Kuvaus
Vihreä	Tiedot	Tavanomainen tapahtuma, joka edellyttää vastausta (esim. protokollan suorittaminen onnistui) tai epätavallinen tapahtuma, joka ei aiheuta haittaa (esim. käyttäjä keskeytti protokollan).
Oranssi	Varoitus	Virhe tai mahdollinen virhe, joka ei pysäytä käsittelyä, tai käyttäjän toimenpidepyyntö. Esimerkiksi protokollassa käytetään raja-arvojen ulkopuolella olevaa reagenssia.
Punainen	Virhe	Virhe, joka aiheuttaa toimenpiteen keskeytymisen (esim. koska asemaa ei ole käytettävissä) tai tekee osan laitteesta (esim. yhden tislusastian) tai koko laitteen käyttökeltottomaksi.

## 8.3 Asetusvalikko

Asetusnäytöllä voi tarkastella laite- ja ohjelmistotietoja, viedä ja tuoda tiedostoja, muuttaa joitakin laiteasetuksia ja hallinnoida hälytyksiä.

### 8.3.1 Huolto

Kohdassa **Settings (Asetukset) > Service (Huolto)** voi tarkastella laite- ja ohjelmistotietoja.

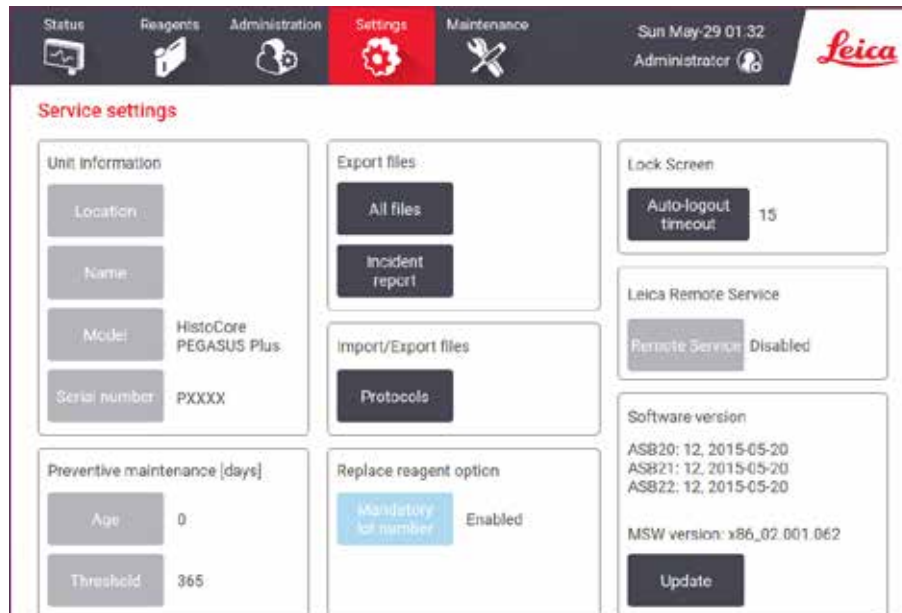

Kuva 86

**Unit information (Yksikön tiedot)** -alue näyttää instrumentin nimen, sijainnin, mallin ja sarjanumeron. Kaikki arvot ovat vain luku -tilassa.

**Preventive maintenance (Ennaltaehkäisevä huolto)** -alue näyttää edellisestä ennaltaehkäisevästä huollosta kuluneen ajan ja seuraavan huoltovälin.

**Replace reagent option (Reagenssien vaihdon asetukset)** -alue näyttää **Mandatory lot number (Pakollinen eränumero)** -asetuksen tilan, joka voi olla joko Käytössä tai Pois käytöstä. Jos **Mandatory lot number (Pakollinen eränumero)** -asetus on käytössä, reagenssin eränumero on pakollinen reagenssia vaihdettaessa.

**Lock screen (Lukitusnäyttö)**-alue näyttää nykyisen automaattisen uloskirjautumisajan. Esihenkilöt voivat muuttaa tätä aikaa.

**Leica Remote Service (Leica-etähuolto)**-alue näyttää **Remote Service (Etähuolto)**-palvelun saatavuuden. Kun instrumentti on yhdistetty etähuoltopalveluun, se lähettää aktiivisesti tapahtumatietoja etäpalvelimelle. Määritä verkkoyhteys (→ s. 143 – [Verkko](#)), jotta voit hyötyä Leica Biosystemsin optimoidusta huoltopalvelusta.

Ohjelmistoalueella näkyvät nykyisen ohjelmistoversion numerot. Ohjelmistoversiota saatetaan tarvita virheilmoituksessa. Esihenkilöt voivat päivittää ohjelmiston napauttamalla **Update (Päivitä)**-painiketta.

### Vie tiedostoja

**Service (Huolto)**-näytön Vie tiedostoja -vaihtoehtojen avulla voit kopioida protokollatiedostoja, onnettomuusraportteja ja lokitiedostoja USB-muistitikulle. Voit myös tuoda protokollatiedostoja USB-muistitikulta.

Kaikki käyttäjät – operaattorit ja esihenkilöt – voivat siirtää tiedostoja.

Alla on kuvattu käytettävissä olevat tiedostonsiirtovaihtoehdot:

- Kaikki tiedostot – valitse tämä, jos haluat viedä kaikki tiedostot järjestelmästä USB-muistitikulle. Valitse aikaväli ja tiedostotyyppi ponnahdusikkunassa ja napauta sitten **OK**.
- Onnettomuusraportti – valitse tämä, jos haluat luoda ja viedä onnettomuusraportin.
- Protokollat – valitse tämä, jos haluat siirtää mukautettuja protokollia järjestelmästä USB-muistitikulle tai toisinpäin. Toimenpide kuvaillaan tarkemmin seuraavassa osiossa.

### Protokollien siirtäminen

① Operaattorit voivat ainoastaan viedä protokollia.

1. Aseta USB-muistitikku näytön vasemmalla puolella olevaan USB-porttiin. On tärkeää, että USB-muistitikku syötetään toimenpiteen alussa, muuten sen sisältöä ei välttämättä tunnisteta.
2. Napauta **Settings (Asetukset) > Service (Huolto) > Protocols (Protokollat)**. Avautuvalla näytöllä näkyvät paikalliset protokollat (eli käyttäjän määrittämät protokollat laitteessa) ja etäprotokollat (eli käyttäjän määrittämät protokollat USB-muistitikun juurikansiossa, jos sellaisia on). Muistitikun hakemistoihin tallennettuja protokollia ei huomioida.
3. Varmista, että protokollaluettelot ovat ajan tasalla, napauttamalla **Refresh (Päivitä)**.
4. Jos haluat kopioida kaikki käyttäjän määrittämät protokollat laitteelta muistitikulle, napauta **Export all (Vie kaikki)**.
5. Jos haluat kopioida yhden käyttäjän määrittämän protokollan laitteelta muistitikulle, valitse se **Local protocols (Paikalliset protokollat)** -luettelosta ja napauta **Export (Vie)**.
6. Jos haluat kopioida kaikki protokollat muistitikulta laitteelle, napauta **Import all (Tuo kaikki)**.
7. Jos haluat kopioida yhden käyttäjän määrittämän protokollan muistitikulta laitteelle, valitse se **Remote protocols list (Etäprotokollat)**-luettelosta ja napauta **Import (Tuo)**.
8. Napauta lopuksi **Done (Valmis)**.

## 8.3.2 Käsittelyasetukset



## Varoitus

RMS (reagenssinhallintajärjestelmä) on asetettu arvoon N/A tai virheelliseen arvoon.

**Reagenssin kulutustilaa ei voida valvoa, mikä voi vaikuttaa kudosten käsittelyn laatuun ja vaurioittaa näytteitä.**

- Älä aseta RMS-järjestelmää arvoon N/A. Käytä RMS-järjestelmää reagenssin kulutustilan seuraamiseen.
- RMS-asetukset on validoitava käyttäjän toimesta ennen protokollan ajamista, eli potilaan kudosten käsittelyä diagnostiikkaa varten, paikallisten tai alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti.

Processing settings (Käsittelyasetukset)-näytöllä (Settings (Asetukset) > Processing settings (Käsittelyasetukset)) esihenkilöt voivat tehdä seuraavaa:

- ottaa käyttöön / pois käytöstä kasettien lukumääräkehotteen ennen käsittelyprotokollan suorittamista
- asettaa kasettien oletuslukumäärän suoritusta kohden
- asettaa oletussiirtymäarvon
- käynnistää tai sammuttaa parafiinin puhdistuksen
- asettaa oletusarvoisen puhdistusprotokollan
- asettaa parafiinin odotus- ja sulamispistelämpötilat
- ottaa käyttöön / pois käytöstä parafiinin puhdistustoiminnon
- Aseta parafiinityyppi

The screenshot displays the 'Processing settings' screen in the Leica RMS software. The top navigation bar includes 'Status', 'Reagents', 'Administration', 'Settings' (highlighted in red), and 'Maintenance'. The date and time are 'Mon Feb-27 05:39' and the user is 'Administrator'. The Leica logo is in the top right corner.

The main content area is titled 'Processing settings' and is divided into several sections:

- General:**
  - Conc. management: By concentration
  - Prompt for number of cassettes: Enabled
  - Default number of cassettes: 150
  - Default carryover: 25
  - Default clean protocol: Quick Clean
- Retorts:**
  - Last reagent in retort A
  - Last reagent in retort B
  - Fill state in retort A: Clean
  - Fill state in retort B: Clean
  - Empty access temp.: <75 °C
- Global settings:**
  - Paraffin standby temp: 65 °C
  - Paraffin melting point: 56 °C
- Paraffin bath settings:**
  - Paraffin cleaning: Disabled
  - Paraffin Type
- Reagent threshold check:**
  - By cassette: Enabled
  - By cycles: Enabled
  - By days: Enabled
  - By conc.: Enabled

Kuva 87

Osaa määrittäsvaihtoehtoista voidaan tarkastella mutta ei muuttaa. Jos haluat muuttaa niitä, ota yhteyttä asiakastukeen. Näytöllä näkyy lisäksi kunkin tislauksastian tila ja viimeisin reagenssi.

**Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytöllä olevat ohjaustoiminnot on kuvattu alla osioittain.

### Yleistä

- **Pitoisuuden Management (Hallinta)**: menetelmä, jonka avulla järjestelmä määrää pitoisuusarvot reagenssipulloille (→ s. 103 – 7.1.2 Pitoisuuksien hallinta).
- **Prompt for number of cassettes (Kasettien lukumääräkehote)**: oletusasetuksella (**Enabled (Käytössä)**) järjestelmä kehottaa syöttämään kasettien lukumäärän ennen jokaista suorituskertaa. Kun toiminto poistetaan käytöstä, järjestelmä olettaa, että jokaisella suorituskerralla käsitellään oletusarvoinen määrä kasetteja.
- **Default number of cassettes (Kasettien oletusmäärä)** – aseta kasettien oletuslukumäärä suorituskertaa kohden Jos **Prompt for number of cassettes (Kasettien lukumääräkehote)** on käytössä, kehoteikkuna avautuu ennen jokaista suorituskertaa, ja siinä näkyy tämä numero. Numeron voi hyväksyä tai sitä voi muuttaa. Jos **Prompt for number of cassettes (Kasettien lukumääräkehote)** ei ole käytössä, järjestelmä käyttää tähän syötettyä kasettien lukumäärää kaikilla suorituskertoilla. Varmista tällöin, että syötetty keskiarvo on tarkka. Lukua käytetään reagenssipitoisuuksien laskemiseen reagenssinhallintajärjestelmässä.
- **Default carryover (Oletussiirtymä)** – uusissa protokollissa käytettävä oletusarvoinen siirtymäasetus (→ s. 91 – 6.1.5 Siirtymäasetus).

### Reagenssien raja-arvotarkistus

**Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytön **Reagent threshold check (Reagenssien raja-arvotarkistus)** -osiossa olevat neljä painiketta osoittavat, minkä tyyppisiä reagenssin raja-arvoja järjestelmä käyttää (→ s. 104 – 7.1.3 Raja-arvot). Oletusarvona kaikki neljä raja-arvotyyppiä ovat käytössä. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, ota yhteyttä asiakastukeen.

- **By cassettes (Kasetit)** – järjestelmä seuraa reagenssin kussakin asemassa käyttämien kasettien lukumäärää. Jos reagenssityypille on asetettu kasettiraja-arvo, sen ylittäminen asemassa aiheuttaa hälytyksen.
- **By cycles (Syklit)** – järjestelmä seuraa reagenssin kussakin asemassa suorittamien syklien lukumäärää. Jos reagenssityypille on asetettu syklijära-arvo, sen ylittäminen asemassa aiheuttaa hälytyksen.
- **By days (Päivät)** – järjestelmä seuraa reagenssin kussakin asemassa viettämien päivien lukumäärää. Jos reagenssityypille on asetettu päivien raja-arvo, sen ylittäminen asemassa aiheuttaa hälytyksen.
- **By conc. (Pitoisuus)** – järjestelmä seuraa reagenssin pitoisuutta kussakin asemassa. Jos reagenssityypille on asetettu pitoisuusraja-arvo, sen ylittäminen asemassa aiheuttaa hälytyksen.

### Tislauksastiat

**Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytön **Retorts (Tislauksastiat)**-osiossa näkyvät kunkin tislauksastian tila ja viimeksi käytetty reagenssi. Siinä näkyy myös tyhjäkäytön lämpötila (eli enimmäislämpötila, jossa tyhjä tislauksastia on turvallista avata). Järjestelmä varoittaa, jos aloitat toiminnon, joka edellyttää tislauksastian avaamista silloin, kun sen sisälämpötila ylittää tämän arvon.

### Parafiinialtaan asetukset

Parafiinin puhdistaminen voidaan käynnistää tai sammuttaa **Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytön **Paraffin cleaning (Parafiinin puhdistus)** -painikkeella. Parafiinin puhdistamistoiminto parantaa parafiinin laatua tyhjentämällä parafiinialtaan säännöllisesti (noin 30 sekunnin ajaksi) ja poistamalla mahdolliset epäpuhtaudet. Toisinaan on lisättävä vähän parafiinia poistettujen liuottimien tilalle.

- Ota parafiinin puhdistaminen käyttöön protokollissa, joissa käytetään ksyleeniä ja/tai IPA:ta.
- Ota parafiinin puhdistaminen pois käytöstä protokollissa, joissa ei käytetä IPA:ta, sillä tällöin kirkastajia ei saada tehokkaasti poistettua tyhjennystoimenpiteellä.

Parafiinin puhdistaminen lisää parafiinipitoisuuksia poistamalla epäpuhtauksia. Järjestelmä päivittää kunkin parafiiniaseman pitoisuuden automaattisesti jokaisen parafiinin puhdistussyklin jälkeen.



#### Huomaa

- Parafiinin puhdistaminen saattaa viivästyttää protokollan tai muun toiminnon aloitusta jopa 30 sekunnilla.

**Paraffin type (Parafiinityypiksi)** voidaan asettaa **Recommended (Suositeltava)** tai **Not Recommended (Ei suositeltava)**.

- Aseta parafiinityypiksi **Recommended (Suositeltava)** suositelluille parafineille (→ s. 107 – 7.1.4 **Suosittelut reagenssit**). Sulamisaika on alle 7 tuntia.
- Aseta parafiinityypiksi **Not Recommended (Ei suositeltava)** muille parafineille. Sulamisaika on alle 9 tuntia.

### Yleiset asetukset

Parafiinin sulamis- ja odotuslämpötilat asetetaan **Processing settings (Käsittelyasetukset)**-näytön **Global settings (Yleiset asetukset)** -osiossa.

- Parafiinin odotuslämpötila on lämpötila, johon laite kuumentaa parafiinin parafiiniasemilla. Oletuslämpötila 65 °C.
- Parafiinin sulamislämpötila on lämpötila, jossa parafiini laitteen mukaan on sulaa. Oletuslämpötila 56 °C.

#### 8.3.3 Laiteasetukset

**Instrument settings (Laiteasetukset)**-näytöllä (**Settings (Asetukset) > Instrument settings (Laiteasetukset)**) voit määrittää aktiivihiihisuodattimen iän ja raja-arvot, päivämäärä- ja kellonaikanäytön, manuaalisten toimintojen manuaalisen tyhjennyksen valumisajan ja verkon asetukset. Kaikkiin toimintoihin tarvitaan esihenkilön käyttöoikeus.

Laitteen voi myös sammuttaa tällä näytöllä. Muita **Instrument settings (Laiteasetukset)**-näytön asetuksia voi tarkastella, mutta vain huoltohenkilöstö voi muuttaa niitä.



Kuva 88

### Aktiivihiilisuodattimen asetukset

Napauttamalla **Carbon filter age (Hiilisuodattimen ikä)** -painiketta voit nollata aktiivihiilisuodattimen iän nollaan päivään. Tämä kannattaa tehdä aktiivihiilisuodattimen vaihtamisen yhteydessä, jotta järjestelmä voi seurata suodattimen ikää ja antaa varoituksen, kun suodattimen ikäraja-arvo ylittyy.

Napauttamalla **Carbon filter threshold (Hiilisuodattimen raja-arvo)** -painiketta voit asettaa päivien lukumäärän, jonka jälkeen käytössä oleva suodatin on vaihdettava. Oikea raja-arvo riippuu päivittäin suoritettavien protokollien lukumäärän keskiarvosta ja käytetyistä reagenssityypeistä. Suosittelemme aloittamaan 60 päivän raja-arvolla ja muuttamaan sitä vain, jos olet varma, että aktiivihiilisuodatin kyllästyy aikaisemmin tai on vielä hyvässä kunnossa tämän ajan jälkeen.

Jos käytössä on ulkoinen ilmanpoistojärjestelmä, aseta aktiivihiilisuodattimen raja-arvo johonkin seuraavista:

- ulkoisen järjestelmän tarkastusväli
- enimmäisarvo (365), jolloin vältytään ylimääräisiltä varoituksilta
- ohitettu (ota yhteyttä huoltoedustajaan, joka voi asettaa tämän vaihtoehdon)

### Manuaalisen tyhjennyksen valumisaika

Esihenkilöt voivat muuttaa manuaalisten tyhjennystoimintojen valumisajan. Valumisaika on aika, jonka järjestelmä odottaa reagenssien valumista kaseteista ja tislusastian seinämistä ennen tyhjennystoiminnon suorittamista loppuun.

Napauta **Manual drain drip time (Manuaalisen tyhjennyksen valumisaika)** -painiketta, syötä haluttu sekuntimäärä ja napauta **OK**.

### Laitteen sammuttaminen

Napauttamalla **Exit software (Poistu ohjelmistosta)** voit sammuttaa laitteen järjestelmällisesti. Kun kosketusnäyttö pimenee, sulje laite punaisesta virtapainikkeesta.

### Aika ja päivämäärä

Vain esihenkilöt voivat muuttaa järjestelmän aikaa.

- Jos haluat muuttaa aika- ja päivämäärämuotoja, napauta **Set time format (Aseta aikamuoto)** ja napauta sitten muotoa, johon haluat vaihtaa. Muokkaa muita muotoja tarpeen mukaan ja napauta sitten **Done (Valmis)**.
- Jos haluat muuttaa järjestelmän aikaa, napauta **Set time (Aseta aika)**, vieritä ylös ja alas, kunnes aika on oikea, ja napauta sitten **OK**.

### Kieli- ja yksikköasetukset

Esihenkilö voi muuttaa kieliasetuksia. Napauta **Change language (Vaihda kieltä)** ja valitse tarvitsemasi kieli. Muuta instrumentin yksikköasetuksia napauttamalla **Temp. (Lämpötila)** tai **Pressure (Paine)**.

### Ääniasetukset

Esihenkilöt voivat valita äänet, jotka kuuluvat tieto-, varoitus- ja virheviesteistä. Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen on myös mahdollista.

- Jos haluat vaihtaa viestityypin ääntä, napauta Viestin tyyppi -painiketta **Sound settings (Ääniasetukset)**-taulukossa. Valitse äänitiedosto **Select a sound from the following list (Valitse ääni luettelosta)**-valintaikkunassa ja napauta **OK**. Jos haluat kuunnella äänen **Select a sound from the following list (Valitse ääni luettelosta)**-valintaikkunassa, valitse ääni ja napauta **Play (Toista)**.
- Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, napauta **Master volume (Pää-äänenvoimakkuus)**.

### Verkko

Muodosta yhteys etähuoltoon ensimmäisen kerran ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.

Esihenkilöt voivat muodostaa/katkaista instrumentin yhteyden Leica-etähuoltoon, jos **Leica Remote Service (Leica-etähuolto)** on otettu käyttöön **Service settings (Huoltoasetukset)**-näytön kautta (→ s. 137 – 8.3.1 **Huolto**). Varmista ennen yhteyden määrittämistä, että instrumentti on yhdistetty verkkoon instrumentin takapuolella sijaitsevaa Ethernet-porttia käyttämällä. Määritä verkko napauttamalla **IP settings (IP-asetukset)**-painiketta ja napauta sitten **Remote Service (Etähuolto)**. Yhteyden tila näkyy **Remote Service (Etähuolto)**-painikkeen vieressä.

## 8.3.4 Seurantavaihtoehdot



Kuva 89

**Tracking options (Seurantavaihtoehdot)**-näytöllä (**Settings (Asetukset) > Tracking options (Seurantavaihtoehdot)**) voit ottaa käyttöön / pois käytöstä **Track basket (Seuraa telinettä)**-, **Recommended protocol (Suositeltava protokolla)**- ja **Camera function (Kameratoiminto)**-toiminnot.

Seuraa telinettä

Kun **Track basket (Seuraa telinettä)** -toiminto on käytössä, voit syöttää telineiden nimet (→ [Kuva 90-1](#)) (→ [Kuva 90-3](#)) skannaamalla tai kirjoittamalla telineiden viivakoodit samalla, kun telineet lisätään tislusastioihin.

Suosittelava protokolla

Esihenkilöt voivat luoda yhteyden telineen viivakoodin ja suositeltavan protokollan välille. Protokollan on oltava validoitu. Puhdistusprotokollaa ei voi valita suositeltavaksi protokollaksi.

Suosittelavan protokollan voi yhdistää useisiin telinetunnuksiin. Telineetunnuksella voi olla vain yksi yhteys yhteen suositeltavaan protokollaan. Järjestelmä vertaa ladattua protokollaa suositeltavaan protokollaan automaattisesti telineen viivakoodin mukaan, kun teline ladataan. Jos ladattu protokolla ei ole sama kuin suositeltava protokolla tai kaksi ladattua protokollaa eivät ole samat, varoitusviesti tulee näkyviin ja ladattu protokolla on vahvistettava tai vaihdettava.

Lisää uusi suositeltava protokolla näin:


1. Napauta **New (Uusi)**-painiketta.
2. Täytä telineen ja protokollan tiedot, mukaan lukien telineen tunnus, väri, protokollan nimi ja kudostyyppi.
3. Napauta **OK**.



Jos haluat muokata suositeltavaa protokollaa, napauta ruutua, jonka haluat päivittää ja tee muutokset.

Jos haluat poistaa suositeltavan protokollan, valitse protokolla napauttamalla protokollan **No. (Nro)**-ruutua ja napauta **Delete (Poista)**.

### Kameratoiminto

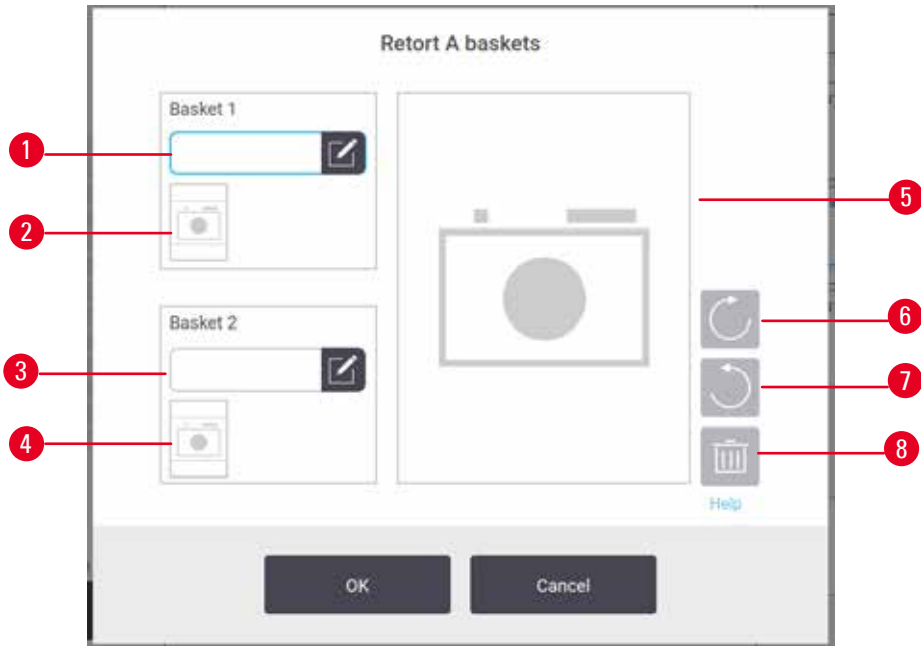

Kuva 90

Kun **Camera function (Kameratoiminto)** on käytössä, telineistä voi ottaa kuvia (→ [Kuva 90-2](#)) (→ [Kuva 90-4](#)), kun telineen viivakoodi on skannattu telineiden tislaukseen lisäämisen yhteydessä. Kuvanäkymää (→ [Kuva 90-5](#)) voi muuttaa kääntöpainikkeiden avulla myötäpäivään (→ [Kuva 90-6](#)) ja vastapäivään (→ [Kuva 90-7](#)). Kuvan voi poistaa (→ [Kuva 90-8](#)) ja ottaa uudelleen tarvittaessa.

## 9. Puhdistus ja kunnossapito



### Varoitus

Sopimattomien varusteiden käyttö huollon aikana.

**Henkilövahinko – käyttäjän loukkaantuminen kuuman pinnan, terävän reunan, jäännösten tms. vuoksi.**

- Käytä huollon aikana henkilönsuojaimia.

Noudattamalla tässä luvussa kuvattuja huolto- ja puhdistusohjeita laite pysyy hyvässä toimintakunnossa. Tämä auttaa varmistamaan aina laadukkaan käsittelyn ja välttämään tarpeettomia huoltokäyntejä.

Huolehdi, että laite on aina päällä – myös silloin, kun sitä ei käytetä. Tällöin parafiini pysyy sulana ja ohjelmisto voi suorittaa ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä.

Leica Biosystems suosittelee ennaltaehkäisevää huoltokäyntiä kerran vuodessa. Ota yhteyttä huoltoedustajaan ja sovi käynnistä.

Älä käytä mitään puhdistusmateriaaleja tai -menetelmiä, joita ei ole kuvattu tässä luvussa. Muiden materiaalien ja menetelmien käyttö voi vahingoittaa laitetta.

### 9.1 Puhdistus- ja huoltotyökalut

Puhdistus- ja huoltotyökaluja voidaan säilyttää työkalutelineessä (→ [Kuva 1-11](#)). Näihin kuuluvat seuraavat:

- parafiinikaavin
- tasoanturiharja
- parafiinialtaan ilmanvaihtotulppa

#### 9.1.1 Parafiinikaavin

Parafiinikaapimella voidaan kaapia parafiinia parafiinialtaan kannen tiivisteistä ja altaan päältä.

#### 9.1.2 Tasoanturiharja

Tasoanturiharja voidaan asettaa anturin sisäpuolelle ja harjata kevyesti, jolloin anturin kaikki puolet puhdistuvat roskista.




Kuva 91

### 9.1.3 Parafinialtaan ilmanvaihtotulppa

Parafinialtaan ilmanvaihtotulppa voidaan asettaa parafinialtaan ilmanvaihtoaukkoon. Tämä estää parafiinia joutumasta laitteen sisään parafinialtaan yläpinnan puhdistuksen yhteydessä.

## 9.2 Huoltonäyttö

**Maintenance (Huoltonäytöllä)** on mahdollisuus tallentaa rutiinihuoltotoimenpiteet ja niiden ajoitus.

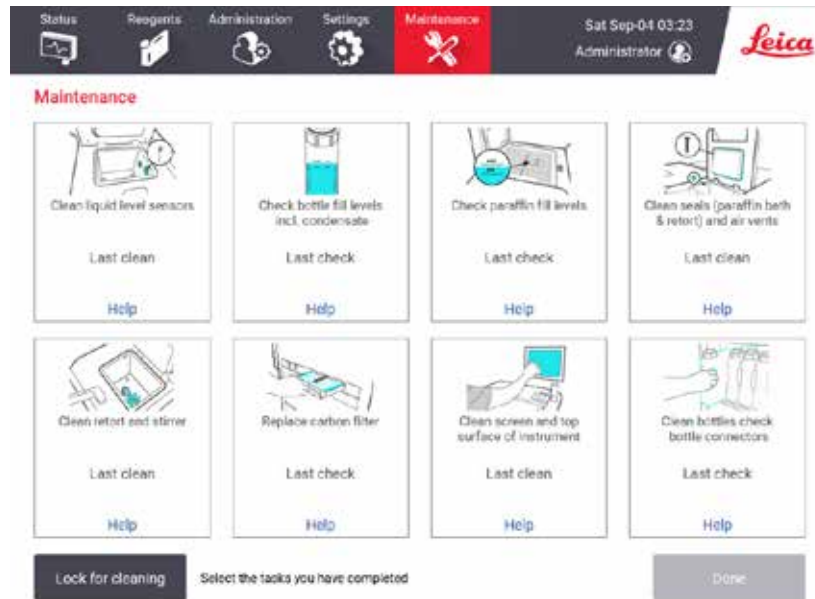

Kuva 92

**Maintenance (Huoltonäytöllä)** kahdeksan paneelia koostuvat seuraavista:

- kuva laitteesta, jossa osoitetaan tarvittava toimenpide (toisinaan sinisellä korostettuna)
- nimike
- merkintä edellisestä tarkistuksesta tai puhdistuksesta ja sen suorittanut käyttäjä
- linkki aiheeseen liittyviin ohjeisiin

Tallenna huoltotoimenpide näin:

- napauta huoltotoimenpidettä, jonka olet suorittanut tai aiot suorittaa
- napauta **Done (Valmis)**.

Tallennetut huoltotoimenpiteet ovat nähtävissä **User action (Käyttäjien toiminta)** -raportissa (**Administration (Hallinnointi) > Reports (Raportit) > User action (Käyttäjien toiminta)**).

### Näytön huolto

Lukitse ruutu napauttamalla **Lock for cleaning (Lukitse puhdistuksen ajaksi)** -painiketta. Näytön puhdistusikkuna avautuu. Näytön voi turvallisesti puhdistaa ilman, että vahingossa painaa valintapainikkeita, kun tämä ikkuna on avoinna.

Kun olet valmis, napauta näytön puhdistusikkunan painikkeita oikeassa järjestyksessä. Tällöin näytön lukitus poistuu ja se palautuu normaaliin toimintaan.

## **9.3 Puhdistus- ja huoltoaikataulu**

Katso säännölliset puhdistus- ja huoltotoimenpiteet ja niiden suoritustiheys alla olevasta luettelosta.

Alla oleva taulukko on viikoittainen huolto- ja puhdistuslista, jonka voit tulostaa ja johon voit tallentaa huoltotoimenpiteet. Merkitse taulukon ruudut sitä mukaa, kun tehtävät suoritetaan.

### Päivittäin

- puhdista kannet ja tiivisteet
- puhdista tislauksastiat ja nestetasoanturit
- tarkista pullojen täyttötasot (myös kondensaatiopullo)
- tarkista parafiinin täyttötasot
- puhdista kosketusnäyttö ja yläpinta
- tarkista tippa-astia

### Viikoittain

- tyhjennä kondensaatiopullo
- puhdista reagenssipullot ja tarkista pullojen liittimet
- tarkista parafiinialtaat
- puhdista ulkopinnat

### 60–90 päivän välein

- vaihda aktiivihiilisuodatin
- tarkista kansien tiivisteet

## Huoltolista

Viikko:					Sarjanro:									
	Ma		Ti		Ke		To		Pe		La		Su	
Pvm:														
<b>Joka päivä</b>														
puhdista kannet ja tiivisteet														
Puhdista tislauksastiat														
Puhdista nestetasoanturit														
Tarkista reagenssitaset	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V	Nimikirjaimet	OK/ T/V
Tarkistettu = OK, Täytetty = T														
Vaihdettu = V														
Pullo 1														
Pullo 2														
Pullo 3														
Pullo 4														
Pullo 5														
Pullo 6														
Pullo 7														
Pullo 8														
Pullo 9														
Pullo 10														
Pullo 11														
Pullo 12														
Pullo 13														
Pullo 14														
Pullo 15														
Pullo 16														
Pullo 17														
Parafiini 1														
Parafiini 2														
Parafiini 3														
Parafiini 4														
Puhdista yläpinta														
Puhdista kosketusnäyttö														
tarkista tippa-astia														
<b>Joka viikko</b>														
tyhjennä kondensaatiopullo														
Tarkista reagenssipullot														
Puhdista parafinialtaat														
Tarkista pullojen liittimet														
puhdista ulkopinnat														
<b>60–90 päivän välein</b>														
vaihda aktiivihilisuodatin														
tarkista kansiin tiivisteet														

### 9.3.1 Joka päivä

Puhdista tiivisteet (parafiiniallas ja tislauastia) ja ilmanvaihtoaukot

Käytä mukana toimitettua muovista kaavinta ja kaavi parafiini pois tislauastian ja parafiinialtaan kannen sisäpinnoilta. Vaihda vaurioituneet tiivisteet (→ s. 158 – Tarkista kansien tiivisteet).


Kaavi tislauastian reunojen ympäriltä ja parafiinialtaan kansien ympäriltä laitteen päällä. Tarkista, että kannet sulkeutuvat tiiviisti.

Tarkista, että parafiinialtaan vasemman kannen alla oleva takareunan ilmanvaihtoaukko (→ Kuva 93-1) on puhdas parafiinista. Sulje ilmanvaihtoaukko parafiinialtaan ilmanvaihtotulpalla puhdistuksen ajaksi. Tämä estää parafiinia joutumasta ilmanvaihtoaukkoon.




Kuva 93

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

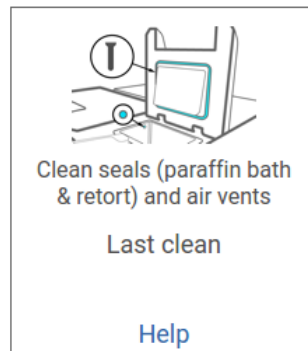

Kuva 94


Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**.

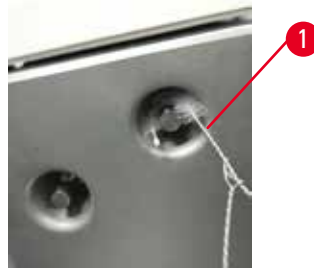Puhdista nestetasoanturit

Kuva 95

Puhdista nestetasoanturit (→ Kuva 97-2) joka päivä. Käytä puhdistukseen nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu 70-prosenttisella etanolilla. Kostuta nestetasoanturin puhdistusharjan kärki (→ Kuva 95-1) etanolilla. Aseta tasoanturiharja anturin sisäpuolelle ja harjaa kevyesti (→ Kuva 95). Varmista, että anturi on puhdas joka puolelta. Erityisen likaisille antureille voidaan käyttää 6-prosenttista etikkahappoliuosta etanolin sijasta.

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

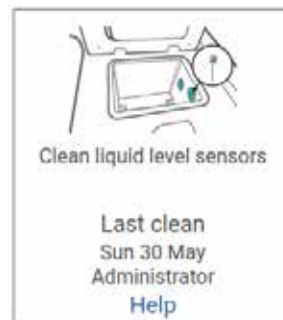

Kuva 96

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**.

## Puhdista tislusastia ja sekoitin



Kuva 97

- Puhdista tislusastian seinämät joka päivä. Käytä puhdistukseen nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu 70-prosenttisella etanolilla.
- Varmista, että ilma-aukko (→ Kuva 97-1) ei tukkiudu.
- Jos tahrat eivät lähde etanoliliuoksella, käytä nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu 6-prosenttisellä etikkahapolla tai CLR®:llä. Pyyhi pinnat uudelleen etanolilla.
- Tarkista tislusastian siivilä (→ Kuva 97-3). Jos se on likainen,
  - a. irrota tislusastian siivilä kiertämällä sitä ylöspäin
  - b. pese se huolellisesti 70-prosenttisessä etanoliliuoksessa
  - c. kierrä se takaisin paikalleen.

**Varoitus**

Tukos, joka aiheutuu tislusastiasta poistuneista kaseteista/kudoksista tai reagenssien tai parafiinin epäpuhtauksista


**Näytteiden vauriot**

- Käytä käsittelyn aikana telineitä. Älä aseta näytteitä suoraan tislusastiaan.
- Tarkista ennen protokollan ajamista, että tislusastian pohjalle on asennettu siivilä.
- Varmista, ettei tislusastiaan pääse putoamaan mitään, kun tislusastian siivilä poistetaan. Putkissa olevat vierasesineet voivat estää venttiilien oikean toiminnan.

- Tarkista sekoitin (→ Kuva 97-4). Jos se on likainen, nosta se pois ja puhdista se 70-prosenttisellä etanolilla. Jos se on vioittunut, ota yhteyttä huoltoedustajaan ja pyydä uusi sekoitin.

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:



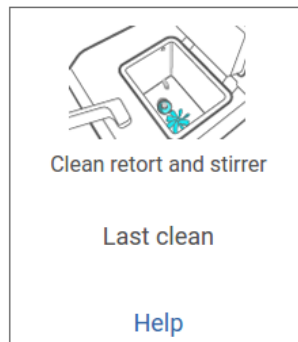

Kuva 98

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help** (Ohje).

tarkista pullojen täyttötasot (myös kondensaatiopullo)

Varmista, että kaikki reagenssipullot on täytetty **MIN**- ja **MAX**-merkintöjen välille. Lisää reagenssia tarvittaessa (→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen). Älä täytä **MAX**-merkinnän yläpuolelle.

Tyhjennä kondensaatiopullo, jos se on enemmän kuin puoliksi täynnä.

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance** (Huoltonäytöllä) napauttamalla sopivaa paneelia:




Kuva 99

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help** (Ohje).

### tarkista parafiinin täyttötasot

Varmista, että kaikki parafinialtaat on täytetty **MIN**- ja **MAX**-merkkien välille. Lisää parafiinia tarvittaessa (→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen). Älä täytä **MAX**-merkin yläpuolelle.

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

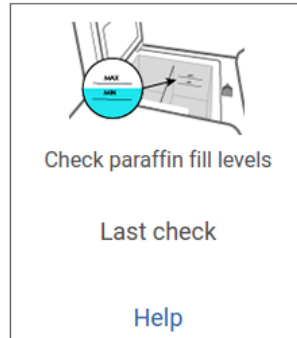


Kuva 100

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**.

### Puhdista laitteen näyttö ja yläpinta

Lukitse kosketusnäyttö ennen puhdistamista napauttamalla **Lock for cleaning (Lukitse puhdistuksen ajaksi)**. Pyyhi kosketusnäyttö (tai näytön suoja) nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 70-prosenttisellä etanolilla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai voimakkaita liuottimia kosketusnäytöllä.

Käytä nukkaamatonta liinaa ja 70-prosenttista etanolia ja tarvittaessa muovista kaavinta, jolla voit puhdistaa kannot ja laitteen muut yläpinnat. Varmista parafiinikaapimella, että kaikki parafiini on poistettu. Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

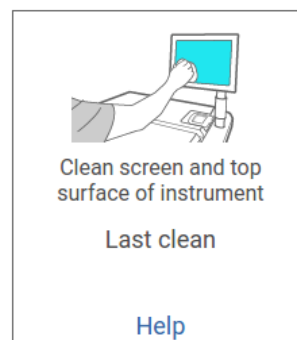

Kuva 101

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**:

### 9.3.2 Joka viikko

#### puhdistusta reagenssipullot ja tarkista pullojen liittimet

Tarkista kaikki pullot joka viikko. Huomioi likaantuvat pullot. Puhdista pullot seuraavan reagenssin vaihtamisen yhteydessä.

Kun pullot on poistettu, pyyhi reagenssikaapin sisäpuoli 70-prosenttisellä etanolilla.

Puhdista pullot kaatamalla vähän tuoretta reagenssia (eli sitä reagenssia, johon pulloa käytetään), sulje aukot ja ravista. Sulje pullo Leica Biosystems -tiivistekorkeilla. Tyhjennä pullo ja tarkista, että se on puhdas. Jos se on puhdas, täytä ja aseta pullo takaisin laitteeseen. Ohjeet aseman ominaisuuksien uudelleenasetukseen ovat kohdassa ([→ s. 120 – 7.4 Reagenssien vaihtaminen](#)).

Jos pullossa on yhä tahroja, puhdista se pulloharjalla ja laboratoriopuhdistusaineella. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Valmistele pullo uudelleentäytettäväksi reagenssilla:

- Formaliini- ja etanolipullot (joissa reagenssi on vesiliukoista) huuhdellaan pienellä määrällä pullon reagenssia veden poistamiseksi ja täytetään sitten.
- Kirkastus- ja puhdistusliuotinpullot (esim. ksyleeni, jossa reagenssi ei ole vesiliukoista) kuivataan huolellisesti ennen tuoreen reagenssin lisäämistä tai huuhdellaan pienellä määrällä etanolia ja sen jälkeen pienellä määrällä pullon reagenssia ja täytetään sitten.


Liittimet, joilla pullo kiinnitetään laitteeseen, saattavat löystyä. Tarkista liitin aina ([→ Kuva 102-1](#)), kun otat pullon ulos. Kiristä huolellisesti tarvittaessa.

Tarkista, että pullon takaosassa oleva O-renkas ([→ Kuva 102-2](#)) on sileä ja ehjä. Jos O-renkas ei ole sileä tai vastusta tuntuu, kun laitat reagenssipulloa takaisin, voitele O-renkas Molykote-rasvalla tiivistysrenkaiden tiivistämiseksi ja pullojen helpottamiseksi.



Kuva 102

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

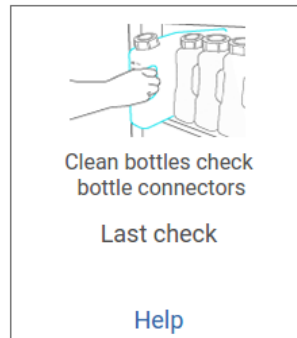

Kuva 103

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**.

Käytä pulloja puhdistaessa sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja, jotta välttyt roiskeilta.

Vältä reagenssiroiskeita varmistamalla, että kannet ovat tiukasti kiinni ja pullot on kunnolla kiinnitetty reagenssikaapin takaosan liittimiin.

Älä pese reagenssipulloja automaattisessa astianpesukoneessa, sillä ne voivat vahingoittua.

#### tarkista parafiinialtaat

Tarkista parafiinialtaiden likaantuminen joka viikko. Puhdista altaat parafiinin seuraavan vaihtamiskerran yhteydessä.

Puhdista parafiinialtaat, kun ne ovat lämpimiä (sillä ne alkavat kulua heti, kun ne on tyhjennetty laitteesta). Älä koskaan yritä puhdistaa allasta silloin, kun altaan parafiini on tislauksastiassa.

Poista roskat ja sakka altaan pohjasta ja seinämiltä pyyhkimällä ne nukkaamattomalla liinalla. Varo irrottamasta tai siirtämästä nokisuodattimia. Varmista parafiinialtaan ilmanvaihtotulpan avulla, ettei parafiinia joudu parafiinialtaan ilmanvaihtoaukkoon.



#### **Varoitus**

Parafiinialtaan kansi avataan, kun tislauksastiassa on parafiinia tai parafiinia siirretään.

#### **Henkilövamma**

- Älä koskaan avaa parafiinialtaan kantta, kun tislauksastiassa on parafiinia tai parafiinia siirretään. Kuumaa parafiinia voi roiskua altaasta.

Noudata varovaisuutta, kun puhdistat parafiinialtaan seinämiä. Seinämät voivat olla kuumia ja aiheuttaa palovammoja.

### puhdista ulkopinnat

Pyyhi laitteen ulkopinnat joka viikko liinalla, joka on kostutettu vedellä tai 70-prosenttisella etanolilla. Älä käytä voimakkaita liuottimia.

Kuivaa nukkaamattomalla liinalla.

### 9.3.3 60–90 päivän välein

#### vaihda aktiivihiihisiuodatin

Vaihda aktiivihiihisiuodatin 60–90 päivän välein.


Vaihda aktiivihiihisiuodatin aina, kun ohjelmisto kertoo sen vanhentuneen. Laitteen käyttäminen vanhentuneella aktiivihiihisiuodattimella voi vapauttaa laboratorioon mahdollisesti vaarallisia kaasuja.

Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että aktiivihiihisiuodattimen raja-arvo on asetettu sopivaan arvoon, jotta operaattoreita varoitetaan, kun aktiivihiihisiuodatin on vaihdettava. Aktiivihiihisiuodattimen raja-arvoasetukset ovat kohdassa **Settings (Asetukset) > Instrument settings (Laitteasetukset)**.

Vaihda aktiivihiihisiuodatin näin:

1. Poista etätäytön/-tyhjennyksen suojus.
2. Poista aktiivihiihisiuodatin vetämällä etupuolen kangashihnasta.
3. Poista uusi suodatin muovikääreestä.
4. Aseta uusi suodatin laitteeseen. Suodattimen asetuspäivä voidaan merkitä etupuolen etikettiin.
5. Sulje etätäytön/-tyhjennyksen suojus.

Kun olet valmis, tallenna huoltotoimenpide **Maintenance (Huoltonäytöllä)** napauttamalla sopivaa paneelia:

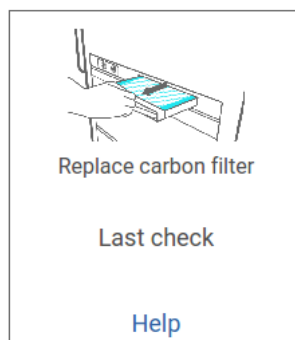

Kuva 104

Ohjeikkunan saa näkyviin napauttamalla **Help (Ohje)**.

Tarkista kansien tiivisteet

Tarkista tislusastioiden ja parafiinialtaiden kansien tiivisteet 60–90 päivän välein. Jos tiiviste on kulunut tai vahingoittunut, ota yhteyttä huoltoon.

## 10. Viitteet

### 10.1 Reagenssin raja-arvo-ohjeet

Tässä osiossa olevat taulukot sisältävät suositellut raja-arvot usein käytetyille reagensseille. Ksyleeniä sisältäville ja ksyleenittömille käsittelyille on erilliset taulukot.

#### Ksyleenikäsittely

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi ksyleenikäsittelyreagenssien vaihtamisen tulee perustua konsentraatoraja-arvoihin, kun taas puhdistusreagenssien raja-arvojen tulee perustua sykleihin.

Ksyleenikäsittelyreagenssien, mukaan lukien puhdistusreagenssien, raja-arvot porrastamattoman etanolin kanssa ovat seuraavat:

Tyyppi	Reagenssin vaihtamisen raja-arvot		Lopulliset reagenssin raja-arvot		Enimmäislämpötilat °C		
	Pitoisuuden (%)	Kasetit tai syklit	Pitoisuuden (%)	Kasetit tai syklit	Ympäristö	Tyhjiö	Turvallinen
Formaliini	98,0	–	–	–	60	60	45
Etanoli	51,0	–	98,0	–	78	51	45
Ksyleeni	68,0	–	95,0	–	138	99	45
Parafiini	80,0	–	95,0	–	100	100	77
Puhdistusksyleeni	–	10 sykliä	–	–	138	99	45
Puhdistusetanoli	–	10 sykliä	–	–	78	51	45

#### Ksyleenitön käsittely

Yleisesti ottaen ksyleenittömien käsittelyreagenssien vaihtamisen tulee perustua konsentraatoraja-arvoihin ja puhdistusreagenssien vaihtamisen tulee perustua sykleihin.

Tyyppi	Reagenssin vaihtamisen raja-arvot		Lopulliset reagenssin raja-arvot		Enimmäislämpötilat °C		
	Pitoisuuden (%)	Kasetit tai syklit	Pitoisuuden (%)	Kasetit tai syklit	Ympäristö	Tyhjiö	Turvallinen
Formaliini	98,0	–	–	–	60	60	45
85-prosenttinen etanoli	50,0	–	–	–	87	55	45
80/20 etanoli/IPA	81,0	–	–	–	78	51	45
IPA	90,0	–	95,0	–	82	55	45
Parafiini	85,0	–	95,0	–	100	100	77
Puhdistus-Waxsol	88,0	6 sykliä*	–	–	100	100	45
Puhdistusetanoli	88,0	6 sykliä*	–	–	78	51	45

\*Tämä eroaa ksyleenikäsittelyn puhdistusetanolin suosituksesta, koska ksyleenittömien protokollien puhdistusliuotin ei ole yhtä tehokasta kuin ksyleeniprotokollien puhdistusliuotin.

## 10.2 Protokollat

Leica Biosystems on kehittänyt ja testannut syvällisesti tässä osiossa olevat protokollat käytettäväksi kudosten käsittelylaitteella. Jotkin niistä ovat järjestelmässä ennalta määritettyinä protokollina.

Suositteluja kudostyyppiä käytettäessä kaikki protokollat tuottavat optimaalista käsittelylaatua ja jatkuvasti laadukkaita tuloksia. Käytä näitä protokollia ja ehdotettuja aseman määrityksiä (→ s. 164 – 10.3 Aseman määritykset) vertailukohtana, kun kehität omiin tarpeisiisi ja käytäntöihisi sopivia protokollia.

### 10.2.1 Näytetyyppi ja protokollan kesto

Seuraavassa taulukossa on lueteltu suositeltavat protokollan kestoajat eri näytetyypeille.

Protokolla (tuntia)	Kudoksen enimmäispaksuus (mm)	Näytetyyppi: esimerkkejä
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;3</li> <li>• =3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kaikki biopsiat, joiden halkaisija on ≤3 mm: gastrointestinaaliset biopsiat, munuaisen, eturauhasen, maksan ja rinnan näytteet, ihon lävistysbiopsiat, pienet paksusuolen polyypit</li> <li>• harvojen kudosten (esim. munuaisten, maksan, suolen) piennäytteet, eksisio- ja insisioihobiopsiat, ihoellipsit</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 × 10 × 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kaikki rutiinikudokset enimmäismittoihin asti (paitsi aivonäytteet)</li> <li>• kaikki rutiinikudokset enimmäismittoihin asti; erittäin paksut, rasvaiset näytteet saattavat edellyttää pidempää protokollaa</li> </ul>

### 10.2.2 Ennalta määritettyjen protokollien luettelo

Leica Biosystems toimittaa jokaisen järjestelmän mukana viisi ennalta määritettyä protokollaa. Niitä voi käyttää sellaisenaan tai uusien protokollien perustana (→ s. 97 – 6.2.3 Uusien protokollien luominen).

Ennalta määritellyt protokollat ovat seuraavat:

- biopsia – ksyleeni
- yön yli – ksyleeni
- biopsia – ksyleenitön
- yön yli – ksyleenitön
- pikapuhdistus



#### Varoitus

**Käsittelyssä oleville näytetyypeille sopimattomat siirtoasetukset voivat aiheuttaa näytteen vaurioitumisen!**

Varmista oikeat siirtoasetukset:

- Katso kantautumisasetukset luvusta 6.1.5 ”Siirtymäasetus”.
- Laboratorion on validoitava ennalta määritellyt ja mukautetut protokollat (mukaan lukien siirtymisarvo) standarditoimintaohjeidensa mukaisesti.



### 10.2.3 Ksyleeniprotokollat

Kaikki alla luetellut ksyleeniprotokollat on suunniteltu käytettäväksi ksyleenipullojen määrityksillä (→ s. 164 – 10.3 Aseman määritykset).

Huomioi, että kunkin protokollan ilmoitettu käsittelyaika sisältää jokaisen vaiheen vaihe- ja valumisajan sekä kokonaistäyttö- ja valumisajan. Vaihe- ja valumisaika ilmoitetaan protokollan jokaista vaihetta kohden, mutta täyttö- ja valumisaikaa ei.

#### Biopsia – ksyleeni

- Ennalta määritetty vakioprotokolla "Biopsia – ksyleeni"
- Siirtymäasetus: 75

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Formaliini	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
2	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
3	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
4	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
5	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
6	Etanoli	15	45	Ympäristö	Päällä	10
7	Etanoli	50	45	Ympäristö	Päällä	10
8	Ksyleeni	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
9	Ksyleeni	5	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
10	Ksyleeni	35	45	Ympäristö	Päällä	10
11	Parafiini	5	65	Tyhjiö	Päällä	10
12	Parafiini	10	65	Tyhjiö	Päällä	10
13	Parafiini	25	65	Tyhjiö	Päällä	10
Käsittelyaika:		3 h 11 min				

**Yön yli – ksyleeni**

- Ennalta määritetty vakioprotokolla ”Yön yli – ksyleeni”
- Siirtymäasetus: 25

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Formaliini	44	45	Ympäristö	Päällä	10
2	Etanoli	30	45	Ympäristö	Päällä	10
3	Etanoli	30	45	Ympäristö	Päällä	10
4	Etanoli	30	45	Ympäristö	Päällä	10
5	Etanoli	30	45	Ympäristö	Päällä	10
6	Etanoli	60	45	Ympäristö	Päällä	10
7	Etanoli	90	45	Ympäristö	Päällä	10
8	Ksyleeni	45	45	Ympäristö	Päällä	10
9	Ksyleeni	45	45	Ympäristö	Päällä	10
10	Ksyleeni	90	45	Ympäristö	Päällä	10
11	Parafiini	60	65	Tyhjiö	Päällä	10
12	Parafiini	60	65	Tyhjiö	Päällä	10
13	Parafiini	80	65	Tyhjiö	Päällä	10
Käsittelyaika:		12 h 14 min				

**Biopsia ksyleenin nopea protokolla (suositellaan)**

- Suositeltava protokolla ”Biopsia ksyleenin nopea protokolla” (ksyleenin pikaprotokolla) on tarkoitettu ≤2 mm × 4 mm:n kokoiseen rei’itysbiopsiaan (rasvainen mukaan lukien).
- Siirtymäasetus: 100

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Formaliini	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
2	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
3	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
4	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
5	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
6	Etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
7	Etanoli	18	45	Ympäristö	Päällä	10
8	Ksyleeni	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
9	Ksyleeni	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
10	Ksyleeni	14	45	Ympäristö	Päällä	10
11	Parafiini	2	65	Tyhjiö	Päällä	10
12	Parafiini	1	65	Tyhjiö	Päällä	10
13	Parafiini	14	65	Tyhjiö	Päällä	10
Käsittelyaika:		1 h 25 min				

#### 10.2.4 Ksyleenittömät protokollat

Kaikki alla luetellut ksyleenittömät protokollat on suunniteltu käytettäväksi ksyleenittömien pullojen määrityksillä kohdassa Aseman määritykset (→ s. 164 – 10.3 Aseman määritykset).

Huomioi, että kunkin protokollan ilmoitettu käsittelyaika sisältää jokaisen vaiheen vaihe- ja valumisajan sekä kokonaistäyttö- ja valumisajan. Vaihe- ja valumisaika ilmoitetaan protokollan jokaista vaihetta kohden, mutta täyttö- ja valumisaikaa ei.

#### Biopsia – ksyleenitön

- Ennalta määritetty ksyleenitön protokolla ”Biopsia – ksyleenitön”
- Siirtymäasetus: 75

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Formaliini	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
2	85-prosenttinen etanoli	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
3	85-prosenttinen etanoli	15	55	Ympäristö	Päällä	10
4	80/20 etanoli/IPA	5	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
5	80/20 etanoli/IPA	35	55	Ympäristö	Päällä	10
6	IPA	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
7	IPA	1	Ympäristö	Ympäristö	Päällä	10
8	IPA	40	55	Ympäristö	Päällä	10
11	Parafiini	30	85	Tyhjiö	Päällä	10
12	Parafiini	12	85	Tyhjiö	Päällä	10
13	Parafiini	5	65	Tyhjiö	Päällä	10
Käsittelyaika:		2 h 59 min				

## Yön yli – ksyleenitön

- Ennalta määritetty ksyleenitön protokolla ”Yön yli – ksyleenitön”
- Siirtymäasetus: 26

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Formaliini	68	55	Ympäristö	Päällä	10
2	85-prosenttinen etanoli	30	55	Ympäristö	Päällä	10
3	85-prosenttinen etanoli	40	55	Ympäristö	Päällä	10
4	80/20 etanoli/IPA	50	55	Ympäristö	Päällä	10
5	80/20 etanoli/IPA	90	55	Ympäristö	Päällä	10
6	IPA	30	55	Ympäristö	Päällä	10
7	IPA	60	55	Ympäristö	Päällä	10
8	IPA	120	55	Ympäristö	Päällä	10
11	Parafiini	80	85	Tyhjiö	Päällä	10
12	Parafiini	70	85	Tyhjiö	Päällä	10
13	Parafiini	60	65	Tyhjiö	Päällä	10
Käsittelyaika:		12 h 11min				

### 10.2.5 Puhdistusprotokolla

#### Pikapuhdistus

- Ennalta määritetty puhdistusprotokolla ”Pikapuhdistus”.
- Pullon määrittäminen: yksi pullo puhdistusliuotinta ja yksi puhdistusetanolia.
- Älä koskaan suorita puhdistusprotokollaa, kun tislauksastiasissa on kudosta, sillä kuivausvaihe vahingoittaa kudosta.

Vaihe	Reagenssiryhmä	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Puhdistusliuottimet	12	75	Ympäristö	Päällä	10
2	Puhdistusetanoli	6	55	Ympäristö	Päällä	10
3	Kuivausvaihe	12	80	–	Pois	–
Käsittelyaika:		38				

### 10.3 Aseman määrittäykset

Käytä protokolliin tässä osiossa kuvattuja aseman määrittäyksiä.

Muunlaisia aseman määrittäyksiä suunniteltaessa on otettava huomioon se, miten protokollat määritetään, mukaan lukien reagenssien valintamenetelmät (→ s. 89 – 6.1.2 Reagenssien valintatapa). Jotkin laboratoriot esimerkiksi käyttävät ainoastaan porrastettua etanolia sellaisten reagenssityyppien kanssa, jotka on merkitty ”etanoli 70 %”, ”etanoli 90 %” jne. Tällainen aseman määrittäminen edellyttää, että protokollissa käytetään tyyppi- tai asemavalintaa, ja protokollat on määritettävä käyttämään etanoliporrastuksia oikeassa järjestyksessä.

## Ksyleenin määrittäminen

Tätä aseman määrittäystä suositellaan ksyleeniprotokollien suorittamiseen. Alla on huomautus erityisolosuhteista pullojen alkuasetukseen ja kaikkien etanolipullojen vaihtamiseen kokonaan.

Asema	Reagenssi
S1	Formaliini
S2	Formaliini
S3	Etanoli (70 %)*
S4	Etanoli (90 %)*
S5	Etanoli
S6	Etanoli
S7	Etanoli
S8	Etanoli
S9	Etanoli
S10	Etanoli
S11	Etanoli
S12	Ksyleeni
S13	Ksyleeni
S14	Ksyleeni
S15	Ksyleeni
S16	Puhdistusksyleeni
S17	Puhdistusetanoli
W1	Parafiini
W2	Parafiini
W3	Parafiini
W4	Parafiini

\*Kaikki fiksaatiivien jälkeiset, etanolia sisältävät vedenpoistoaineet on merkittävä ja nimettävä ohjelmistossa etanoliksi. Jos pulloja asetetaan uuteen laitteeseen tai kaikki etanolipullot vaihdetaan kerralla, ensimmäinen ja toinen pullo on kuitenkin täytettävä 70-prosenttisella ja 90-prosenttisellä etanolilla tässä järjestyksessä. Kun toiminto jatkuu ja heikentyneet pullot kehoitetaan vaihtamaan, ne on korvattava 100-prosenttisellä etanolilla. Muut pullot, joiden pitoisuus oli alun perin korkeampi, ovat heikentyneet, joten vähintään yhdessä pullossa on aina alhaisempi pitoisuus.

**Ksyleenitön määrittäminen**

Tätä aseman määrittäystä suositellaan ksyleenittömien protokollien suorittamiseen. Taulukon alapuolella on huomautus erityisolosuhteista, jotka koskevat pullojen alkuasetusta ja kaikkien 85-prosenttisten etanolipullojen vaihtamista kerralla.

Asema	Reagenssi
S1	Formaliini
S2	Formaliini
S3	85-prosenttinen etanoli*
S4	85-prosenttinen etanoli*
S5	85-prosenttinen etanoli
S6	85-prosenttinen etanoli
S7	80/20 etanoli/IPA
S8	80/20 etanoli/IPA
S9	80/20 etanoli/IPA
S10	IPA
S11	IPA
S12	IPA
S13	IPA
S14	Puhdistusksyleeni
S15	Puhdistusksyleeni
S16	Puhdistusetanoli
S17	Puhdistusetanoli
W1	Parafiini
W2	Parafiini
W3	Parafiini
W4	Parafiini

\*Kaikki fiksaatiivin jälkeiset, etanolia sisältävät vedenpoistoaineet on merkittävä ja nimettävä ohjelmistossa 85-prosenttiseksi etanoliksi. Jos pulloja asetetaan uuteen laitteeseen tai kaikki etanolipullot vaihdetaan kerralla, ensimmäiset kaksi pulloa on täytettävä 70-prosenttisellä (mutta nimettävä kuitenkin 85-prosenttiseksi etanoliksi). Kun toiminto jatkuu ja heikentyneet pullot kehoitetaan vaihtamaan, ne on korvattava 85-prosenttisellä etanolilla. Muut pullot, joiden pitoisuus oli alun perin korkeampi, ovat heikentyneet, joten vähintään yhdessä pullossa on aina alhaisempi pitoisuus.

## 10.4 Protokollavaiheiden lämpötilat

Kudosten käsittelylaite käyttää viittä protokollatyyppiä erilaisten käsittelytyyppien mukaan. Jokaisessa tyyppissä on reagenssin yhteensopivuusjaksoja, jotka sopivat käyttötarkoitukseen (→ s. 167 – 10.5 Reagenssien yhteensopivuustaulukot). Myös sallittava lämpötilan vaihtelualue jokaisessa vaiheessa riippuu protokollatyyppistä. Seuraavissa osioissa luetellaan protokollien lämpötilan vaihtelualueet ja tyyppilliset protokollajakset.

Protokollatyyppi	Tislausastian lämpötila-alue reagenssille	Tislausastian lämpötila-alue parafiinille
Vakio	35 °C – 65 °C	58 °C – 77 °C
Ksyleenitön	35 °C – 65 °C	58 °C – 77 °C
Puhdistaminen	35 °C – 85 °C	-

## 10.5 Reagenssien yhteensopivuustaulukot

Reagenssien yhteensopivuustaulukot määrittelevät sallittavat reagenssijaksot. Jaksot vaihtelevat toiminnosta ja protokollatyyppistä riippuen.

### Manuaalinen käyttö

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe										
	Ei mitään	Fiksatiivit	Prosessivesi	Vedenpoistoaineet	IPA	Rasvanpoistaja	Rasvanpoiston jälkeinen	Kirkastajat	Parafiini	Puhdistusliuottimet	Puhdistusetanoli
Y = yhteensopiva											
Fiksatiivit	Y	Y	Y	Y							Y
Prosessivesi	Y	Y	Y	Y							Y
Vedenpoistoaineet	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y		Y	Y
IPA	Y				Y						
Rasvanpoistaja	Y			Y		Y		Y		Y	Y
Rasvanpoiston jälkeinen	Y			Y		Y	Y	Y		Y	Y
Kirkastajat	Y			Y		Y	Y	Y		Y	Y
Parafiini	Y				Y			Y	Y	Y	
Puhdistusliuottimet	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Puhdistusetanoli	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y

**Vakiokäsittely**

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe								
	Y = yhteensopiva	Ei mitään	Fiksatiivit	Prosessivesi	Vedenpoistoaineet	Rasvanpoistaja	Rasvanpoiston jälkeinen	Kirkastajat	Parafiini
Fiksatiivit	Y	Y	Y						
Prosessivesi	Y	Y	Y						
Vedenpoistoaineet	Y	Y	Y	Y					
Rasvanpoistaja	Y			Y	Y				
Rasvanpoiston jälkeinen	Y			Y	Y	Y			
Kirkastajat	Y			Y	Y	Y	Y		
Parafiini	Y							Y	Y

**Puhdistusprotokolla**

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe											
	Y = yhteensopiva	Ei mitään	Fiksatiivit	Prosessivesi	Vedenpoistoaineet	IPA	Rasvanpoistaja	Rasvanpoiston jälkeinen	Kirkastajat	Parafiini	Puhdistusliuottimet	Puhdistusetanoli
Puhdistusliuottimet	Y				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Puhdistusetanoli	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y		Y

**Käänteinen vakiokäsittely (parafiinin poistamiseksi)**

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe								
	Y = yhteensopiva	Puhdistusliuottimet	Puhdistusetanoli	Ei mitään	Vedenpoistoaineet	Rasvanpoistaja	Rasvanpoiston jälkeinen	Kirkastajat	Parafiini
Puhdistusliuottimet	Y			Y					Y
Puhdistusetanoli	Y		Y	Y					
Vedenpoistoaineet			Y	Y	Y				
Rasvanpoistaja			Y	Y	Y	Y			
Rasvanpoiston jälkeinen			Y	Y	Y	Y	Y		
Kirkastajat			Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Parafiini				Y					Y



**Ksyleenitön käsittely**

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe					
	Ei mitään	Fiksatiivit	Prosessivesi	Vedenpoistoaineet	IPA (ryhmä)	Parafiini
Y = yhteensopiva	Ei mitään	Fiksatiivit	Prosessivesi	Vedenpoistoaineet	IPA (ryhmä)	Parafiini
Fiksatiivit	Y	Y	Y			
Prosessivesi	Y	Y	Y			
Vedenpoistoaineet	Y	Y	Y	Y		
IPA (ryhmä)	Y			Y	Y	
Parafiini	Y				Y	Y

\*Reagenssityyppi valitaan ksyleenittömässä tilassa käsiteltävien protokollien luomisen aikana.

**Käänteinen ksyleenitön käsittely (parafiinin poistamiseksi)**

Nykyinen vaihe	Edellinen vaihe					
	Puhdistusliuottimet	Puhdistusetanoli	Ei mitään	Vedenpoistoaineet	IPA (ryhmä)	Parafiini
Y = yhteensopiva	Puhdistusliuottimet	Puhdistusetanoli	Ei mitään	Vedenpoistoaineet	IPA (ryhmä)	Parafiini
Puhdistusliuottimet	Y		Y			Y
Puhdistusetanoli	Y	Y	Y			
Vedenpoistoaineet		Y	Y	Y		
IPA (ryhmä)		Y	Y	Y	Y	
Parafiini			Y		Y	Y

## 11. Vianetsintä

### 11.1 Alustavat kysymykset

Kun vastaan tulee lohkoja, joita on vaikea leikata, kokoa aluksi mahdollisimman paljon tietoa avuksi ongelman analysointiin. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

1. Ilmaisiko instrumentin ohjelmisto virheen suorituksessa? Instrumentin varoitukset ja hälytykset näytetään näytöllä ja tapahtumalokissa.
2. Oliko suorituksessa jotakin eroa aikaisempiin, onnistuneisiin suorituksiin verrattuna, mikä olisi saattanut aiheuttaa ongelman, esim. hiljattain vaihdettu reagenssipullo?
3. Onko mahdollista, että tapahtui virhe, kun reagenssia vaihdettiin käsittelylaitteeseen? Tarkista, että jokaisessa pullossa on oikeaa reagenssia.
4. Reagenssiasemat-näyttö tallentaa reagenssien pitoisuudet. Siinä näkyy myös, kuinka monta kasettia reagenssin läpi on ajettu ja kuinka monta sykliä on käyttänyt reagenssia sen jälkeen, kun se viimeksi vaihdettiin. Tarkista, ovatko nämä oikein.
5. Onko joku reagensseista ylittänyt suositellun puhtausraja-arvon?
6. Käytettiinkö suunniteltua käsittelyprotokollaa todella? Onko esimerkiksi mahdollista, että näytteet, jotka oli tarkoitettu pitkään käsittelyprotokollaan, asetettiin lyhyeen käsittelyprotokollaan?
7. Käsiteltiinkö näytteet vastaavan kokoisille ja tyyppisille näytteille yleensä käytetyllä protokollalla, joka yleensä tuottaa hyviä tuloksia? Jos näin on, ongelma ei todennäköisesti ole protokollan parametreissä.
8. Olivatko näytteet aivan tislausastian yläosassa? Oliko telineet asetettu tislausastiaan oikein?
9. Vaikuttiko ongelma kaikkiin erän näytteisiin vai vain osaan niistä? Olivatko kaikki näytteet samantyyppisiä? Olivatko ne kaikki peräisin samasta lähteestä? Vastaukset näihin kysymyksiin saattavat viitata ongelmaan ennen kudosten käsittelyä.
10. Käytettiinkö ongelmallisiin näytteisiin tavallista kiinnitystä?


Nämä kysymykset auttavat määrittelemään, mikä on mennyt vikaan. Jos edelleen olet epävarma ongelman aiheuttajasta, kokoa mahdollisimman paljon tietoa tutkimalla näytteet huolellisesti. Tutkimalla lohkot tarkasti voit varmistua siitä, mitä epäilet tapahtuneen. Myös mikroskooppitutkimus tuottaa arvokasta tietoa siitä, mikä on saattanut mennä vikaan.

### 11.2 Vuokaaviot

Tässä osiossa on kahdeksan vuokaaviota erilaisten käsittelyongelmien selvittämiseen.


- Alikäsittely kudos – laiteasetukset
- Ylikäsittely kudos – laiteasetukset
- Ali- tai ylikäsittely kudos – reagenssit
- Heikko käsittely – väärä protokolla
- Heikko käsittely – oikea protokolla
- Leikkausartefakti
- Värjäysartefakti
- Lohkoartefakti

11.2.1 Alikäsitelty kudos – laiteasetukset

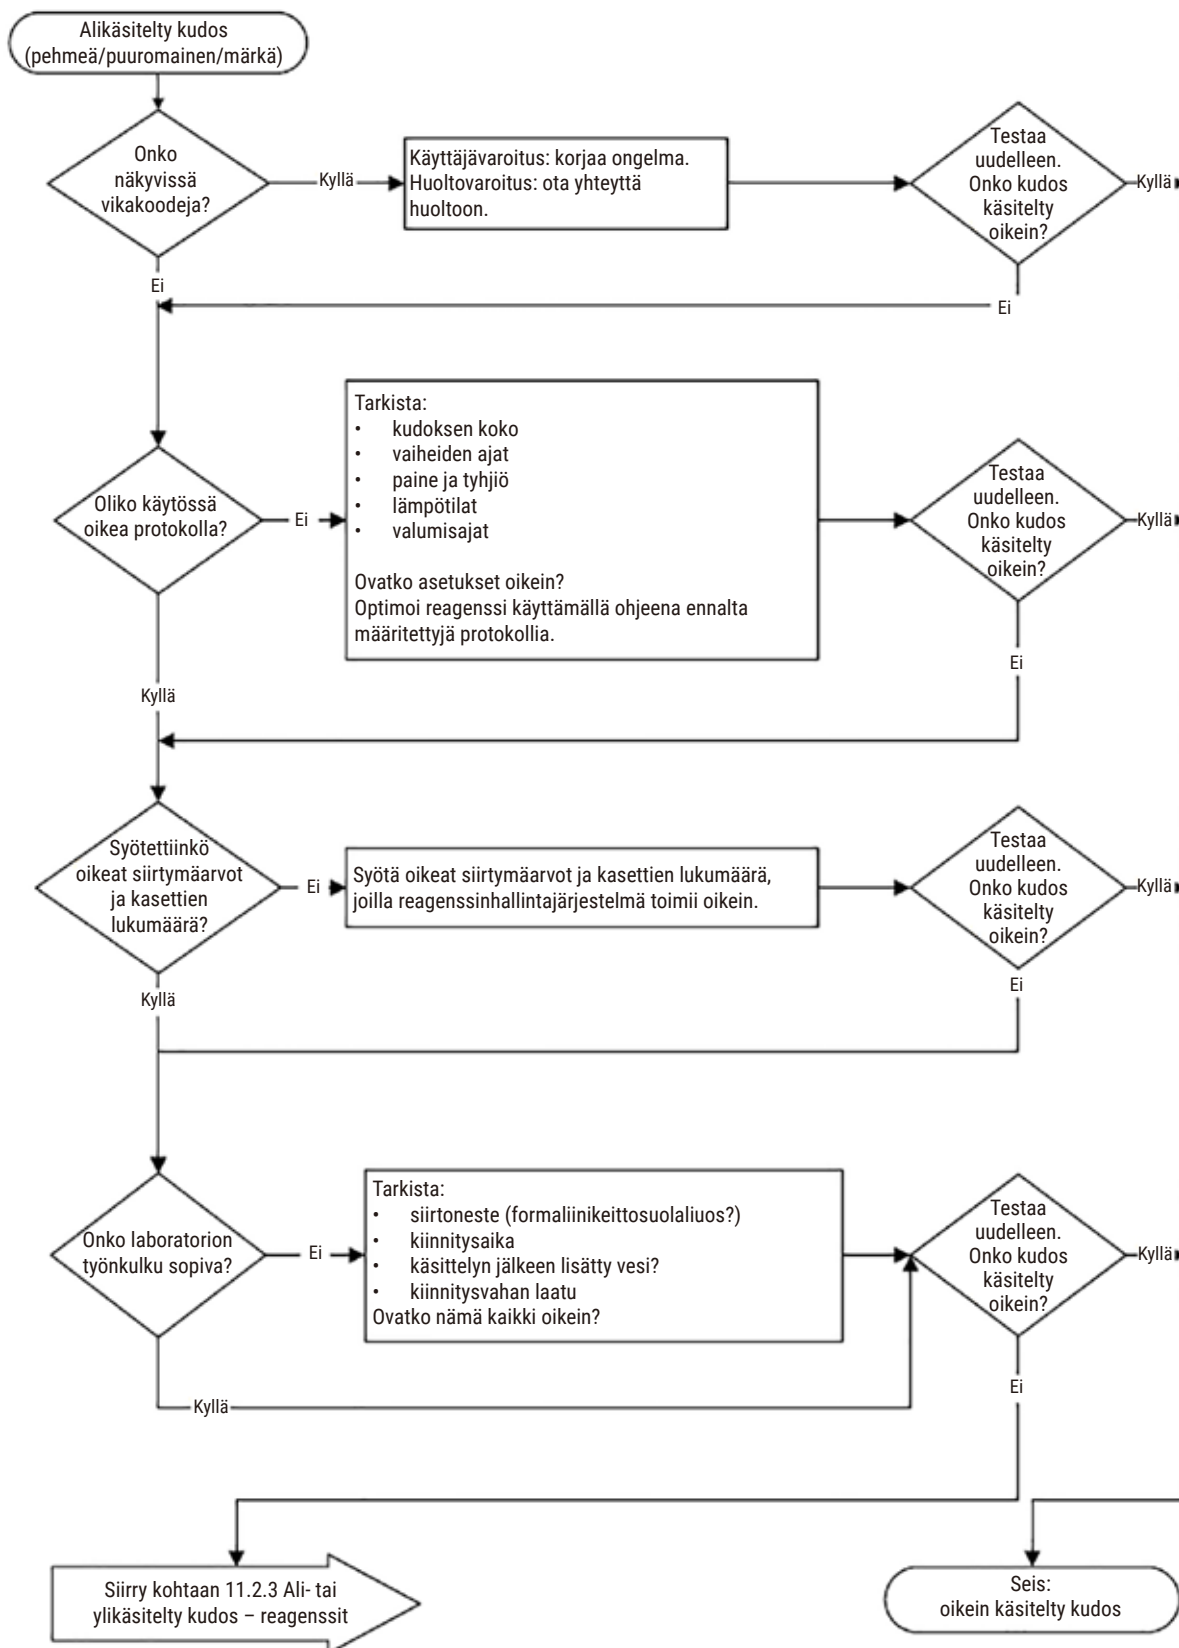


Kuva 105

## 11.2.2 Ylikäsitelty kudos – laiteasetukset

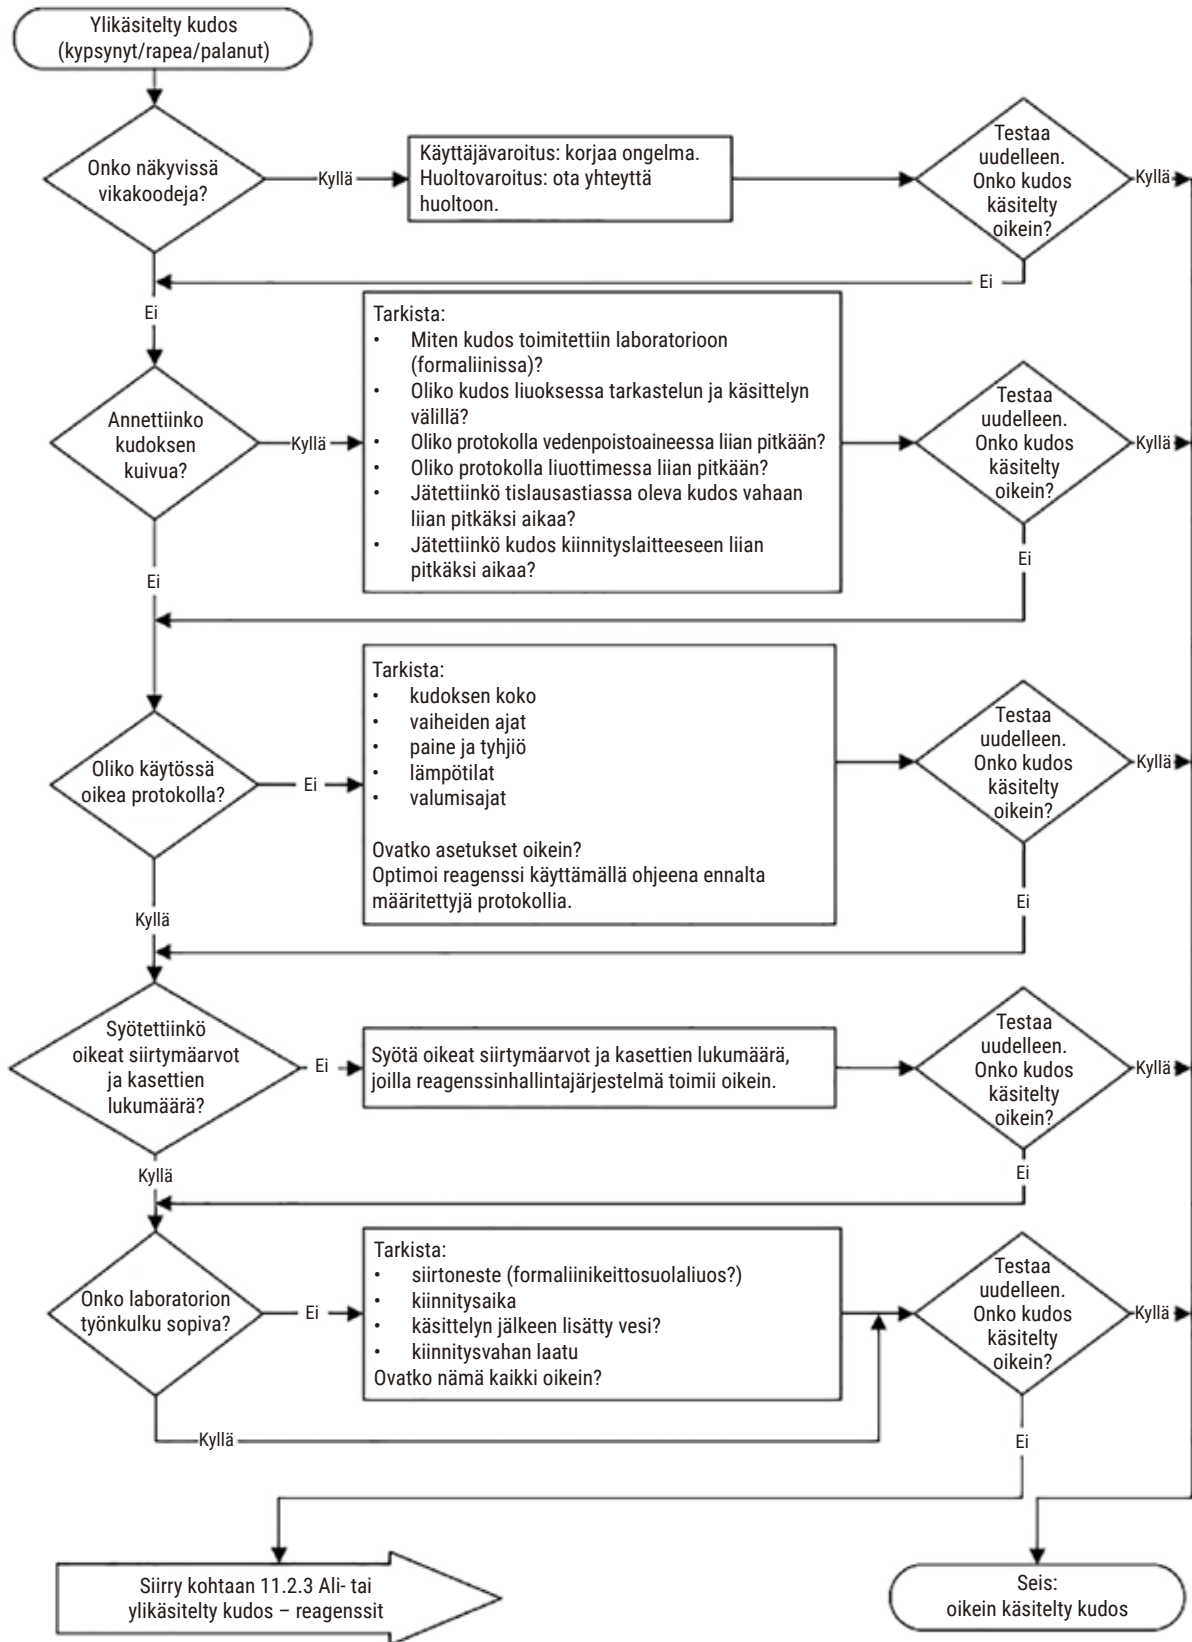


Kuva 106

11.2.3 Ali- tai ylikäsitelty kudus – reagenssit

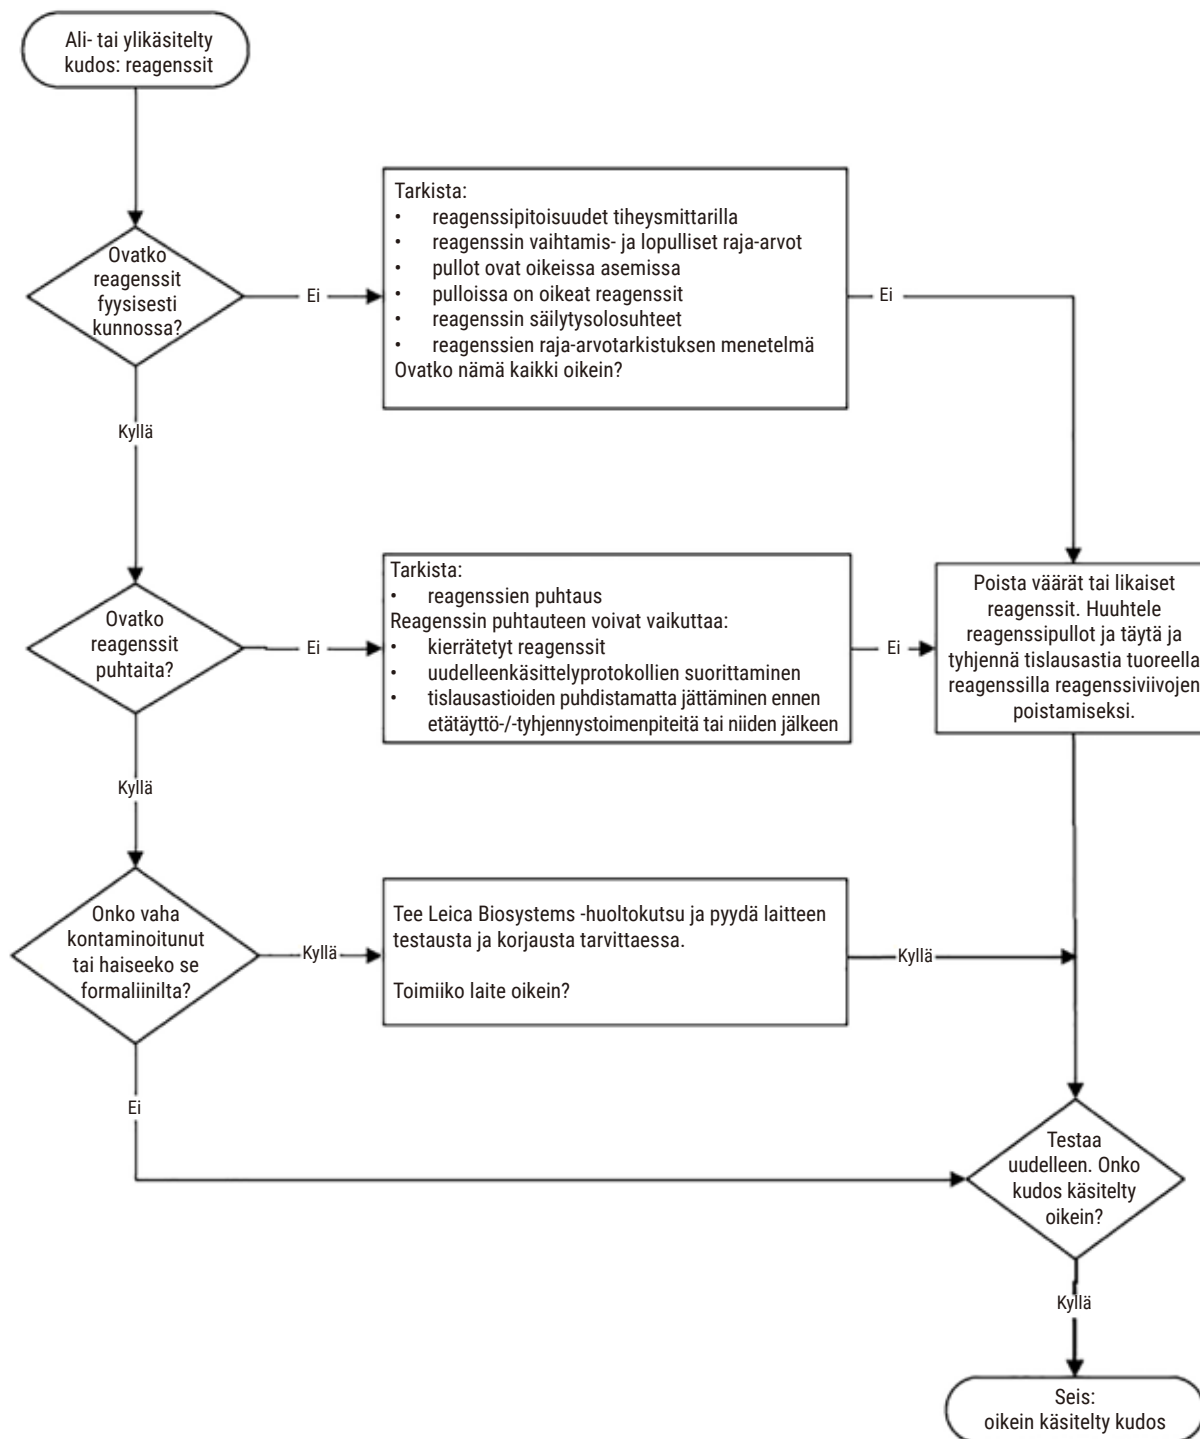


Kuva 107

11.2.4 Heikko käsittely – väärä protokolla

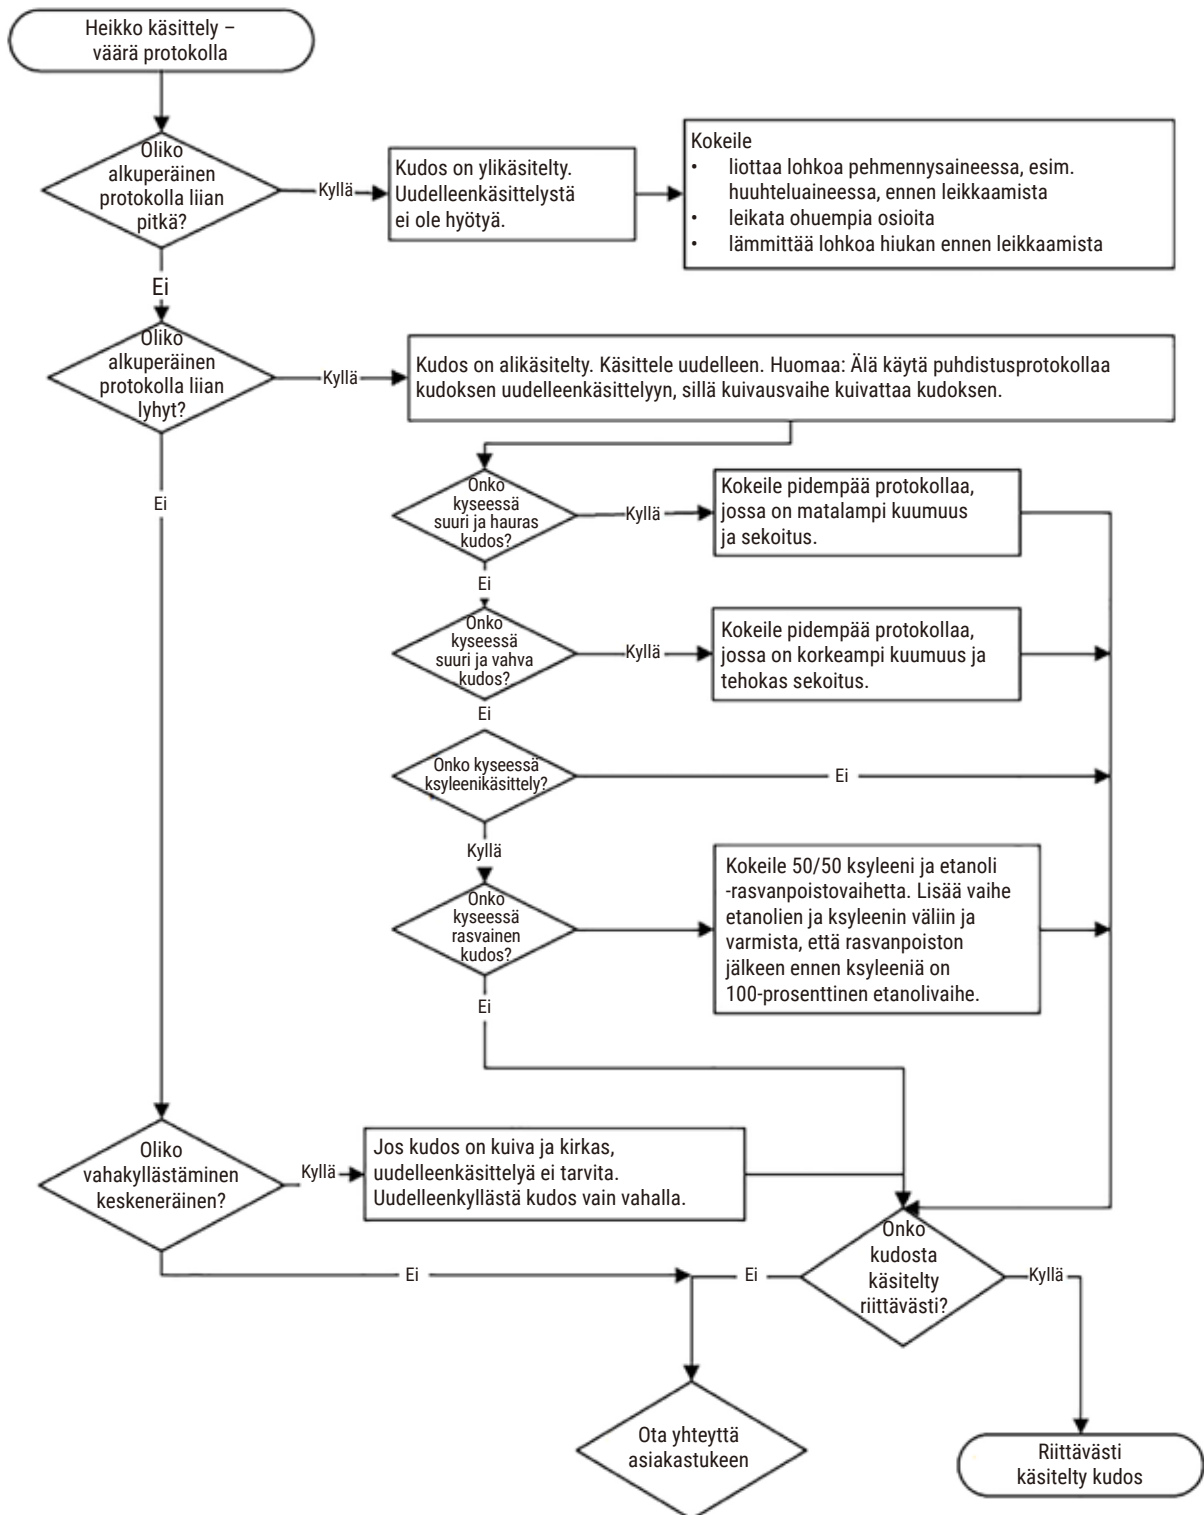


Kuva 108

11.2.5 Heikko käsittely – oikea protokolla

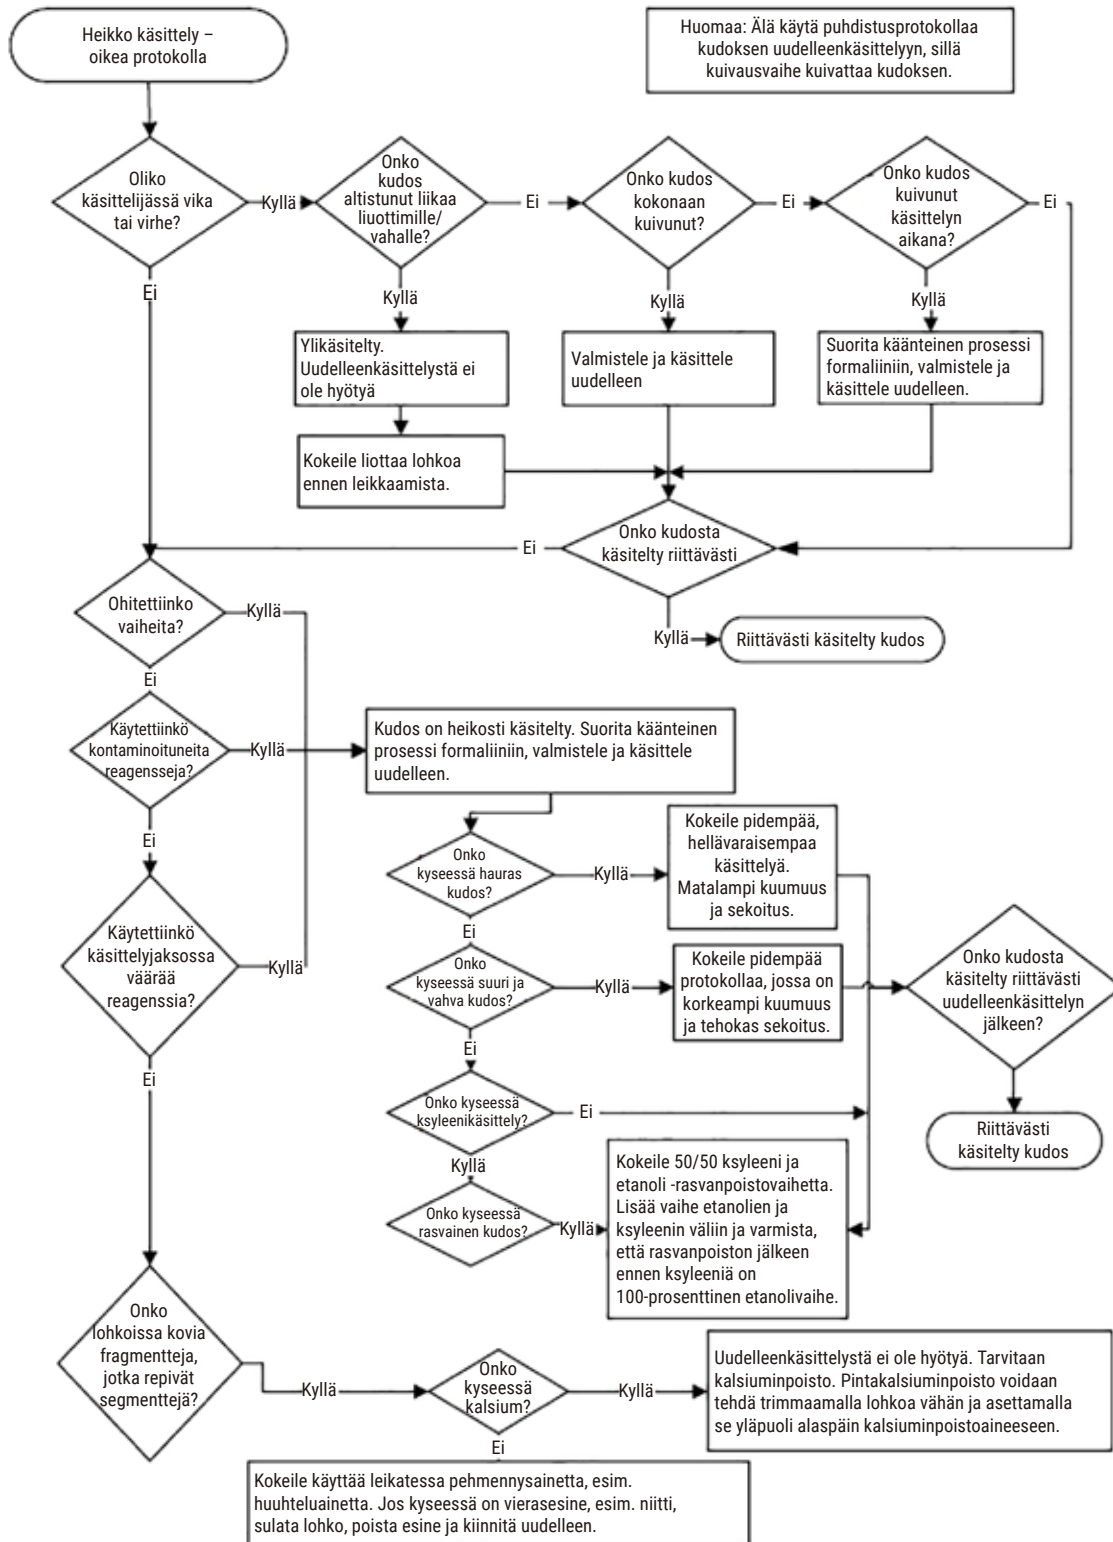

Kuva 109


11.2.6 Leikkausartefakti

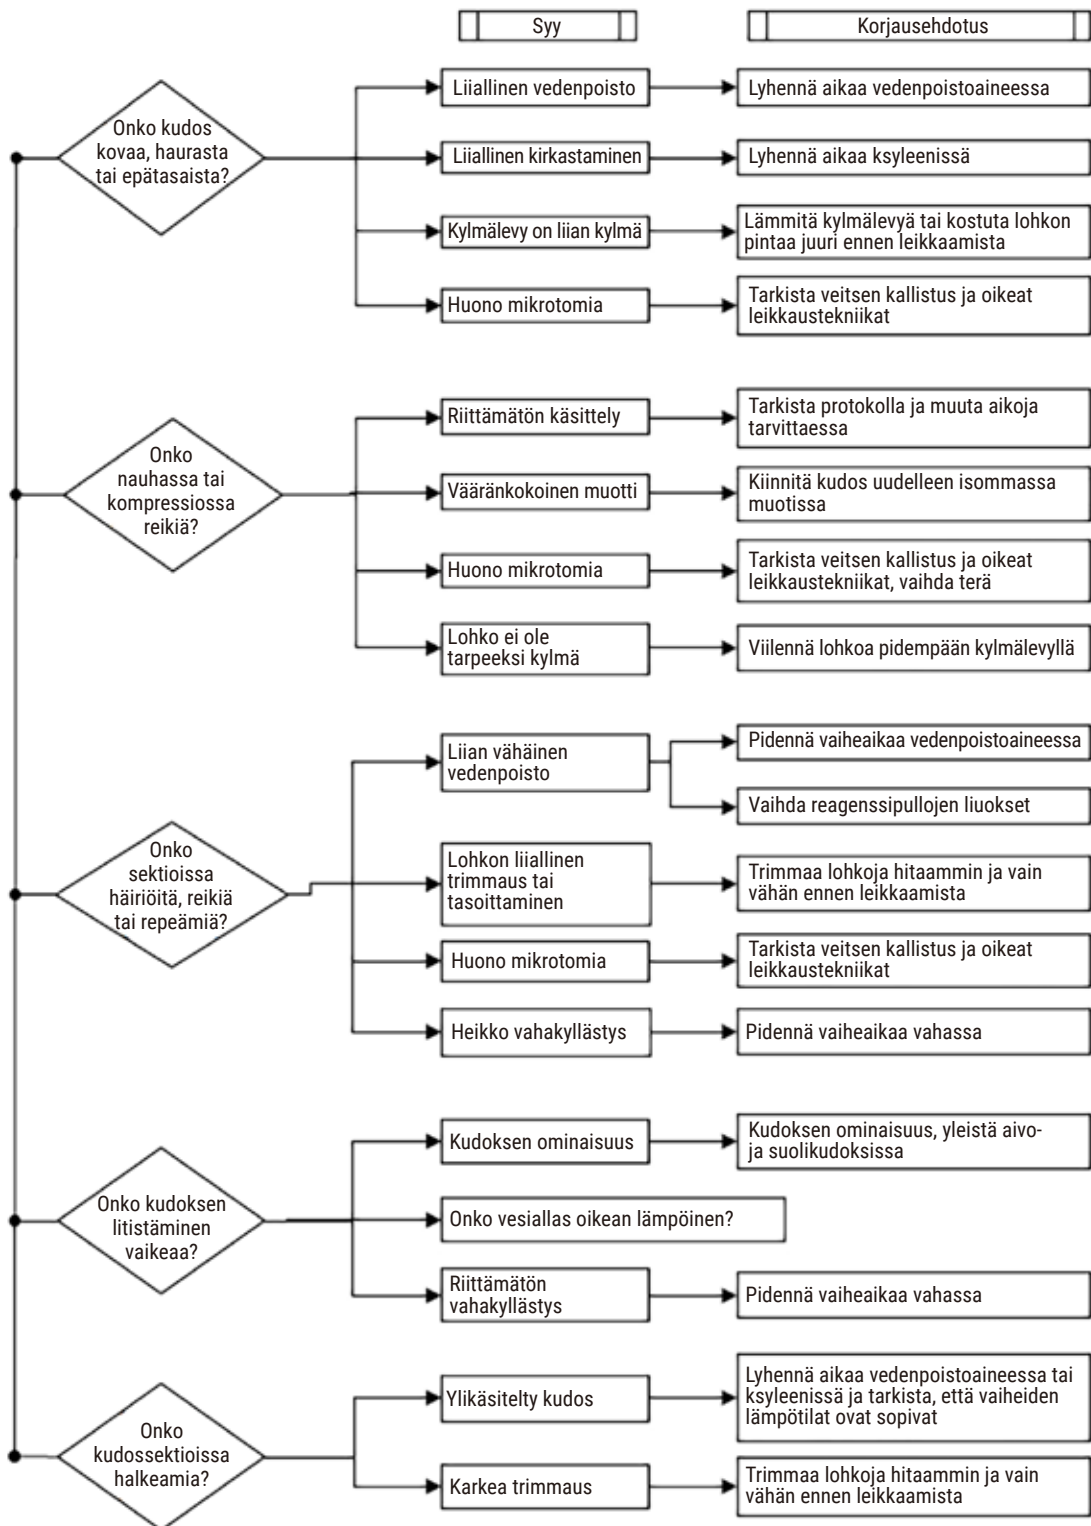

Kuva 110




11.2.7 Värjäysartefakti

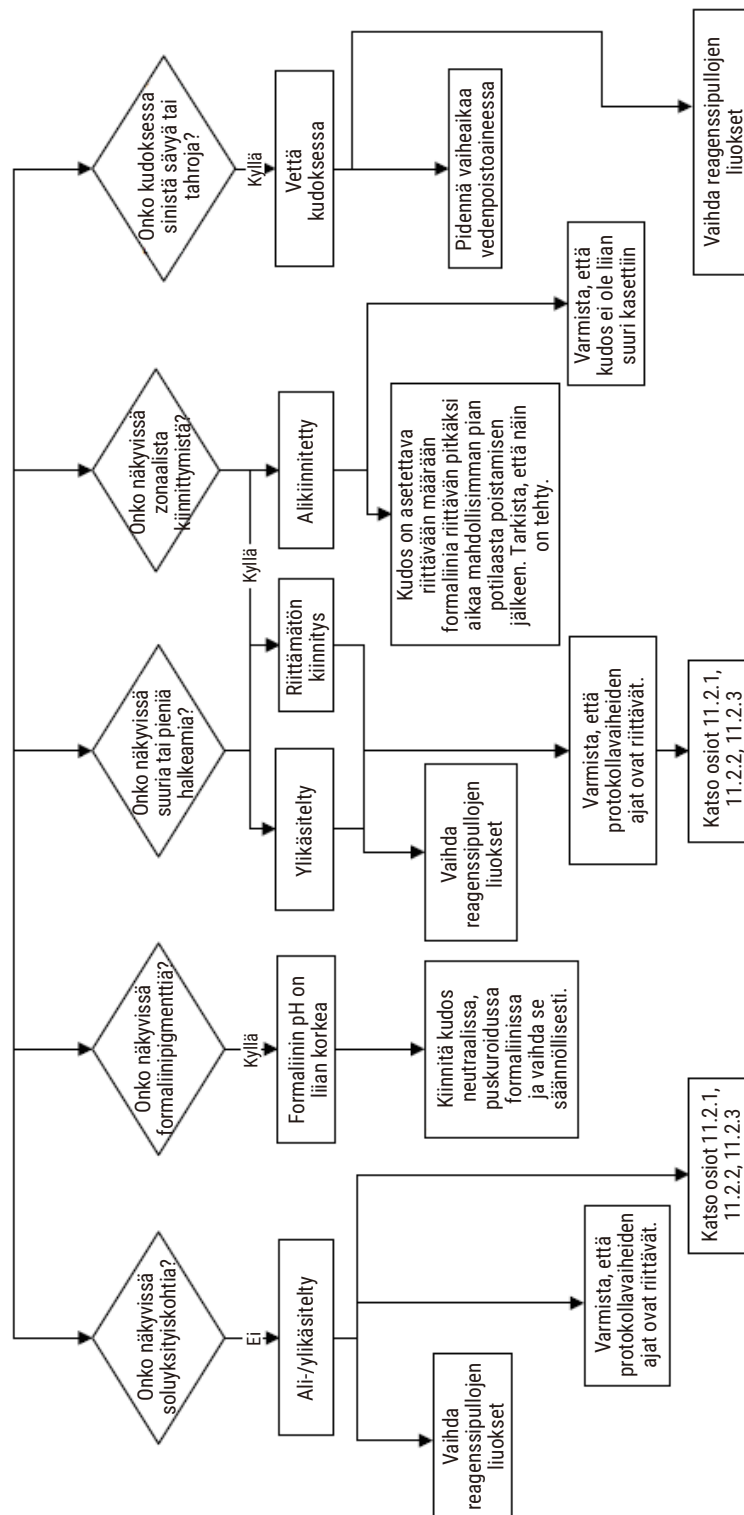

Kuva 111

11.2.8 Lohkoartefakti

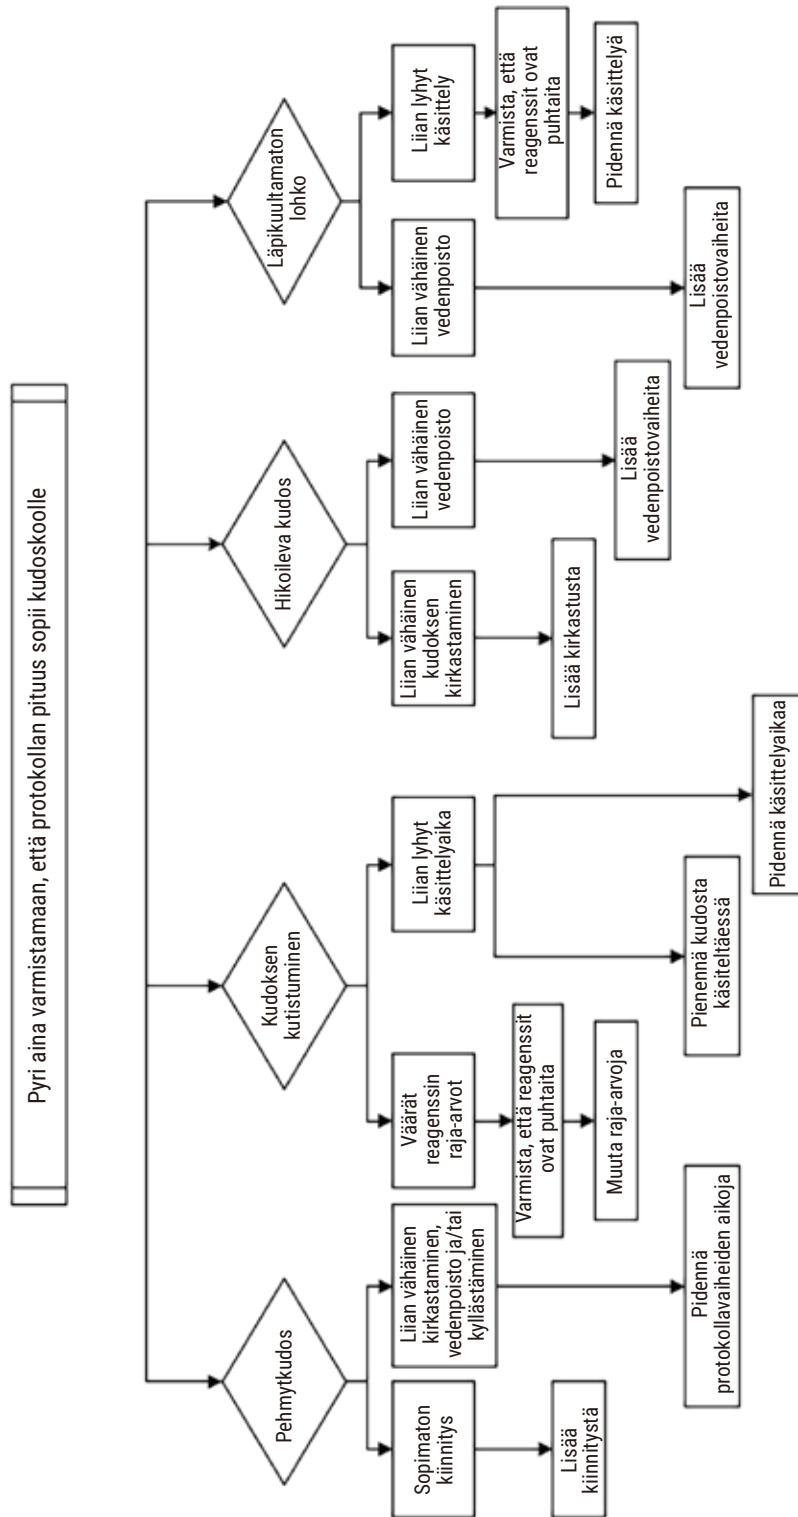

Kuva 112

### 11.2.9 Uudelleen käsittelysuositukset

Kaikki ongelmakudokset eivät edellytä uudelleen käsittelyä. Tässä osiossa käsitellään joitakin yleisiä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.

#### 1. Kova, hauras, ylikäsitelty kudoks

Käsittele altistuneen kudoksen pinta lohkossa nesteytys- tai pehmennysaineella, esimerkkeinä

- sulava jää
- Teepol™, jonka vesipitoisuus on 0,2 %, tai muu kostutusaine
- 5-prosenttinen huuhteluaine (esim. Downy™)
- Mollifex™
- 9 % glyserolia 60-prosenttisessä etanolissa

Käsittele muutaman minuutin ajan, huuhtele, jäähdytä ja leikkaa uudelleen.

Uudelleen käsittelyä ei suositella, sillä se aiheuttaa enemmän ylikäsittelyä.

#### 2. Kalsiumkertymistä johtuva kudoksen rakeisuus

Käsittele altistuneen kudoksen pintaa lohkossa kalsiuminpoistoaineella 15–30 minuutin ajan. (Aika riippuu käytetystä kalsiuminpoistoaineesta.) Poista happo huuhtelemalla, jäähdytä ja leikkaa uudelleen.

Kalsium- tai muita mineraalikertymiä sisältävän kudoksen uudelleen käsittely ei paranna kudoksen leikkausominaisuuksia. Kalsium on poistettava.

#### 3. Kova, surkastunut kudoks – kuivunut ennen parafiinikyllästämistä

Liota suuressa määrässä palautusliuosta 2–24 tunnin ajan. (Aika riippuu kudoksen koosta ja tyypistä sekä kuivumisen vakavuudesta.) Palautusliuoksia ovat muun muassa seuraavat:

- neutraali, puskuroitu formaliini
- keittosuolaliuos
- Sandisonin liuos
  - a. 50 ml formaliinia, jonka vesipitoisuus on 1 %
  - b. 30 ml 96-prosenttista etanolia
  - c. 20 ml 5-prosenttista natriumkarbonaattia
- etanoli-glyseroli
  - a. 90 ml 60-prosenttista etanolia
  - b. 10 ml glyserolia

Käsittele sen jälkeen kudoks normaalisti.

#### 4. Kova, surkastunut kudosis – kuivunut, mutta käsitelty parafiiniin asti

Poista parafiini ja kosteuta alla ongelmassa 6 kuvatulla tavalla. Käsittele palautusliuoksella ongelmassa 3 kuvatulla tavalla.

#### 5. Kudoksen parafiinikyllästys on vajavainen

Aseta kasetit takaisin parafiinialtaaseen, jossa on tyhjiö, sekoitin päällä ja lämpötila 65 °C. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun kudosis on otettu pois parafiinista ennenaikaisesti.

#### 6. Riittävästi kiinnitetty mutta alikäsitelty kudosis

Tämä ongelma saattaa johtua liian lyhyestä protokollasta, liian suuresta näytteestä tai käsittelijän virheestä. Suositeltavia ratkaisuja on neljä, mutta pyri ensin tunnistamaan ja korjaamaan ongelma. Testaa ratkaisu käsittelemällä laitteessa kontrollikudosisia ennen potilaskudosisen uudelleenkäsittelyä (tai käytä eri käsittelijää).

Huom: Seuraavissa ratkaisuissa sulata lohkot, poista ylimääräinen parafiini ja aseta sitten näytteet uusiin kasetteihin. Tämä vähentää käsittelyreagenssien kontaminoitumista parafiinilla.

##### A. Taggartin menetelmä

Aseta kasetit dekantterilasiin, jossa on keittosuolaliuosta (vesipitoinen liuos, jossa on 0,9 % natriumkloridia), ja aseta 65-asteiseen inkubaattoriin tunniksi. Parafiini nousee pintaan. Poista kudosis ja käsittele uudelleen formaliinista sen koolle ja tyyppille sopivalla protokollalla ([→ s. 160 – 10.2.1 Näytetyyppi ja protokollan kesto](#)).

Keittosuolaliuos nesteyttää kudosis, joka voidaan sen jälkeen käsitellä normaalisti. Keittosuolaliuos on myrkytön reagenssi, jota voidaan turvallisesti käyttää avoimessa laboratoriossa.

##### B. Nopea käänteinen käsittely

Käsittely, jossa käytetään nopeaa, muokattua puhdistusprotokollaa ([→ s. 181 – Nopea käänteinen puhdistusprotokolla](#)). Älä käytä Pikapuhdistus-oletusprotokollaa tai siitä johdettuja protokollia, koska ne päättyvät kuivausvaiheeseen, joka vahingoittaa kudosis. Puhdistusprotokollan jälkeen käsittele uudelleen formaliinista näytteen koolle ja tyyppille sopivalla aikataululla ([→ s. 160 – 10.2.1 Näytetyyppi ja protokollan kesto](#)).

Käsittelijän puhdistusreagenssit tarjoavat kätevän automaattisen menetelmän parafiinin poistamiseksi ja kudosisen palauttamiseksi etanoliin. Se on kuitenkin mahdollisesti kuluttavampi menetelmä kuin A tai C.

### C. Hidas käännteinen käsittely

Käsittely, joka käyttää muokattua puhdistusprotokollaa saman ajan kuin kudoksen varsinainen käsittely kestäisi (→ s. 182 – Hidas käännteinen puhdistusprotokolla). Käsittele sen jälkeen uudelleen formaliinista näytteen koolle ja tyypille sopivalla aikataululla (→ s. 160 – 10.2.1 Näytetyyppi ja protokollan kesto).

Pitkä käännteinen käsittely on erittäin hellävarainen kudokselle. Mikäli aikaa on riittävästi, tämä on suositeltava vaihtoehto.

#### 7. Formaliini on vaikuttanut kudokseen kirkastamisen tai parafiinikyllästyksen aikana

Tämä ongelma voi esiintyä, jos vuotava venttiili päästää formaliinia valumaan parafiinialtaaseen. Jos kohtaat tämän ongelman, ota yhteyttä asiakastukeen ja pyydä laitteesi testausta.

Formaliinikontaminaatiolle on ominaista sininen sävy tumissa, kromatiinikykyiskohtien menetys, tuman kutistuminen, eosinofiilimuuttujat ja soluplasman turpoaminen ja/tai kutistuminen.

Sulata lohkot ensin, poista ylimääräinen parafiini ja aseta sitten näytteet uusiin kasetteihin. Tämä vähentää käsittelyreagenssien kontaminoitumista parafiinilla. Käsittele sitten lohkot käännteisesti jonkin ongelmassa 6 luetellun menetelmän mukaisesti. Liota niitä sen jälkeen korkean pH-arvon Tris-HCl-palautusliuoksessa (esim. Leica BOND Epitope Retrieval Solution 2) 2–12 tunnin ajan huoneenlämmössä.

Tämä toimenpide parantaa HE-värjäysominaisuuksia, kudoksen leikkausominaisuuksia ja sektorin kiinteyttä. Tumayksityiskohdat, soluplasman turvotus ja tarkkuus eivät todennäköisesti parane.

#### 8. Riittämättömästi kiinnitetty, alikäsitelty kudokse

Mahdollinen parannuskeino on kudoksen hidas käännteinen uudelleen käsittely (→ s. 181 – C. Hidas käännteinen käsittely), formaliinikiinnitteen lisääminen, sitten uudelleen käsittely näytteen koolle ja tyypille sopivalla aikataululla (→ s. 160 – 10.2.1 Näytetyyppi ja protokollan kesto).

Kiinnittämätön tai huonosti kiinnitetty kudokse vaurioituu käsittelyssä. Etanoli ja korkea lämpötila aiheuttavat fiksaatiivaiikutuksen, joka eroaa formaldehydin vaikutuksesta. Sen seurauksena lohkot ovat alttiimpia kovettumiselle ja kuivumiselle. Kun tämä yhdistetään alikäsitelyyn, lohkoista saattaa tulla käyttökeltottomia.

#### Nopea käännteinen puhdistusprotokolla

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Puhdistusliuottimet	12	65	Ympäristö	Päällä	10
2	Puhdistusetanoli	6	55	Ympäristö	Päällä	10
Käsittelyaika:		18				

## Hidas käännteinen puhdistusprotokolla

Vaihe	Reagenssityyppi	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Paine	Sekoitin	Valumisaika (s)
1	Puhdistusliuottimet	60	65	Ympäristö	Päällä	10
2	Puhdistusliuottimet	60	65	Ympäristö	Päällä	10
3	Puhdistusetanoli	60	45	Ympäristö	Päällä	10
4	Puhdistusetanoli	60	45	Ympäristö	Päällä	10
Käsittelyaika:		240				

### 11.3 Sähkökatkos

Jos laitteessa on ollut sähkökatkos, selvitä ongelman luonne tarkistamalla virheilmoitukset virran palattua. Käsittele näytteet näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

### 11.4 Pääohjelmiston kaatuminen tai pysähtyminen

Jos pääohjelmisto on kaatunut tai pysähtynyt, selvitä ongelman luonne tarkistamalla virheilmoitukset laitteen uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Käsittele näytteet näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

**12. Tilaustiedot**

Osan kuvaus	Tilausno
HistoCore I-Scan -sarjat	14 0488 60946
Telineen koukku	14 0488 58177
Kasettiteline	14 0488 58160
Siniset kiinnikesarjat datamatriisilla	14 0488 58176
Mustat kiinnikesarjat datamatriisilla	14 0488 58173
Tulostetut viivakooditarrat	14 0488 60133
Reagenssipullokokoonpano	14 0488 57899
Pullon korkki	14 0488 57901
Parafinialtaan ilmanvaihtotulppa	14 0488 58088
Poistojärjestelmän käyttöliittymä	14 0493 53387
Aktiivihiihliisuodatin	14 0488 58136
Reagenssien etätäyttö-/tyhjennysletku	14 0488 60134
Parafiinin etätyhjennysletku	14 0488 60135
Parafiinikaavin	14 0393 53643
Molykote 111 -rasva, 100 g	14 0336 35460
O-rengas	14 0493 51361
Pullojen tarramerkintäsarja	14 048860131
Pullon tarranumerosarja	14 0488 60148
Lisätarviketaskun määrittely	14 0488 60153
Ristiliitin 21,85 x 5 mm	14 6000 05407
Tippa-astia	14 0488 59324
Tasoanturiharja	14 0488 58099
Puskuri	14 0488 59321
M4x8, EN ISO 7380	14 3000 00065
M6x35 ISO4762, täysin kierteitetty	14 3000 00537
Suora ruuvitaltta	14 0488 60138
Kiintoavain, 17 mm	14 0488 60142
Ilmanpoistoletku	14 0422 31975

**A1. Dekontaminaation vahvistus**

Kaikki tuotteet, jotka palautetaan Leica Biosystemsille tai huolletaan paikan päällä, on puhdistettava ja dekontaminoitava kunnolla. Tarkoitukseen sopiva dekontaminaatiodistumalli on saatavilla verkkosivustomme tuotevalikosta osoitteessa [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com). Mallipohjaan on syötettävä kaikki vaaditut tiedot.

Mikäli tuote palautetaan, täytetyn ja allekirjoitetun dekontaminaatiodistuksen kopio on toimitettava liitteenä tai annettava huoltoteknikolle. Käyttäjä on vastuussa tuotteista, jotka palautetaan ilman täytettyä dekontaminaatiodistusta tai joiden dekontaminaatiodistustus puuttuu. Palautustoimitukset, jotka yritys luokittelee mahdolliseksi vaaran lähteeksi, palautetaan lähettäjälle tämän omalla kustannuksella ja riskillä.



## A2. Takuu ja tekninen huolto

### Takuu

Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että sopimuksen alainen toimitettu tuote on läpäissyt laajan laadunvalvontatoimenpiteen, joka perustuu Leican sisäisiin testausstandardeihin. Lisäksi taataan, että tuotteessa ei ole vikoja ja se sisältää kaikki takuun kattamat tekniset tiedot ja/tai sovitut ominaisuudet.

Takuun kattavuus perustuu tehdyn sopimuksen sisältöön. Yksinomaan Leica-myyntiorganisaation tai sen organisaation, jolta sopimuksen alainen tuote on ostettu, takuehtoja sovelletaan.

### Teknisen huollon tiedot

Jos tarvitset teknistä asiakastukea tai varaosia, ota yhteyttä Leican edustajaan tai Leica-myyjään, jolta laite on ostettu.

Seuraavat laitetiedot tarvitaan:

- Laitteen mallin nimi ja laitteen sarjanumero.
- Laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi.
- Yhteydenoton syy.
- toimituspäivä



#### Varoitus

Jotta vältetään laite- ja näytevahingoilta, vain Leican valtuuttamia lisävarusteita ja varaosia saa asentaa laitteeseen tai käyttää laitteessa.

### Käytöstäpoisto ja hävittäminen

Laitteen tai sen osat saa hävittää vain kulloinkin voimassa olevia lakeja noudattaen.

### Elinkaari

Laitteiston elinkaari on 7 vuotta. Tämän tuotteen elinkaari on määritetty sen mukaan, mikä tilanne paikallisilla markkinoilla oli laitteen julkaisemisen jälkeen. Käyttäjien on huollettava tuotetta käyttöohjeiden vaatimusten mukaisesti ja varmistettava, että tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.





www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Germany

Puh.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faksi: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Verkkosivusto: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)